galimplant®

Sistema IPX Concept	4
Implantes dentales	8
Componentes protésicos	24
Galimplant 3D Exacto	90
Regenerador óseo y membrana	94
Cajas quirúrgicas	96
Instrumental quirúrgico	130
Guías de posicionamiento	134
Pistola de irrigación	136
Siliconas y registros	138
Sistema de registro oclusal	140
Aparatología	142
I+D+i	143



Expertos en implantología oral

Galimplant es actualmente una empresa de referencia nacional e internacional en el ámbito de la implantología oral, apostando fuertemente por la investigación e innovación.

Galimplant tiene su sede central en **C/ Benigno Quiroga, 90 - 27600 - Sarria (Lugo) – España.**

Galimplant utiliza los mejores materiales y cumple con todas las certificaciones ISO de calidad, ofreciendo siempre los mejores productos.


Versión 12/2020

ISO 13485

CE 0051

IPX CONCEPT


Implantes de conexión interna, externa, cigomáticos y especiales.
Diferentes diámetros de plataforma con una sola conexión.

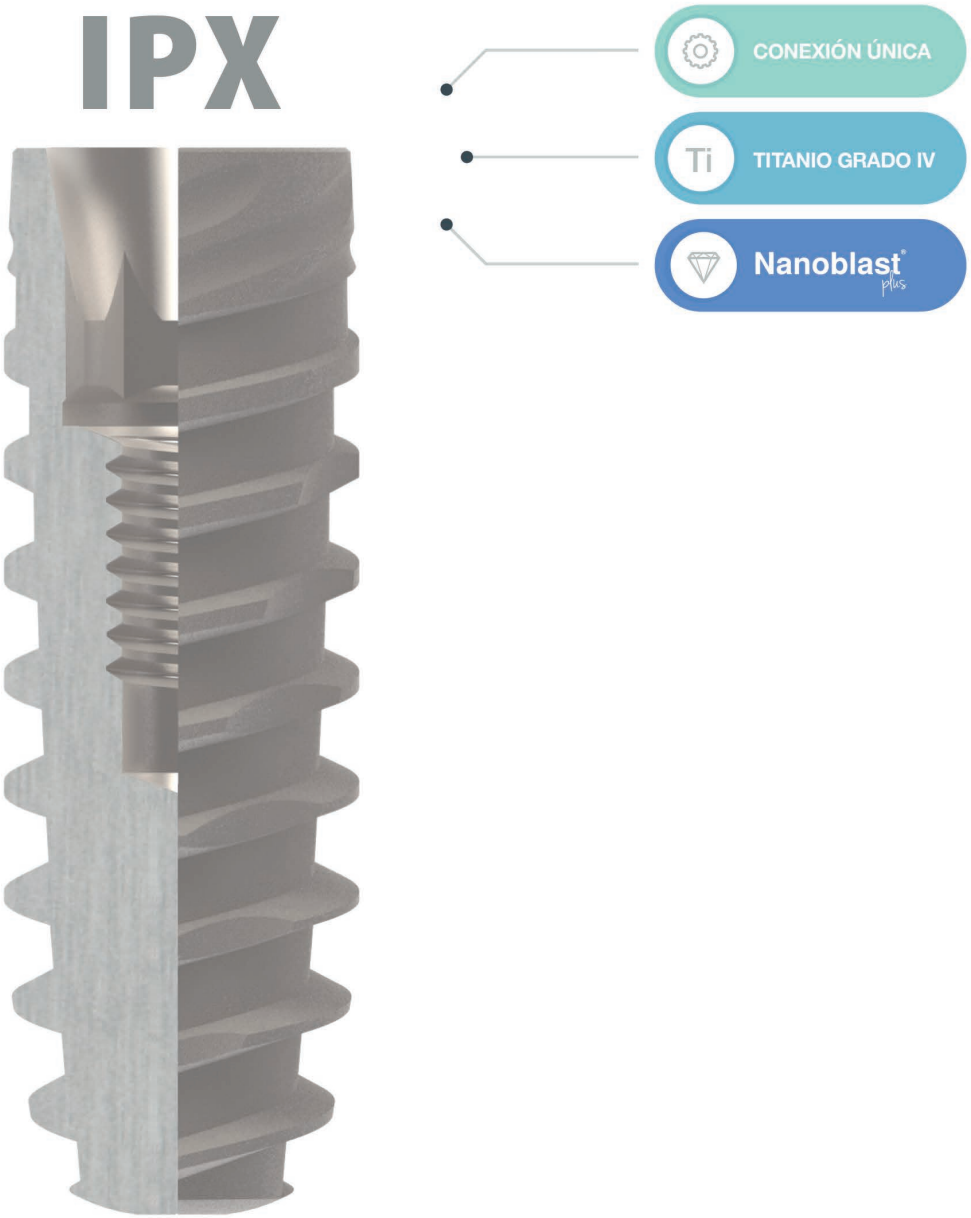

Gama de implantes

- ✔ **CONEXIÓN INTERNA** **14**
- ✔ **CONEXIÓN EXTERNA** **18**
- ✔ **IMPLANTES CIGOMÁTICOS** **20**
- ✔ **IMPLANTE ESPECIAL** **22**

Utiliza un diseño seguro. **Un solo concepto.**

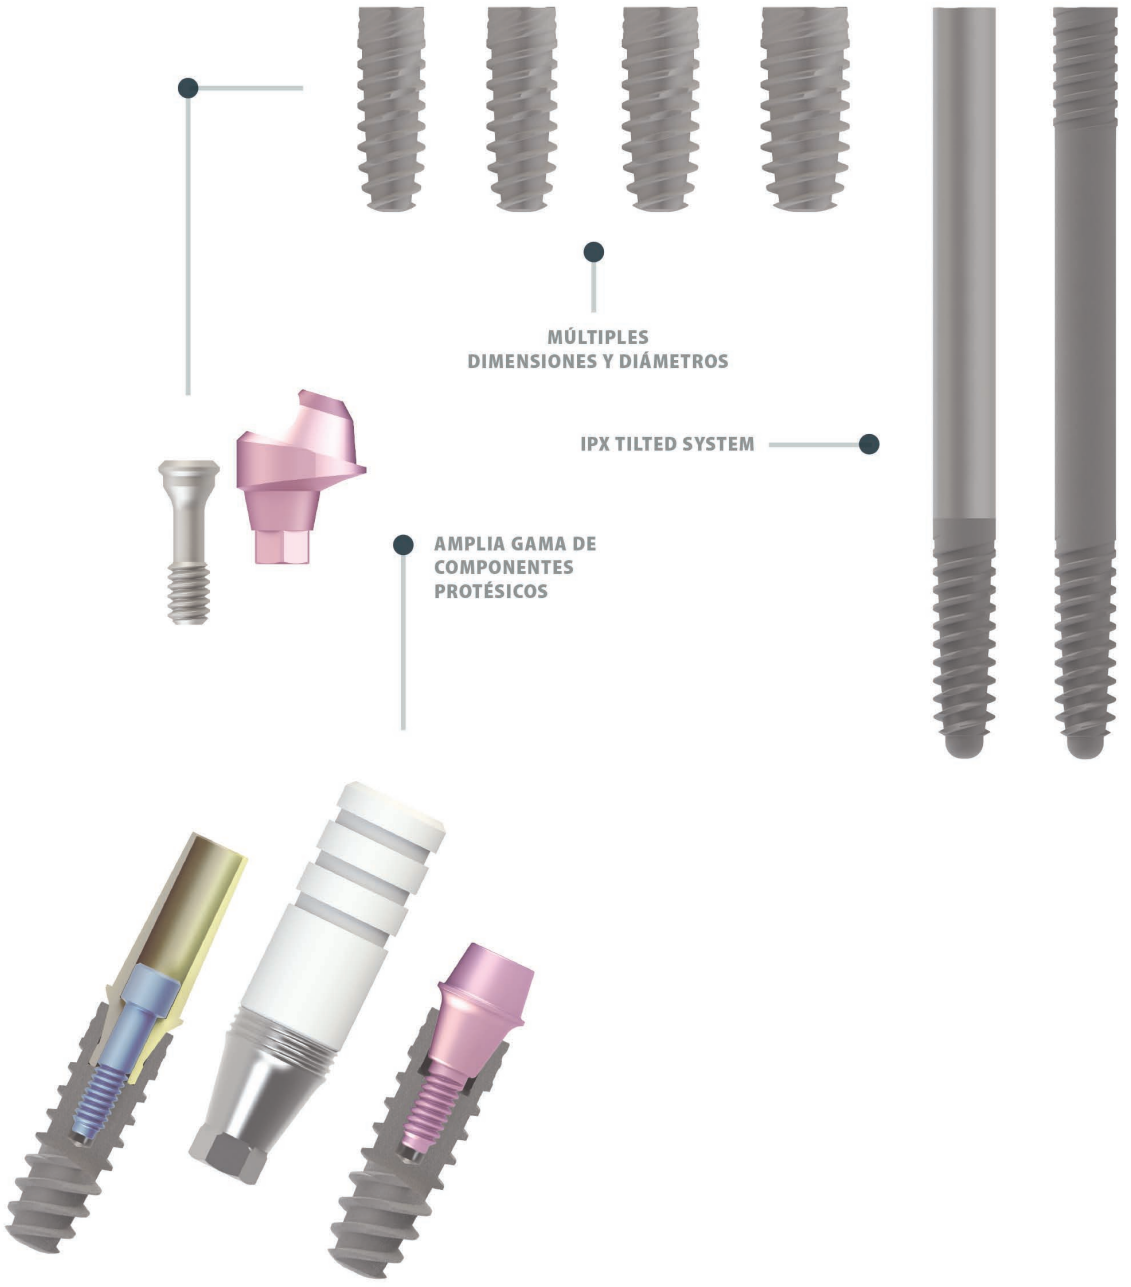



Componentes protésicos

Ponemos a su disposición todos los aditamentos protésicos.

Múltiples soluciones sencillas y estables.

Para cada paciente una solución personalizada

Estos nuevos productos han sido desarrollados gracias a una intensa investigación, tanto preclínica como clínica y bajo un enfoque biológico y biomecánico, proporcionando excelentes resultados funcionales a corto y a largo plazo.



Regenerador óseo

Biomaterial

Sintético mineral (fosfato tricálcico β), osteoconductor, estéril, reabsorbible y 100% biocompatible.

Membranas

Membranas de colágeno y pericardio reabsorbibles de origen equino, hermostáticas y estériles.

Cajas quirúrgicas

Proporcionamos el instrumental necesario para cualquier tipo de necesidad en el campo de la implantología, tanto para cirugía convencional, cirugía guiada y cirugía avanzada.



Nuestro progreso
pone la tecnología a su alcance

Galimplant 3D exacto

Desarrollado en estrecha colaboración entre ingenieros informáticos y odontólogos con un objetivo claro: **suministrar al clínico un resultado sencillo y preciso.**

- ✔ Software exclusivo
- ✔ Simulación en 2D y 3D
- ✔ Planificación avanzada



Características generales




MATERIAL DE FABRICACIÓN

Nuestros implantes están fabricados en titanio grado IV. Material probado científicamente que reúne las mejores condiciones de biocompatibilidad.



FABRICACIÓN

Nuestros productos están desarrollados bajo los mayores estándares de calidad.

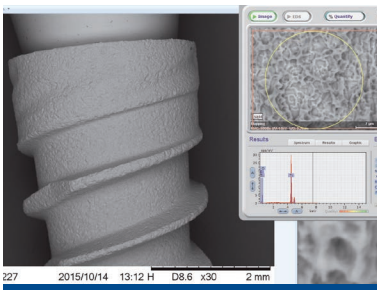


CONTROL DE CALIDAD

Todos nuestros materiales se someten a estrictos controles de calidad, obteniendo así productos 100% fiables.



CONEXIÓN

Nuestra conexión cónica a 11º garantiza un perfecto sellado en la unión implante-pilar. Creando gran estabilidad y minimizando la posibilidad de contaminación bacteriana a largo plazo.

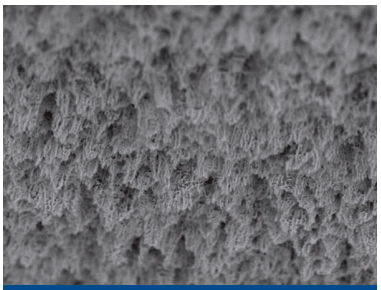

SUPERFICIE NANOBLAST PLUS®

Desarrollada por **Galimplant** como su activo más valioso, debido a sus excelentes propiedades físico-químicas que favorecen una adhesión ósea sólida y estable en el tiempo.



ENVASADO


Simple, práctico y ergonómico.



Identificación por colores según tipo de implante

- **CONEXIÓN INTERNA**
- **CONEXIÓN EXTERNA**
- **CIRUGÍA GUIADA**
- **IMPLANTE CIGOMÁTICO TREATED**
- **IMPLANTE CIGOMÁTICO SMOOTH**
- **IMPLANTE ESPECIAL PARA CEMENTAR**

¿Cómo retirar el implante del envase?

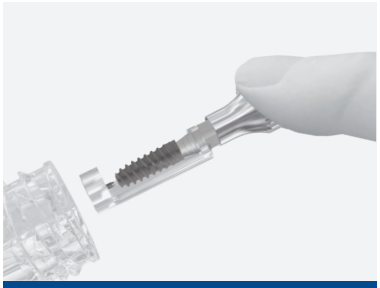

CON LLAVE MANUAL



CON LLAVE MOTOR


Envasado

Descripciones etiquetas




1. **Etiqueta informativa exterior**
2. **Número de lote**
3. **Referencia (medida)**

Etiqueta informativa exterior

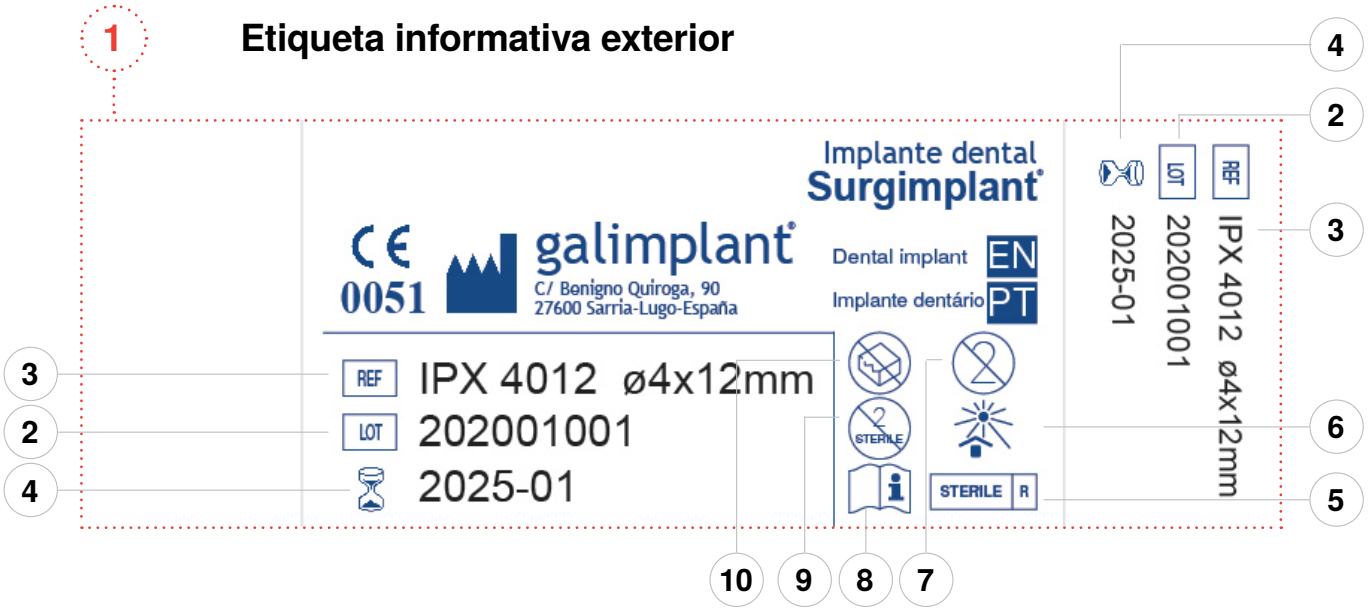

Etiqueta informativa interior (adhesiva, x2)

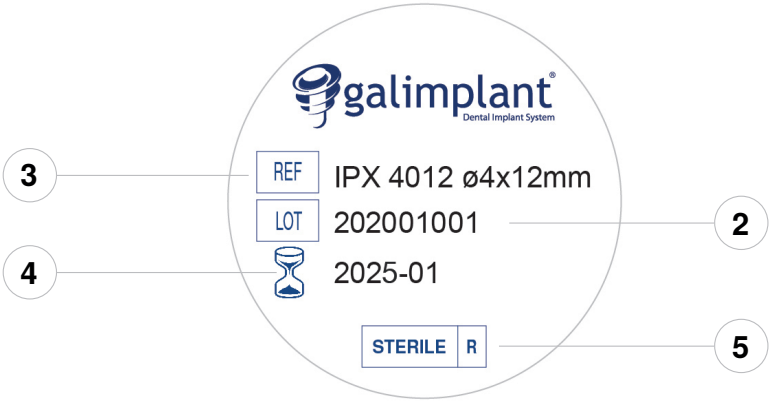


---

1. Etiqueta informativa exterior
2. Número de lote
3. Referencia (medida)
4. Fecha de caducidad
5. Esterilizado por irradiación
6. Mantener fuera del alcance de la luz solar
7. Un solo uso
8. Consulte las instrucciones de uso
9. No reesterilizar
10. No utilizarse si el envase está dañado

Nanoblast plus®


Ti

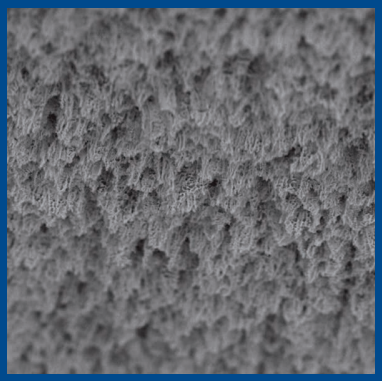

Ideal para el desarrollo y la maduración celular.

Superficie creada por **Galimplant** y su activo más valioso debido a sus excelentes propiedades físico-químicas que favorecen una adhesión ósea sólida y estable en el tiempo.

¿Qué nos hace diferentes?

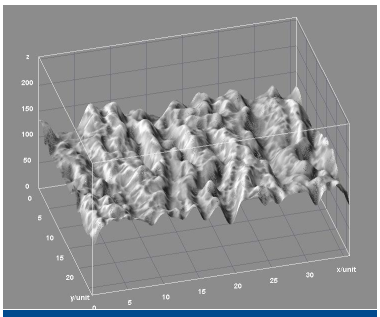

GRÁFICA DE SUPERFICIE

Nanoblast plus® es el resultado de una técnica que combina un chorreado de arena de grano grueso y un posterior triple grabado ácido. Así, se obtiene una macro, micro y nanorrugosidad en la superficie del implante ideal para la adhesión y crecimiento celular.


RUGOSIDAD

Ra **1.7** µm

COMPOSICIÓN

TiO_2 **99.9** %

Técnica empleada: **SEM (EDX)**

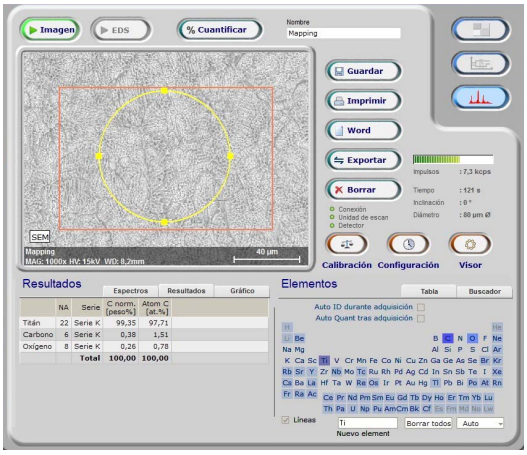

C norm. [peso %]

TITANIO

99.35 %

CARBONO

0.38 %

OXÍGENO

0.26 %

Atom C [at.%]

TITANIO

97.71 %

CARBONO

1.51 %


OXÍGENO

0.78 %


Vistas de la superficie del implante dental



MAGNIFICACIÓN X 40

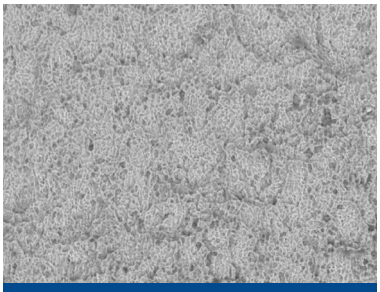


MAGNIFICACIÓN X 1000

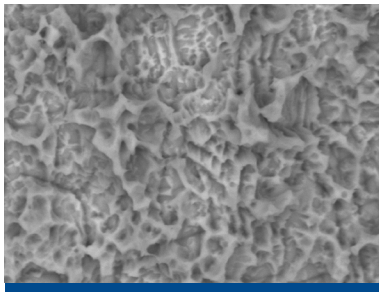


MAGNIFICACIÓN X 5000


Histología

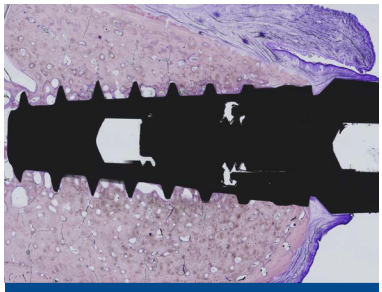

MAGNIFICACIÓN X 40

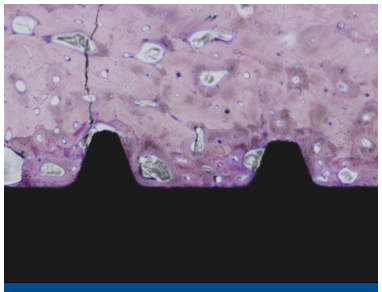


MAGNIFICACIÓN X 40

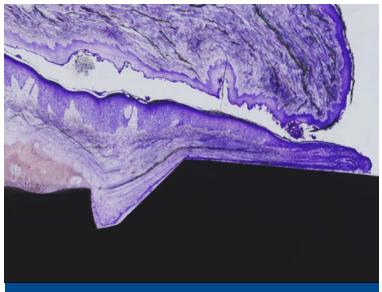

MAGNIFICACIÓN X 40

Conexión interna

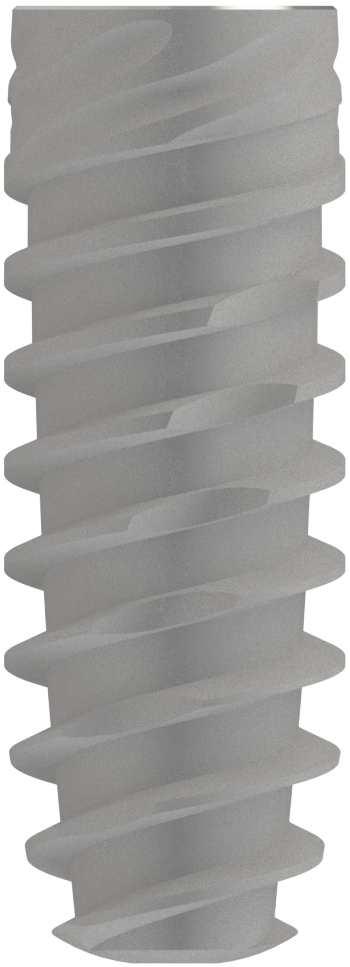

IPX (Ti)

Diseño macroscópico que favorece una gran estabilidad primaria en cualquier situación.

- **AJUSTE PRECISO QUE GARANTIZA EL SELLADO BACTERIANO**
- **CONEXIÓN INTERNA CÓNICA A 11°**
- **ALTA RESISTENCIA MECÁNICA**
- **PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA**
- **PLATAFORMA REDUCIDA**

IPX

Conexión interna IPX



⑥ Ø 3,5 mm

Plataforma Ø **3,5 mm**

8 mm	Ref. **IPX 3508**
10 mm	Ref. **IPX 3510**
12 mm	Ref. **IPX 3512**
14 mm	Ref. **IPX 3514**
16 mm	Ref. **IPX 3516**
18 mm	Ref. **IPX 3518**



⑥ Ø 4 mm

Plataforma Ø **4 mm**

6 mm	Ref. **IPX 4006**
8 mm	Ref. **IPX 4008**
10 mm	Ref. **IPX 4010**
12 mm	Ref. **IPX 4012**
14 mm	Ref. **IPX 4014**
16 mm	Ref. **IPX 4016**
18 mm	Ref. **IPX 4018**



⑥ Ø 4,5 mm

Plataforma Ø **4,5 mm**

6 mm	Ref. **IPX 4506**
8 mm	Ref. **IPX 4508**
10 mm	Ref. **IPX 4510**
12 mm	Ref. **IPX 4512**
14 mm	Ref. **IPX 4514**



⑥ Ø 5 mm

Plataforma Ø **5 mm**

6 mm	Ref. **IPX 5006**
8 mm	Ref. **IPX 5008**
10 mm	Ref. **IPX 5010**
12 mm	Ref. **IPX 5012**

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo Ø **1,6 mm** (Ti)



Ref. **PCS 04010**



Ref. **AIP 040**



Ref. **TAIP 0135**

Long. **13,5** mm

Triple función:

- Porta-implante
- Aditamento de impresión (Cubeta abierta)
- Pilar provisional

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante (Ti)



Ref. **PCS 04010**



Ref. **AIPC 040**

Doble función:

- Porta-implante
- Aditamento de impresión (Cubeta cerrada)

*Si selecciona esta opción, la referencia del pedido debe llevar incluida una "C". Ejemplo: **IPXC 3508**

Pilar de cicatrización recto Ø **1,6 mm** (Ti)



Ref. **PCS 04020**

Alt. **2** mm

Ref. **PCS 04040**

Alt. **4** mm

Ref. **PCS 04060**

Alt. **6** mm

Pilar de cicatrización cónico Ø **1,6 mm** (Ti)




Ref. **PCCS 04040**

Alt. **4** mm

Ref. **PCCS 04060**

Alt. **6** mm

Aditamento de impresión para cubeta abierta Ø **1,6 mm** (Ti)



Ref. **AIP 040**

Ref. **TAIP 0135**

Long. **13,5** mm

Ref. **TAIP 0200**

Long. **20** mm

Aditamento de impresión para cubeta cerrada Ø **1,6 mm** (Ti)



Ref. **AIPC 040**

Conexión interna



ICI (Ti)

Diseño macroscópico especialmente indicado para huesos tipo I y II.

- **AJUSTE PRECISO QUE GARANTIZA EL SELLADO BACTERIANO**
- **CONEXIÓN INTERNA CÓNICA A 11°**
- **ALTA RESISTENCIA MECÁNICA**
- **PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA**
- **PLATAFORMA REDUCIDA**

ICI

Conexión interna ICI



⌀ 3,2 mm

Plataforma Ø **3,2 mm**

10 mm	Ref. **ICI 03210**
12 mm	Ref. **ICI 03212**
14 mm	Ref. **ICI 03214**



⌀ 3,5 mm

Plataforma Ø **3,5 mm**

8 mm	Ref. **ICI 03508**
10 mm	Ref. **ICI 03510**
12 mm	Ref. **ICI 03512**
14 mm	Ref. **ICI 03514**



⌀ 4 mm

Plataforma Ø **4 mm**

8 mm	Ref. **ICI 04008**
10 mm	Ref. **ICI 04010**
12 mm	Ref. **ICI 04012**
14 mm	Ref. **ICI 04014**



⌀ 5 mm

Plataforma Ø **5 mm**

8 mm	Ref. **ICI 05008**
10 mm	Ref. **ICI 05010**
12 mm	Ref. **ICI 05012**
14 mm	Ref. **ICI 05014**

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo ⌀ **1,6 mm** (Ti)



Ref. **PCS 04010**



Ref. **AIP 040**



Ref. **TAIP 0135**

Long. **13,5** mm

Triple función:

- Porta-implante
- Aditamento de impresión (Cubeta abierta)
- Pilar provisional

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante (Ti)



Ref. **PCS 04010**



Ref. **AIPC 040**

Doble función:

- Porta-implante
- Aditamento de impresión (Cubeta cerrada)

*Si selecciona esta opción, la referencia del pedido debe llevar incluida una “C”.
Ejemplo: **ICIC 03508**

Pilar de cicatrización recto ⌀ **1,6 mm** (Ti)



Ref. **PCS 04020**
Alt. **2** mm

Ref. **PCS 04040**
Alt. **4** mm

Ref. **PCS 04060**
Alt. **6** mm


Pilar de cicatrización cónico ⌀ **1,6 mm** (Ti)



Ref. **PCCS 04040**
Alt. **4** mm

Ref. **PCCS 04060**
Alt. **6** mm

Aditamento de impresión para cubeta abierta ⌀ **1,6 mm** (Ti)



Ref. **AIP 040**

Ref. **TAIP 0135**
Long. **13,5** mm


Ref. **TAIP 0200**
Long. **20** mm

Aditamento de impresión para cubeta cerrada ⌀ **1,6 mm** (Ti)



Ref. **AIPC 040**

Conexión externa

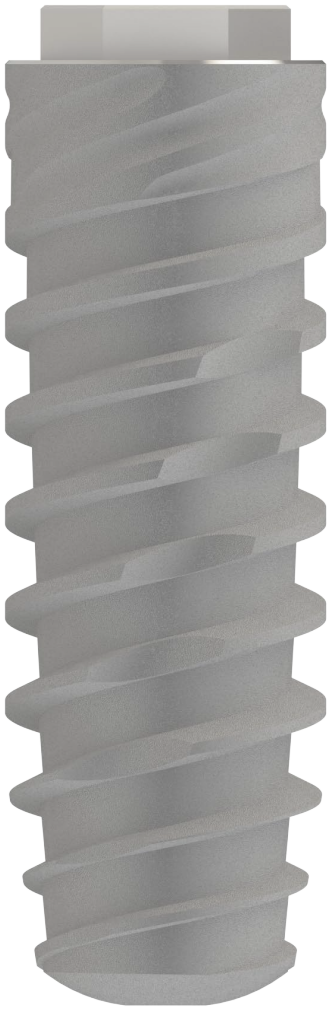

IPXE (Ti)

Diseño macroscópico que favorece una gran estabilidad primaria en cualquier situación.

- **CONEXIÓN EXTERNA UNIVERSAL REGULAR**
- **GRAN CAPACIDAD AUTORROSCANTE**
- **PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA**

IPXE

Conexión externa IPXE



⌀ 3,5 mm

Plataforma ⌀ **4 mm**

8 mm	Ref. **IPXE 3508**
10 mm	Ref. **IPXE 3510**
12 mm	Ref. **IPXE 3512**
14 mm	Ref. **IPXE 3514**



⌀ 4 mm

Plataforma ⌀ **4 mm**

6 mm	Ref. **IPXE 4006**
8 mm	Ref. **IPXE 4008**
10 mm	Ref. **IPXE 4010**
12 mm	Ref. **IPXE 4012**
14 mm	Ref. **IPXE 4014**



⌀ 5 mm

Plataforma ⌀ **5 mm**

6 mm	Ref. **IPXE 5006**
8 mm	Ref. **IPXE 5008**
10 mm	Ref. **IPXE 5010**
12 mm	Ref. **IPXE 5012**

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo ⌀ **2 mm** (Ti)



Ref. **PC 4010**



Ref. **AIP 40**



Ref. **TAIP 135**

Long. **13,5** mm

Triple función:

- Porta-implante
- Aditamento de impresión
- Pilar provisional

Pilar de cicatrización recto ⌀ **2 mm** (Ti)



Ref. **PC 4020**

Alt. **2** mm



Ref. **PC 4040**

Alt. **4** mm



Ref. **PC 4060**

Alt. **6** mm

Pilar de cicatrización cónico ⌀ **2 mm** (Ti)



Ref. **PCC 4040**

Alt. **4** mm



Ref. **PCC 4060**

Alt. **6** mm

Aditamento de impresión ⌀ **2 mm** (Ti)



Ref. **AIP 40**



Ref. **TAIP 135**

Long. **13,5** mm




Ref. **TAIP 200**

Long. **20** mm

Implantes cigomáticos

IPX- TILTED SYSTEM

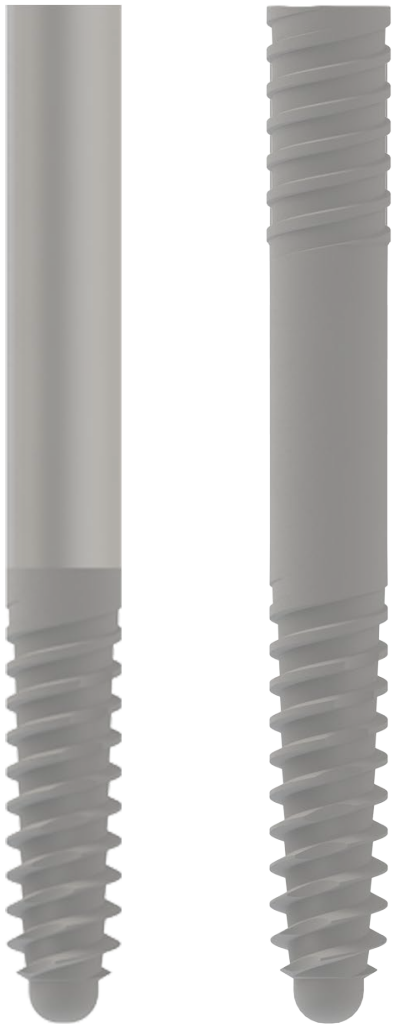

Implantes diseñados para casos con maxilar superior atrófico severo.

- AJUSTE PRECISO QUE GARANTIZA EL SELLADO BACTERIANO
- CONEXIÓN INTERNA CÓNICA A 11º
- ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
- PLATAFORMA PROTÉSICA ÚNICA
- PLATAFORMA REDUCIDA

Disponible en dos diseños

- SMOOTH
- TREATED

Implantes cigomáticos ICMS - ICMT



6 ∅ 4,2 mm

Plataforma ∅ **4,2 mm**

30 mm	Ref. **ICMS-4230**
32,5 mm	Ref. **ICMS-4232**
35 mm	Ref. **ICMS-4235**
37,5 mm	Ref. **ICMS-4237**
40 mm	Ref. **ICMS-4240**
42,5 mm	Ref. **ICMS-4242**
45 mm	Ref. **ICMS-4245**
47,5 mm	Ref. **ICMS-4247**
50 mm	Ref. **ICMS-4250**
52,5 mm	Ref. **ICMS-4252**
55 mm	Ref. **ICMS-4255**
60 mm	Ref. **ICMS-4260**



6 ∅ 4,3 mm

Plataforma ∅ **4,3 mm**

20 mm	Ref. **ICMT-4320**
25 mm	Ref. **ICMT-4325**
30 mm	Ref. **ICMT-4330**
32,5 mm	Ref. **ICMT-4332**
35 mm	Ref. **ICMT-4335**
37,5 mm	Ref. **ICMT-4337**
40 mm	Ref. **ICMT-4340**
42,5 mm	Ref. **ICMT-4342**
45 mm	Ref. **ICMT-4345**
47,5 mm	Ref. **ICMT-4347**
50 mm	Ref. **ICMT-4350**
52,5 mm	Ref. **ICMT-4352**
55 mm	Ref. **ICMT-4355**
60 mm	Ref. **ICMT-4360**

Suministrado con

Pilar de cierre + Porta-implante (Ti)



Ref. **PCS 04010**



Ref. **AIPC 040**

Doble función:

- Porta-implante
- Aditamento de impresión

Pilar de cicatrización recto ∅ 1,6 mm (Ti)



Ref. **PCS 04020**
Alt. **2** mm



Ref. **PCS 04040**
Alt. **4** mm



Ref. **PCS 04060**
Alt. **6** mm

Pilar de cicatrización cónico ∅ 1,6 mm (Ti)



Ref. **PCCS 04040**
Alt. **4** mm



Ref. **PCCS 04060**
Alt. **6** mm

Aditamento de impresión para cubeta abierta ∅ 1,6 mm (Ti)



Ref. **AIP 040**



Ref. **TAIP 0135**
Long. **13,5** mm



Ref. **TAIP 0200**
Long. **20** mm

Aditamento de impresión para cubeta cerrada ∅ 1,6 mm (Ti)



Ref. **AIPC 040**

Implante especial



Implante especial fabricado en una sola pieza. Diseñado para casos con limitaciones anatómicas severas.

- ✔ **IMPLANTE PARA CEMENTAR**

ESP

Implante especial



Implante **para cementar**

∅ 2,5 mm

10 mm	Ref. **IMC-2510**
12 mm	Ref. **IMC-2512**

Suministrado con
Porta-implante



Ref. **AIP-IMC**


Opcional

Réplica



Ref. **RI-IMC**


Pilar calcinable



Ref. **PCA-IMC**

Componentes protésicos

Para **conexión interna**

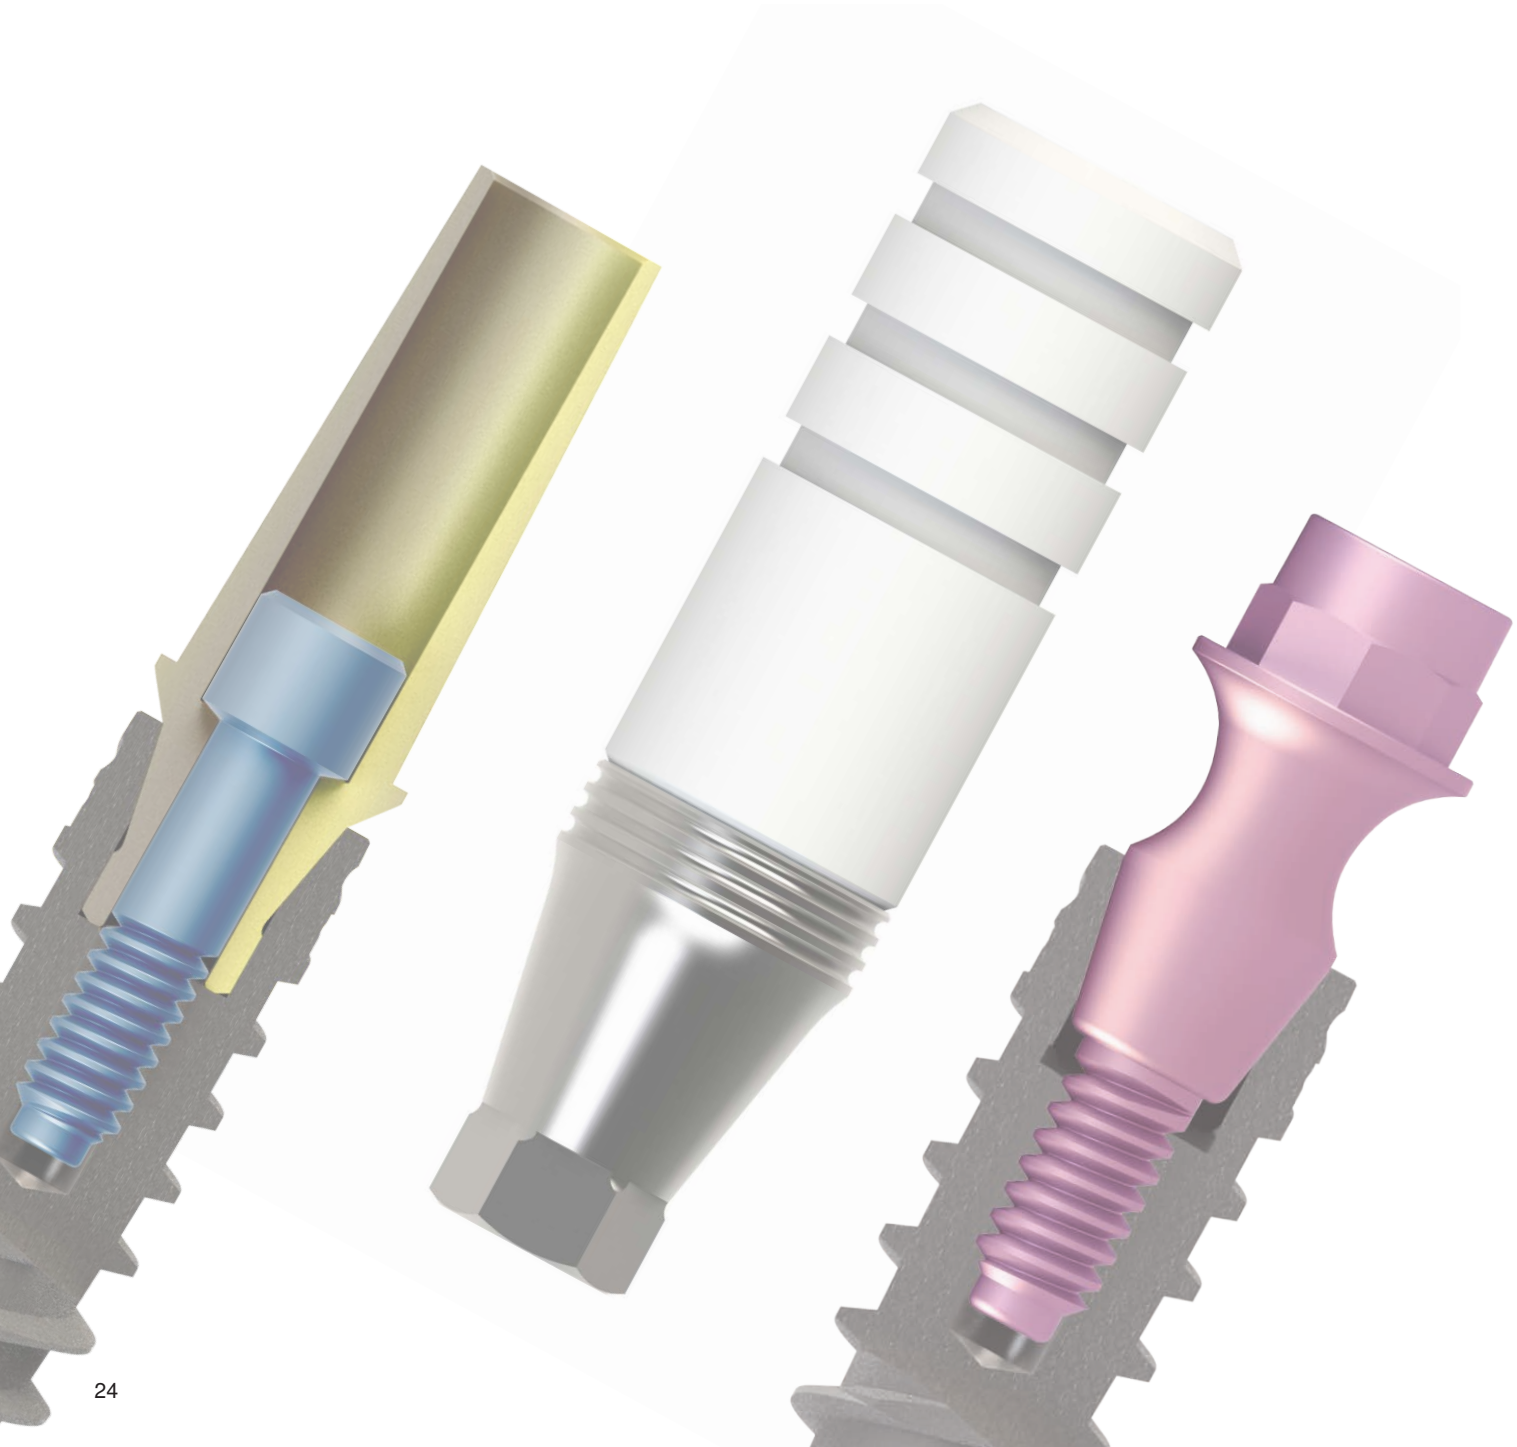

CI

Amplia gama de soluciones protésicas

Esquema protésico
Pág. 26

Prótesis de carga inmediata
Pág. 30

Prótesis cementada
Pág. 32

Pilar para escaneado
Pág. 36

Prótesis cemento-atornillada
Pág. 38

Prótesis atornillada
Pág. 44

Prótesis removible
Pág. 60

Esquema protésico CI

Pilares de cicatrización
Para implantes de conexión interna: **IPX** e **ICI**

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis cementada

Ref. **PCS 04010**


Ref. **PCS 04020**
Ref. **PCS 04040**
Ref. **PCS 04060**


Ref. **PCCS 04040**
Ref. **PCCS 04060**


Ref. **AIP 040** Ref. **TAIP 0135** Ref. **TAIP 0200** Ref. **AIPC 040**


Ref. **SBT 040**


Ref. **RI SB 040**


Ref. **PCIR 040**


Ref. **PCIA 040**
Ref. **PCIA 04020**
Ref. **PCIA 04030**
Ref. **PCIA 04040**

Prótesis cemento-atornillada

Ref. **PCS 04010**


Ref. **PCS 04020**
Ref. **PCS 04040**
Ref. **PCS 04060**


Ref. **PCCS 04040**
Ref. **PCCS 04060**


Ref. **AIP 040** Ref. **TAIP 0135** Ref. **TAIP 0200** Ref. **AIPC 040**


Ref. **SBT 040**


Ref. **RI SB 040**


Ref. **PCIR 040**


Ref. **PCIA 040**
Ref. **PCIA 04020**
Ref. **PCIA 04030**
Ref. **PCIA 04040**


Ref. **PCT 4030**


Ref. **AIPTR 40**


Ref. **AIPT 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **TAIP 200**


Ref. **SBT MUSR**
Ref. **SBT MUSA**


Ref. **RITR SB 40**


Ref. **RIT SB 40**


Ref. **PTIMUR 4048**


Ref. **PTIMUA 4048**


Ref. **PCM 4030**


Ref. **AIPMU 40**


Ref. **TAIPMU 135**


Ref. **SBT MUST**
Ref. **SBT MUSTA**


Ref. **RIMA SB 40**


Ref. **PTIMUTR 40**


Ref. **PTiMUTA 40**

Pilares definitivos rectos

Pilares definitivos angulados

Tornillos



Ref. **PR 04000**



Ref. **PA 04000**
Ref. **PA 04010**
Ref. **PA 04030**
Ref. **PA 04050**



Ref. **PA 0154010**
Ref. **PA 0154030**
Ref. **PA 0154050**



Ref. **PA 0304010**
Ref. **PA 0304030**
Ref. **PA 0304050**



Ref. **TP 040** x 2



Ref. **PGZR 04010**
Ref. **PGZR 04020**
Ref. **PGZR 04030**



Ref. **PGZA 04010**
Ref. **PGZA 04020**
Ref. **PGZA 04030**



Ref. **PCERC 04020**
Ref. **PCERC 04030**
Ref. **PCERC 04040**



Ref. **TP 040** x 2



Ref. **MUSLAR 04030**
Ref. **MUSLAR 04040**
Ref. **MUSLAR 04060**



Ref. **MUSR 04010**
Ref. **MUSR 04020**
Ref. **MUSR 04030**
Ref. **MUSR 04040**
Ref. **MUSR 04050**



Ref. **PITEMUR 4040**



Ref. **PGZMUR 40**



Ref. **PCERCMUR 40**



Ref. **TMU 4048** x 2



Ref. **MUSLA 04030**
Ref. **MUSLA 04040**
Ref. **MUSLA 04060**



Ref. **MUSA 04010**
Ref. **MUSA 04020**
Ref. **MUSA 04030**
Ref. **MUSA 04040**
Ref. **MUSA 04050**



Ref. **MUSA S04010**
Ref. **MUSA S04020**
Ref. **MUSA S04030**
Ref. **MUSA S04040**
Ref. **MUSA S04050**



Ref. **PITEMUA 4040**



Ref. **PGZMUA 40**



Ref. **PCERCMUA 40**



Ref. **MUST 04010**
Ref. **MUST 04020**
Ref. **MUST 04030**



Ref. **PITEMUTR 4040**



Ref. **MU 1504020**
Ref. **MU 1504030**
Ref. **MU 3004030**
Ref. **MU 3004040**
Ref. **MU 4504050**
Ref. **MU 5004050**
Ref. **MU 6004050**



Ref. **PITEMUTR 4040**



Ref. **TMUT 40** x 2

Esquema protésico CI

Pilares de cicatrización
Para implantes de conexión interna: **IPX** e **ICI**

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis atornillada


Ref. **PCS 04010**


Ref. **PCS 04020**
Ref. **PCS 04040**
Ref. **PCS 04060**


Ref. **PCCS 04040**
Ref. **PCCS 04060**


Ref. **AIP 040** Ref. **TAIP 0135** Ref. **TAIP 0200** Ref. **AIPC 040**


Ref. **SBT 040**


Ref. **RI SB 040**


Ref. **PCIR 040**


Ref. **PCIA 040**
Ref. **PCIA 04020**
Ref. **PCIA 04030**
Ref. **PCIA 04040**


Ref. **PCT 4030**


Ref. **AIPTR 40**


Ref. **AIPT 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **TAIP 200**


Ref. **SBT MUSR**
Ref. **SBT MUSA**


Ref. **RITR SB 40**


Ref. **RIT SB 40**


Ref. **PTIMUR 4048**


Ref. **PTIMUA 4048**

Prótesis removible


Ref. **PCM 4030**


Ref. **AIPMU 40**
Ref. **AIPMUA 40**


Ref. **TAIPMU 135**


Ref. **SBT MUST**
Ref. **SBT MUSTA**


Ref. **RIMA SB 40**


Ref. **PTIMUTR 40**


Ref. **PTiMUTA 40**


Ref. **PCS 04010**


Ref. **PCS 04020**
Ref. **PCS 04040**
Ref. **PCS 04060**


Ref. **PCCS 04040**
Ref. **PCCS 04060**


Ref. **AIP 040** Ref. **TAIP 0135** Ref. **TAIP 0200** Ref. **AIPC 040**


Ref. **SBT 040**


Ref. **RI SB 040**

Pilares definitivos rectos



Ref. **PSR 040**



Ref. **PSA 040**



Ref. **MUSLAR 04030**
Ref. **MUSLAR 04040**
Ref. **MUSLAR 04060**



Ref. **MUSR 04010**
Ref. **MUSR 04020**
Ref. **MUSR 04030**
Ref. **MUSR 04040**
Ref. **MUSR 04050**

Ref. **PCMUR 4048**
Ref. **PCMUA 4048**



Ref. **MUSLA 04030**
Ref. **MUSLA 04040**
Ref. **MUSLA 04060**



Ref. **MUSA 04010**
Ref. **MUSA 04020**
Ref. **MUSA 04030**
Ref. **MUSA 04040**
Ref. **MUSA 04050**



Ref. **MUSA S04010**
Ref. **MUSA S04020**
Ref. **MUSA S04030**
Ref. **MUSA S04040**
Ref. **MUSA S04050**



Ref. **PSMUR 4048**
Ref. **PSMUA 4048**



Ref. **MUST 04010**
Ref. **MUST 04020**
Ref. **MUST 04030**



Ref. **MUSTA 04010**
Ref. **MUSTA 04020**
Ref. **MUSTA 04030**

Ref. **PCMUTR 40**
Ref. **PCMUTA 40**



Ref. **PKO 04008**
Ref. **PKO 04016**
Ref. **PKO 04030**
Ref. **PKO 04040**
Ref. **PKO 04050**
Ref. **PKO 04070**

Ref. **PKOC 08**



Ref. **PKB 04008**
Ref. **PKB 04016**
Ref. **PKB 04030**
Ref. **PKB 04040**
Ref. **PKB 04050**

Pilares definitivos angulados



Ref. **MU 1504020**
Ref. **MU 1504030**
Ref. **MU 3004030**
Ref. **MU 3004040**
Ref. **MU 4504050**
Ref. **MU 5004050**
Ref. **MU 6004050**

Ref. **PCMUTR 40**

Tornillos



Ref. **TP 040** x 2



Ref. **TMU 4048** x 2



Ref. **TMUT 40** x 2


Conjunto de procesado



Ref. **TKO 4048**



Ref. **AKO 4048**



Ref. **RKO 4048**



Ref. **TKB 4048** Ref. **OB 4048** Ref. **AKO 4048**


Pilar de carga inmediata

Pilar disponible en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Ambos pilares están indicados para prótesis provisionales cementadas o atornilladas.


Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.

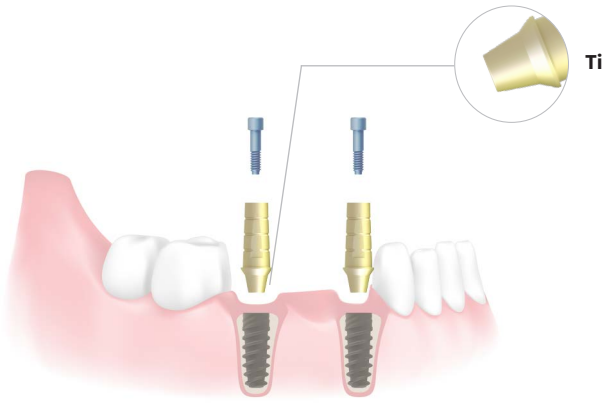

PILAR DE CARGA INMEDIATA ROTACIONAL

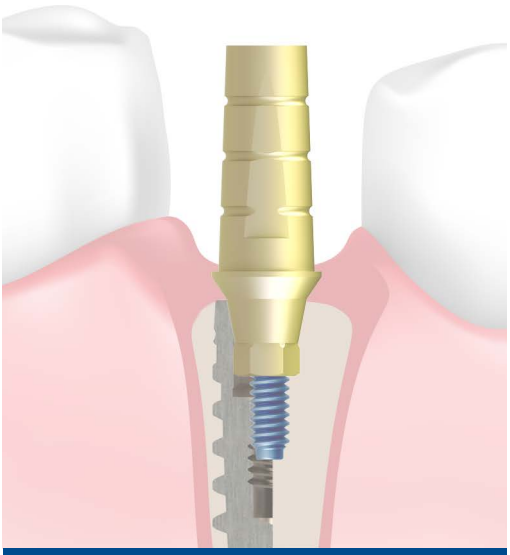

PILAR DE CARGA INMEDIATA + TORNILLO PROTÉSICO

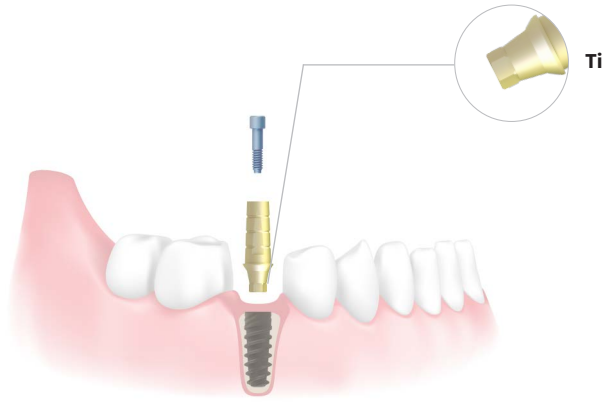

PILAR DE CARGA INMEDIATA ANTI-ROTACIONAL

Pilar de carga inmediata
Para **conexión interna**



Pilar carga inmediata
rotacional (Ti)

Ref. **PCIR 040** Ø **4** mm Alt. Hombro **1** mm



Pilar carga inmediata
anti-rotacional (Ti)

Ref. **PCIA 040**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **PCIA 04020**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **PCIA 04030**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **PCIA 04040**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **4** mm

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm

Pilar recto

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Disponible en distintas alturas de hombro.


Indicaciones

Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.



PILAR RECTO ROTACIONAL

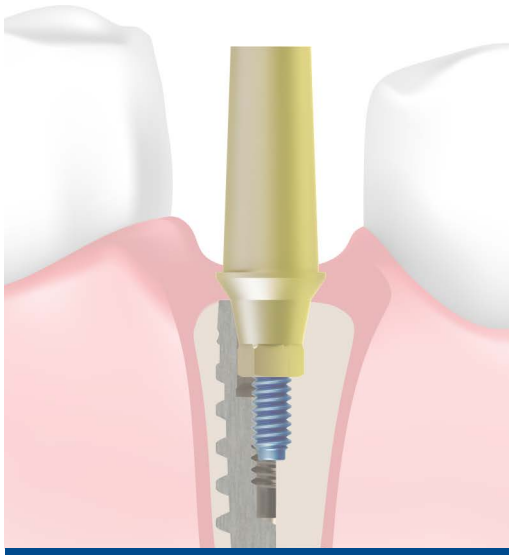

PILAR RECTO + TORNILLO PROTÉSICO



PILAR RECTO ANTI-ROTACIONAL

Pilar recto
Para **conexión interna**



Pilar recto rotacional (Ti)

Ref. **PR 04000** Ø **4** mm Alt. Hombro **0** mm



Pilar recto anti-rotacional (Ti)

Ref. **PA 04000**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **0** mm
Ref. **PA 04010**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **PA 04030**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **PA 04050**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **5** mm

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm

Pilar angulado

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Disponible en distintas alturas de hombro.

Indicaciones


Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15º hasta 30º.



PILAR ANGULADO 15º

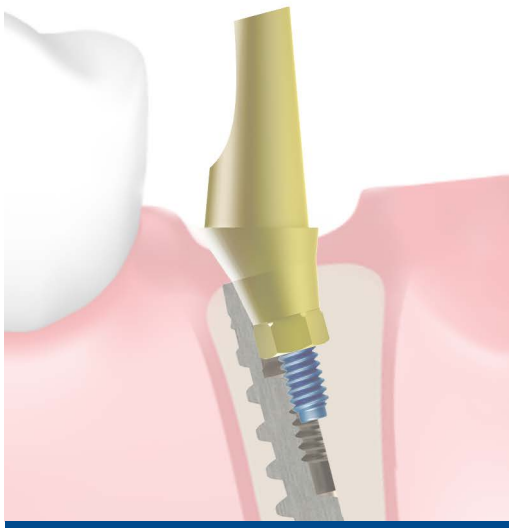

PILAR ANGULADO + TORNILLO PROTÉSICO

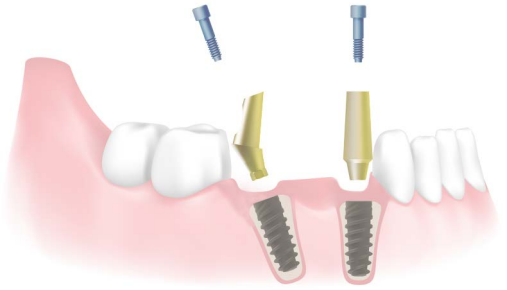

PILAR ANGULADO 30º

Pilar angulado
Para **conexión interna**



Pilar angulado (Ti)

Ref. **PA 0154010**	**15°**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **PA 0154030**	**15°**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **PA 0154050**	**15°**	Alt. Hombro **5** mm



Pilar angulado (Ti)

Ref. **PA 0304010**	**30°**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **PA 0304030**	**30°**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **PA 0304050**	**30°**	Alt. Hombro **5** mm

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm

Pilar para escaneado

Directo a implante

Pilar para escanear fabricado en titanio grado V.

Indicaciones

Puede utilizarse colocado directamente en boca o sobre modelos.
Reproduce la posición del implante de forma exacta.

Se colocará aplicando el torque final de la prótesis.

Pilar para escaneado
directo a implante




Ref. **SBT 040** Ø **4** mm 6

Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (1,6 mm)
Ref. **TP 040**

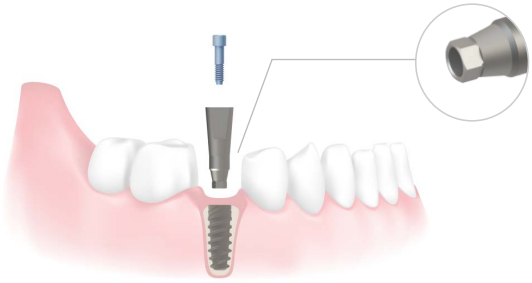

DIRECTO A IMPLANTE

Opcional

Réplica



Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm 6

Es necesario el uso del tornillo para modelo digital
(No incluido con la réplica)



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**

Pilar para escaneado

Directo a pilar multi-posición recto estético y recto

Pilar para escanear fabricado en titanio grado V.

Indicaciones

Puede utilizarse colocado directamente en boca o sobre modelos.
Reproduce la posición del pilar transepitelial de forma exacta.

Se colocará aplicando el torque final de la prótesis.

Pilar para escaneado
directo a pilar multi-posición recto estético

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm




Ref. **SBT MUSR** Ø **4** mm
Ref. **SBT MUSA** Ø **4** mm

Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**

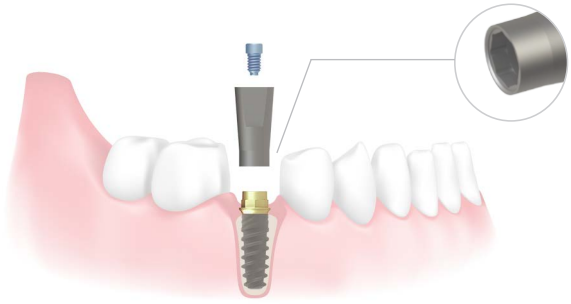

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO ESTÉTICO

Pilar para escaneado
directo a pilar multi-posición recto

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm




Ref. **SBT MUST** Ø **4,8** mm
Ref. **SBT MUSTA** Ø **4,8** mm

Suministrado con tornillo




Tornillo clínico (1,4 mm)
Ref. **TMUT 40**

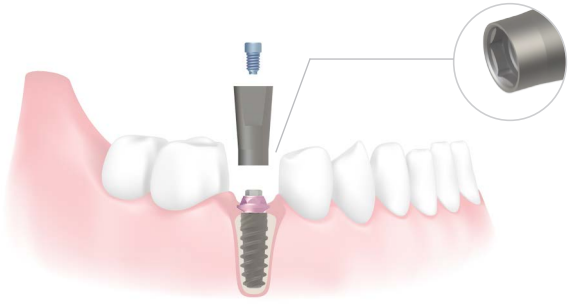

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO

Opcional

Réplica



Ref. **RITR SB 40** Ø **4** mm
Ref. **RIT SB 40** Ø **4** mm

Es necesario el uso del tornillo para modelo digital
(No incluido con la réplica)



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**



Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Es necesario el uso del tornillo para modelo digital
(No incluido con la réplica)



Tornillo clínico (2 mm)
Ref. **TMU 4048**

Base para prótesis cemento-atornillada (Directa a implante)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas usándolo como base mecanizada sobre la que se cementa la corona en el laboratorio.

Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.



Base para prótesis cemento-atornillada
rotacional (Ti)
(Directa a implante)

Ref. **PGZR 04010**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **1** mm	◉
Ref. **PGZR 04020**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **2** mm	◉
Ref. **PGZR 04030**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **3** mm	◉

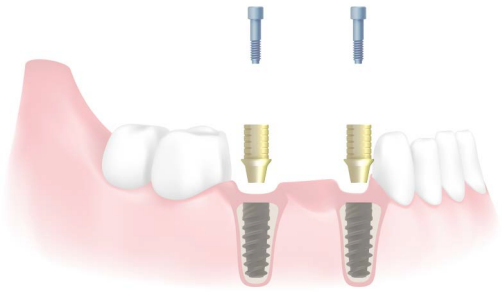


BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ROTACIONAL



Base para prótesis cemento-atornillada
anti-rotacional (Ti)
(Directa a implante)

Ref. **PGZA 04010**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **1** mm	⬢
Ref. **PGZA 04020**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **2** mm	⬢
Ref. **PGZA 04030**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **3** mm	⬢

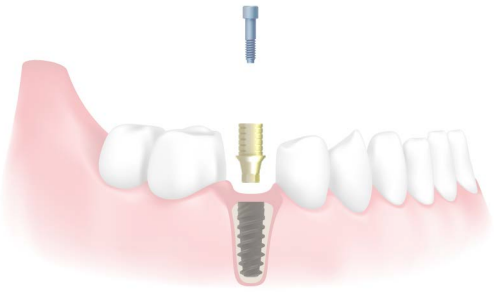

BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ANTI-ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm ⬢

Base para prótesis cemento-atornillada (Directa a multi-posición recto estético)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas usándolo como base mecanizada sobre la que se cementa la corona en el laboratorio.

Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.




Base para prótesis cemento-atornillada
rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PGZMUR 40** Ø **4** mm Alt. Hombro **0** mm



Base para prótesis cemento-atornillada
anti-rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PGZMUA 40** Ø **4** mm Alt. Hombro **0** mm

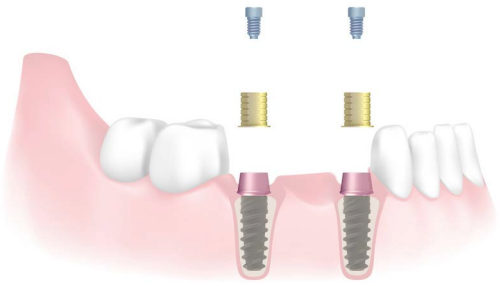

BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ROTACIONAL



BASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ANTI-ROTACIONAL


Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4** mm
Ref. **RIT SB 40** Ø **4** mm

Interfase compatible con el Sistema Cerec® (Directa a implante)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Permite un ajuste óptimo con el implante y nos permite conseguir una prótesis pasiva a través de la cementación.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.

Interfase compatible con el Sistema Cerec® anti-rotacional (Ti) (Directa a implante)



Ref. **PCERC 04020**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **2** mm	6
Ref. **PCERC 04030**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **3** mm	6
Ref. **PCERC 04040**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **4** mm	6

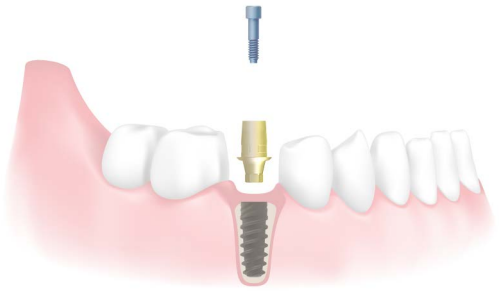

INTERFASE COMPATIBLE CEREC ANTI-ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm) + Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm 6

Interfase compatible con el Sistema Cerec®
(Directa a multi-posición recto estético)

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Indicaciones

Permite un ajuste óptimo con el implante y nos permite conseguir una prótesis pasiva a través de la cementación.

Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.



Interfase compatible con el Sistema Cerec®
rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PCERCMUR 40** Ø **4** mm Alt. Hombro **0** mm



Interfase compatible con el Sistema Cerec®
anti-rotacional (Ti)
(Directa a pilar)

Ref. **PCERCMUA 40** Ø **4** mm Alt. Hombro **0** mm



INTERFASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ROTACIONAL



INTERFASE PARA PRÓTESIS ATORNILLADA ANTI-ROTACIONAL


Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4** mm
Ref. **RIT SB 40** Ø **4** mm

Interfase para pilar multi-posición recto estético


Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

Una sola pieza.

Indicaciones

Está indicada para prótesis cemento-atornilladas unitarias o múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.

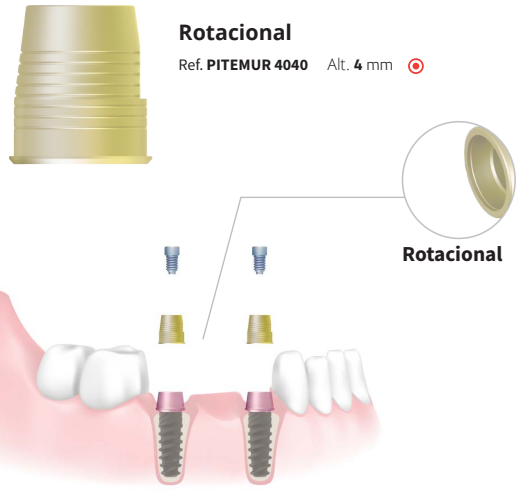

Rotacional
Ref. **PITEMUR 4040** Alt. **4** mm

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN ESTÉTICO



Anti-rotacional
Ref. **PITEMUA 4040** Alt. **4** mm

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN ESTÉTICO


Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4** mm
Ref. **RIT SB 40** Ø **4** mm

Interfase para pilar multi-posición recto y angulado

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 10 Ncm.

Una sola pieza.


Indicaciones

Está indicada para prótesis cemento-atornilladas múltiples.

Rotacional para prótesis múltiples.



Ref. **PITEMUTR 4040** Alt. **4** mm

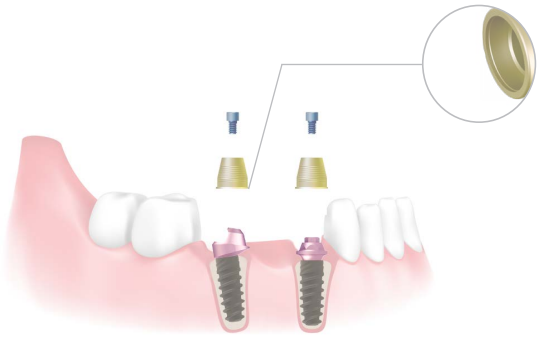

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO Y ANGULADO

Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (1,4 mm)
+ Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Pilar sobrecolado
Base mecanizada rotacional

Pilar fabricado en cromo cobalto con chimenea calcinable. Uso específico para laboratorio.

Indicaciones

Está indicado para fabricar prótesis atornilladas siendo necesario sobrecolar la parte más coronal.

Rotacional para prótesis múltiples.



Ref. **PSR 040** Ø **4** mm



PILAR SOBRECOLADO ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm)
+ Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm

Pilar sobrecolado
Base mecanizada anti-rotacional

Pilar fabricado en cromo cobalto con chimenea calcinable. Uso específico para laboratorio.

Indicaciones

Está indicado para fabricar prótesis atornilladas siendo necesario sobrecolar la parte más coronal.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.



Ref. **PSA 040** Ø **4** mm ⑥



PILAR SOBRECOLADO ANTI-ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (1,6 mm)
+ Tornillo lab. (1,6 mm)

Ref. **TP 040** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm ⑥

Pilar multi-posición recto estético slim rotacional


Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas múltiples.
Su forma anotómica cóncava permite a este pilar albergar el tejido mucoso sin tensión, favoreciendo la creación de un tejido conectivo lo suficientemente grueso que minimizará el infiltrado a nivel de la plataforma del implante.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.
Una sola pieza.



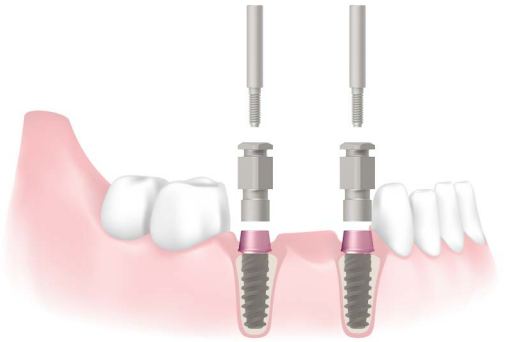

ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO

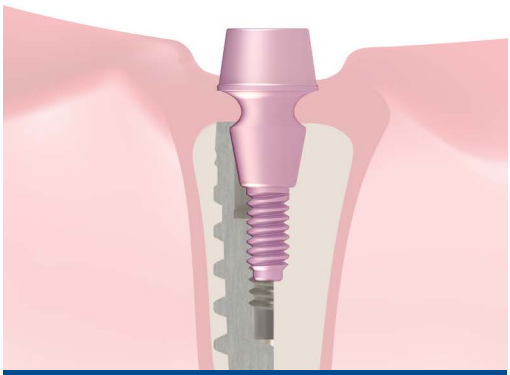

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto estético slim rotacional
Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUSLAR 04030**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **MUSLAR 04040**	Alt. Hombro **4** mm
Ref. **MUSLAR 04060**	Alt. Hombro **6** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPTR 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUR 4048** Ø **4** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUR 4048** Ø **4** mm



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUR 4048** Ø **4** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4** mm



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. **13,5** mm

Pilar multi-posición recto estético slim anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas unitarias de pequeño diámetro, por ejemplo, incisivos inferiores, incisivos laterales superiores.
Su forma anotómica cóncava permite a este pilar albergar el tejido mucoso sin tensión, favoreciendo la creación de un tejido conectivo lo suficientemente grueso que minimizará el infiltrado a nivel de la plataforma del implante.


El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.
Una sola pieza.








ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO

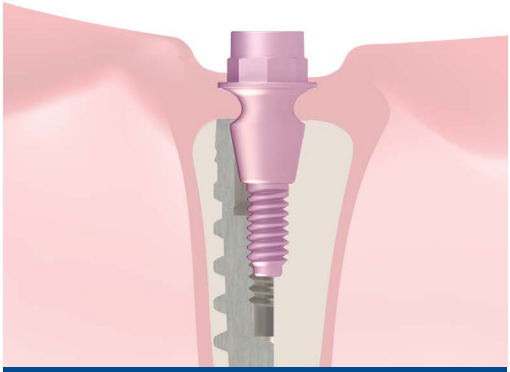

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE

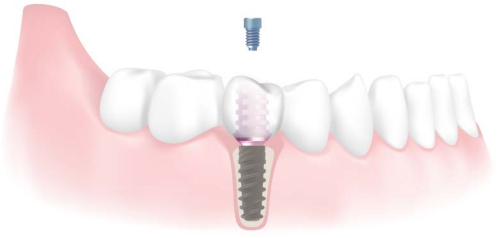

PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto estético slim anti-rotacional
Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUSLA 04030**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **MUSLA 04040**	Alt. Hombro **4** mm
Ref. **MUSLA 04060**	Alt. Hombro **6** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPT 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUA 4048** Ø **4** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUA 4048** Ø **4** mm



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUA 4048** Ø **4** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIT SB 40** Ø **4** mm



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. **13,5** mm

Octogonal

Pilar multi-posición recto estético rotacional


Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas múltiples, con alta exigencia estética. Tiene una emergencia anatómica que respeta el espacio biológico.

Permite una divergencia de los implantes de hasta 20º.
El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.
Una sola pieza.



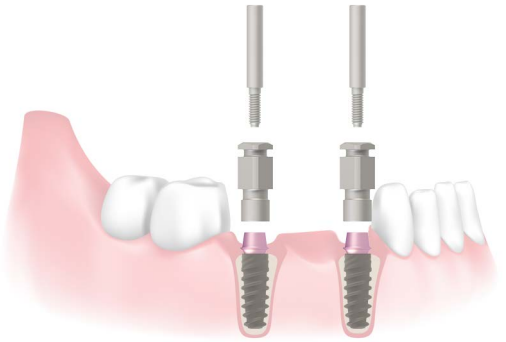

ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO

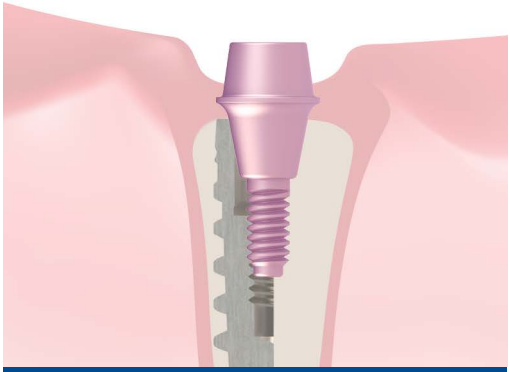

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto estético rotacional
Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUSR 04010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUSR 04020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUSR 04030**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **MUSR 04040**	Alt. Hombro **4** mm
Ref. **MUSR 04050**	Alt. Hombro **5** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPTR 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUR 4048** Ø **4** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUR 4048** Ø **4** mm



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUR 4048** Ø **4** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RITR SB 40** Ø **4** mm



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. **13,5** mm


Pilar multi-posición recto estético anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas unitarias.
Tiene una emergencia anatómica que respeta el espacio biológico.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.

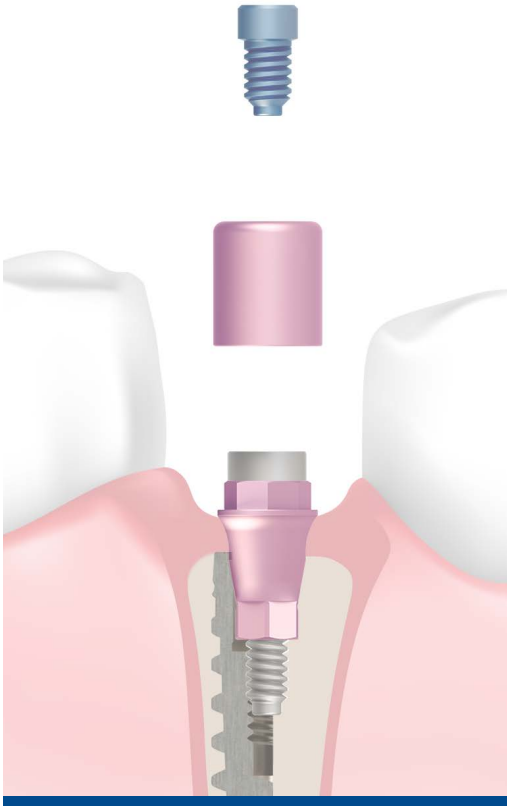

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE




ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto estético anti-rotacional
Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)
Dos piezas

Ref. **MUSA 04010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUSA 04020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUSA 04030**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **MUSA 04040**	Alt. Hombro **4** mm
Ref. **MUSA 04050**	Alt. Hombro **5** mm



Pilar transepitelial (Ti)
Una sola pieza

Ref. **MUSA S04010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUSA S04020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUSA S04030**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **MUSA S04040**	Alt. Hombro **4** mm
Ref. **MUSA S04050**	Alt. Hombro **5** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPT 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUA 4048** Ø **4** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUA 4048** Ø **4** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIT SB 40** Ø **4** mm



Pilar sobrecolado base mecanizada

Ref. **PSMUA 4048** Ø **4** mm



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 135** Long. **13,5** mm

Octogonal

Pilar multi-posición recto rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas múltiples.
Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.


El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Una sola pieza.







ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO

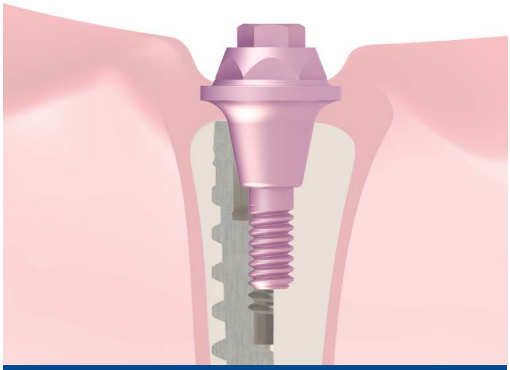

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto rotacional
Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUST 04010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUST 04020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUST 04030**	Alt. Hombro **3** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4,8** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4,8** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Compatible con

Llave multi-posición larga

Ref. **LLCAMU 244**



Llave multi-posición corta

Ref. **LLCAMU 174**



Rotacional Hexagonal


Pilar multi-posición recto anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas unitarias.
Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Dos piezas.

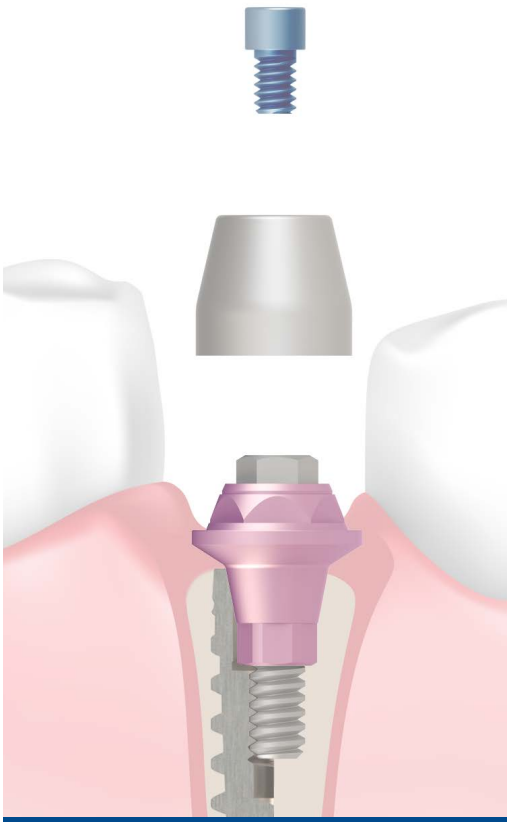

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición recto anti-rotacional
Para **conexión interna**





Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUSTA 04010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUSTA 04020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUSTA 04030**	Alt. Hombro **3** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMUA 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUTA 40** Ø **4,8** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTiMUTA 40** Ø **4,8** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Compatible con

Llave multi-posición larga

Ref. **LLCAMU 244**



Llave multi-posición corta

Ref. **LLCAMU 174**



Hexagonal

Pilar multi-posición angulado

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15º hasta 60º. Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Corrige grandes disparalelismos de los implantes.



ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO




PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



PRÓTESIS FINAL

Kit multi-posición angulado
Para **conexión interna**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MU 1504020**	**15°**	Alt. Hombro **2** mm	⦿
Ref. **MU 1504030**	**15°**	Alt. Hombro **3** mm	⦿
Ref. **MU 3004030**	**30°**	Alt. Hombro **3** mm	⦿
Ref. **MU 3004040**	**30°**	Alt. Hombro **4** mm	⦿
Ref. **MU 4504050**	**45°**	Alt. Hombro **5** mm	⦿
Ref. **MU 5004050**	**50°**	Alt. Hombro **5** mm	⦿
Ref. **MU 6004050**	**60°**	Alt. Hombro **5** mm	⦿

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40** ⦿

Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4** mm ⦿



El pilar incluye **transportador**

Opcional



Pilar Titanio de carga inmediata

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4** mm ⦿



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm ⬡

Pilar overdent

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis implanto-retenidas o implanto-soportadas.
Permite corregir la angulación de los implantes hasta 10º.

Existe un pilar calcinable que se usa como mecanismo de retención en la fabricación de barras para prótesis removibles.

El conjunto de procesado dispone de teflones de mayor y menor retención.



PREPARACIÓN TAPA + RETENEDOR



PILAR OVERDENT



PRÓTESIS FINAL

Pilar overdent
Para **conexión interna**



Pilar overdent (Ti)

Ref. **PKO 04008**	Ø **4** mm	Alt. **0,8** mm
Ref. **PKO 04016**	Ø **4** mm	Alt. **1,6** mm
Ref. **PKO 04030**	Ø **4** mm	Alt. **3** mm
Ref. **PKO 04040**	Ø **4** mm	Alt. **4** mm
Ref. **PKO 04050**	Ø **4** mm	Alt. **5** mm
Ref. **PKO 04070**	Ø **4** mm	Alt. **7** mm

Pilar overdent calcinable

Ref. **PKOC 08**

Suministrado con

Tapa




Ref. **TKO 4048**

Anillo separador



Ref. **AKO 4048**

Retenedor



Ref. **RKO 4048**

Compatible con



Llave overdent

Ref. **LLKOD 250**

Opcional



Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm


Pilar de bola

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis implanto-retenidas o implanto-soportadas. Permite corregir la angulación de los implantes hasta 30º.

Permite corregir grandes divergencias entre los implantes.
La retención se obtiene mediante un o-ring, (se suministra ya colocado en la tapa).
Gran retención.

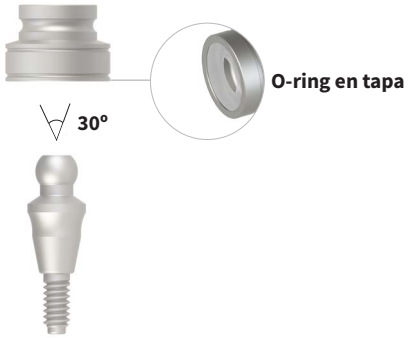

O-RING + TAPA



PILAR DE BOLA



PRÓTESIS FINAL

Pilar de bola
Para **conexión interna**



Pilar de bola (Ti)

Ref. **PKB 04008**	Alt. **0,8** mm	◉
Ref. **PKB 04016**	Alt. **1,6** mm	◉
Ref. **PKB 04030**	Alt. **3** mm	◉
Ref. **PKB 04040**	Alt. **4** mm	◉
Ref. **PKB 04050**	Alt. **5** mm	◉

Suministrado con

Tapa



Ref. **TKB 4048**

O-ring

Ref. **OB 4048**

Anillo separador



Ref. **AKO 4048**

Compatible con



Llave manual

Ref. **LLMC 220**

Ref. **LLML 290**



Llave protésica

Ref. **LLCA 174**

Ref. **LLCA 220**

Ref. **LLCA 290**

Opcional




Réplica

Ref. **RI SB 040** Ø **4** mm ⬡

Componentes protésicos

Para **conexión externa**

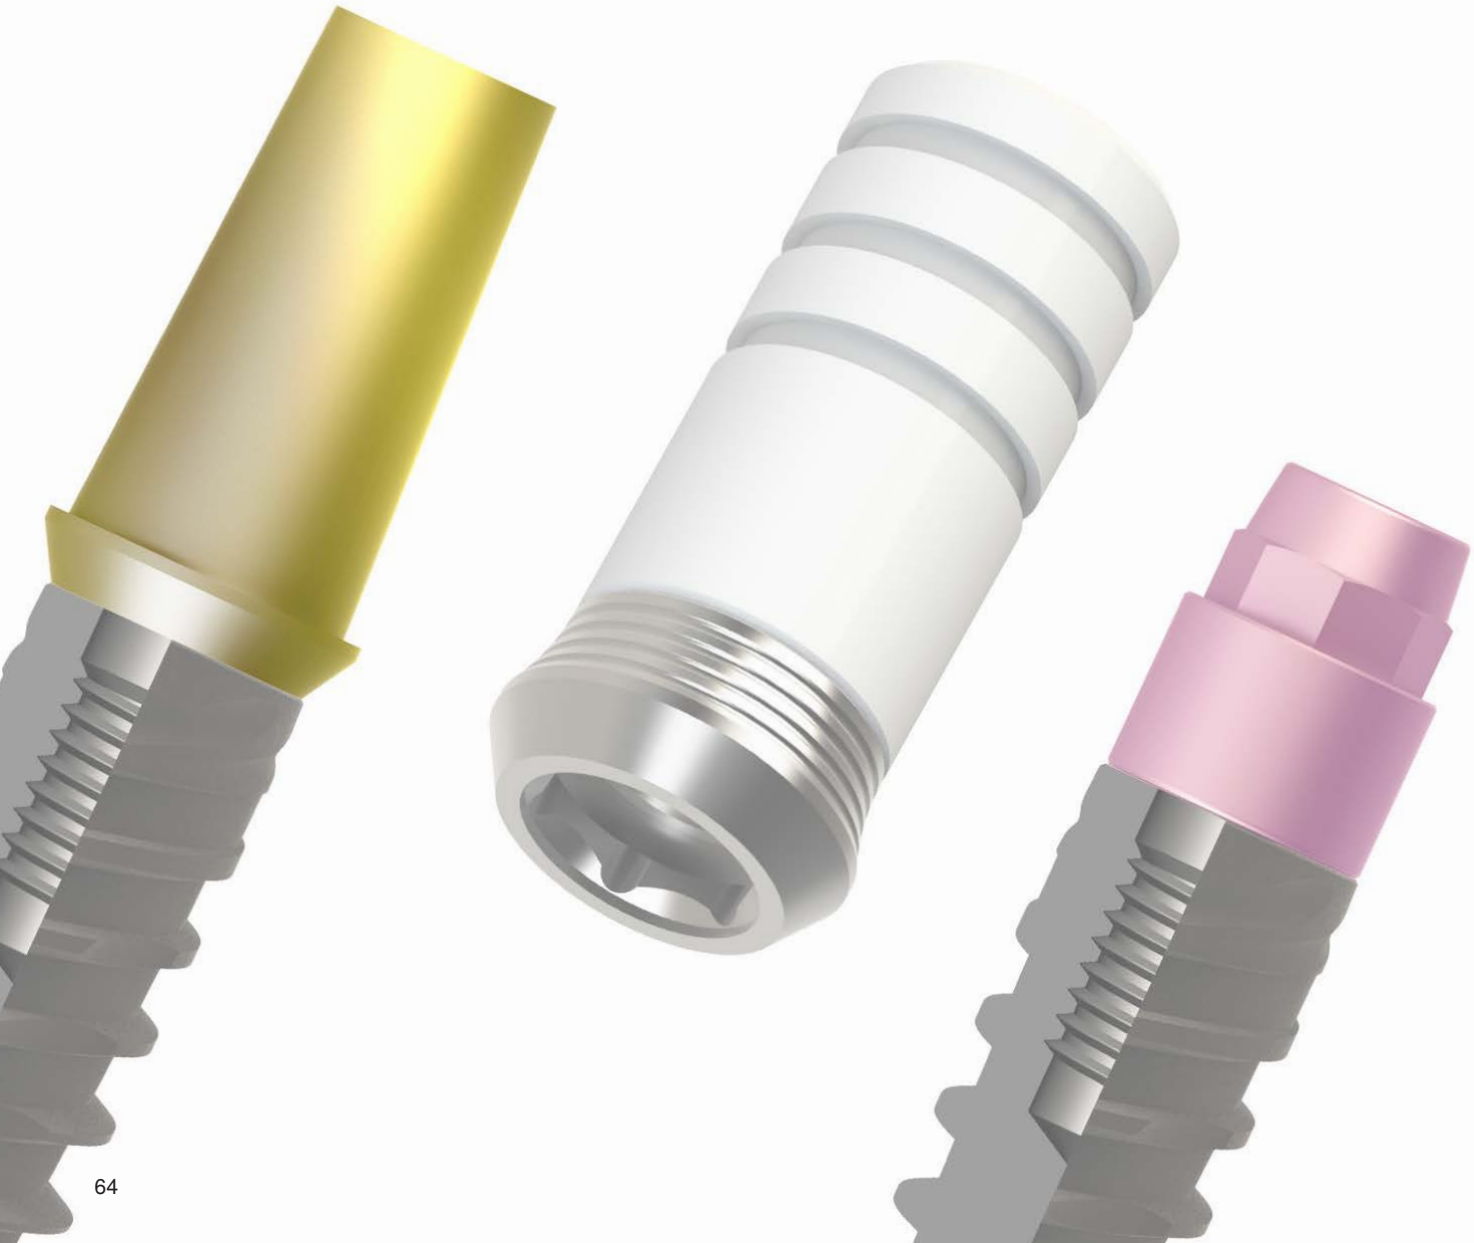

CE

Amplia gama de soluciones protésicas

Esquema protésico
Pág. 66

Prótesis de carga inmediata
Pág. 70

Prótesis cementada
Pág. 72

Prótesis cemento-atornillada
Pág. 76

Prótesis atornillada
Pág. 78

Prótesis removible
Pág. 88

Esquema protésico CE

Pilares de cicatrización

Para implantes de conexión externa: **IPXE**

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis cementada


Ref. **PC 4010**


Ref. **PC 4020**
Ref. **PC 4040**
Ref. **PC 4060**


Ref. **PCC 4040**
Ref. **PCC 4060**


Ref. **AIP 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **TAIP 200**


Ref. **RI 40**


Ref. **PCIA 40**
Ref. **PCIR 40**

Prótesis cemento-atornillada


Ref. **PC 4010**


Ref. **PC 4020**
Ref. **PC 4040**
Ref. **PC 4060**


Ref. **PCC 4040**
Ref. **PCC 4060**


Ref. **AIP 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **TAIP 200**


Ref. **RI 40**


Ref. **PCIA 40**
Ref. **PCIR 40**


Ref. **PCT 4030**


Ref. **AIPT 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **RIT 40**


Ref. **PTIMUA 4048**


Ref. **PCM 4030**


Ref. **AIPMU 40**
Ref. **AIPMUA 40**


Ref. **TAIPMU 135**


Ref. **SBT MUST**
Ref. **SBT MUSTA**


Ref. **RIMA SB 40**


Ref. **PTIMUTR 40**
Ref. **PTiMUTA 40**

Pilares definitivos rectos



Ref. **PR 4000**
Ref. **PA 4000**
Ref. **PA 4010**
Ref. **PA 4030**
Ref. **PA 4050**



Ref. **PGZA 40**



Ref. **MUS 4020**
Ref. **MUS 4030**
Ref. **MUS 4050**



Ref. **PITEMUA 4040**



Ref. **MUST 4010**
Ref. **MUST 4020**
Ref. **MUST 4030**



Ref. **PITEMUTR 4040**

Pilares definitivos angulados



Ref. **PA 154010**
Ref. **PA 154030**
Ref. **PA 154050**



Ref. **PA 304010**
Ref. **PA 304030**
Ref. **PA 304050**



Ref. **MU 154020**
Ref. **MU 154030**



Ref. **MU 304030**
Ref. **MU 304040**



Ref. **PITEMUTR 4040**

Tornillos



Ref. **TP 4048** x 2



Ref. **TP 4048** x 2



Ref. **TMU 4048** x 2



Ref. **TMUT 40** x 2

Conjunto de procesado

Esquema protésico CE

Pilares de cicatrización
Para implantes de conexión externa: **IPXE**

Toma de registros

Prótesis provisional/ carga inmediata

Prótesis atornillada


Ref. **PC 4010**


Ref. **PC 4020**
Ref. **PC 4040**
Ref. **PC 4060**


Ref. **PCC 4040**
Ref. **PCC 4060**


Ref. **AIP 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **TAIP 200**


Ref. **RI 40**


Ref. **PCIA 40**
Ref. **PCIR 40**


Ref. **PCT 4030**


Ref. **AIPT 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **RIT 40**


Ref. **PTIMUA 4048**


Ref. **PCM 4030**


Ref. **AIPMU 40**
Ref. **AIPMUA 40**


Ref. **TAIPMU 135**


Ref. **SBT MUST**
Ref. **SBT MUSTA**


Ref. **RIMA SB 40**


Ref. **PTIMUTR 40**
Ref. **PTiMUTA 40**

Prótesis removible


Ref. **PC 4010**


Ref. **PC 4020**
Ref. **PC 4040**
Ref. **PC 4060**


Ref. **PCC 4040**
Ref. **PCC 4060**


Ref. **AIP 40**


Ref. **TAIP 135**


Ref. **TAIP 200**


Ref. **RI 40**

Pilares definitivos rectos



Ref. **PSA 40**
Ref. **PSR 40**




Ref. **MUS 4020**
Ref. **MUS 4030**
Ref. **MUS 4050**

Ref. **PCMUA 4048**



Ref. **MUST 4010**
Ref. **MUST 4020**
Ref. **MUST 4030**



Ref. **MUSTA 4010**
Ref. **MUSTA 4020**
Ref. **MUSTA 4030**

Ref. **PCMUTR 40**
Ref. **PCMUTA 40**



Ref. **PKO 4008**
Ref. **PKO 4016**
Ref. **PKO 4030**
Ref. **PKO 4040**
Ref. **PKO 4050**
Ref. **PKO 4070**

Ref. **PKOC 08**

Pilares definitivos angulados



Ref. **MU 154020**
Ref. **MU 154030**



Ref. **MU 304030**
Ref. **MU 304040**

Ref. **PCMUTR 40**

Tornillos



Ref. **TP 4048** x 2



Ref. **TMU 4048** x 2



Ref. **TMUT 40** x 2


Conjunto de procesado



Ref. **TKO 4048**



Ref. **AKO 4048**



Ref. **RKO 4048**


Pilar de carga inmediata

Pilar disponible en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Ambos pilares están indicados para prótesis provisionales cementadas o atornilladas.


Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.

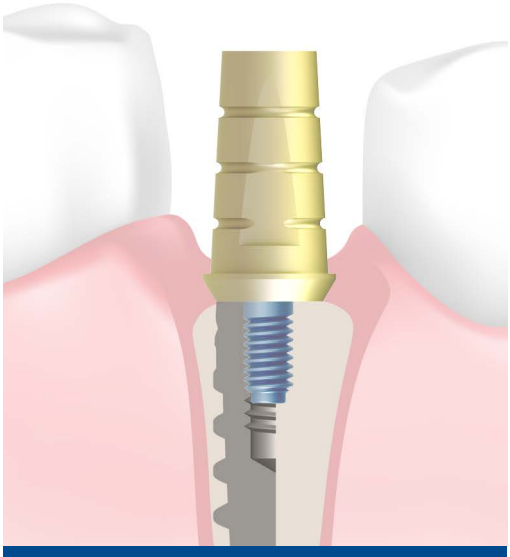

PILAR DE CARGA INMEDIATA + TORNILLO PROTÉSICO

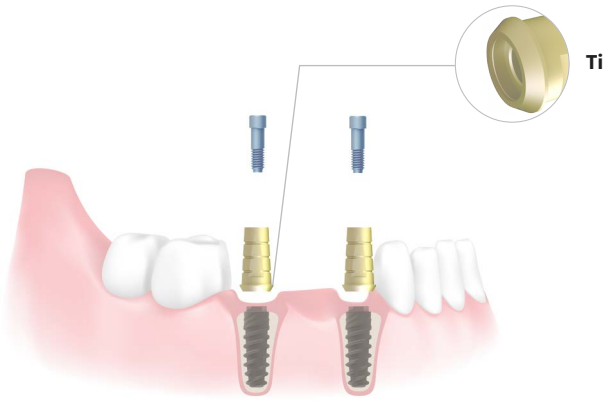

PILAR DE CARGA INMEDIATA ROTACIONAL

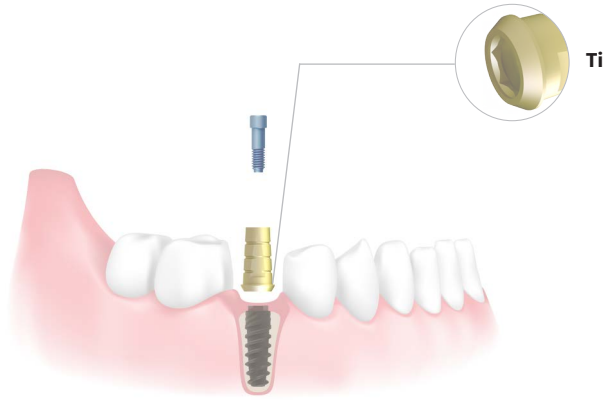

PILAR DE CARGA INMEDIATA ANTI-ROTACIONAL

CE

Pilar de carga inmediata
Para **conexión externa**



Pilar carga inmediata
rotacional (Ti)

Ref. **PCIR 40** Ø **4** mm



Pilar carga inmediata
anti-rotacional (Ti)

Ref. **PCIA 40** Ø **4** mm

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4** mm

Pilar recto


Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Disponible en distintas alturas de hombro.


Indicaciones

Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples.


Rotacional para prótesis múltiples.
Anti-rotacional para prótesis unitarias.

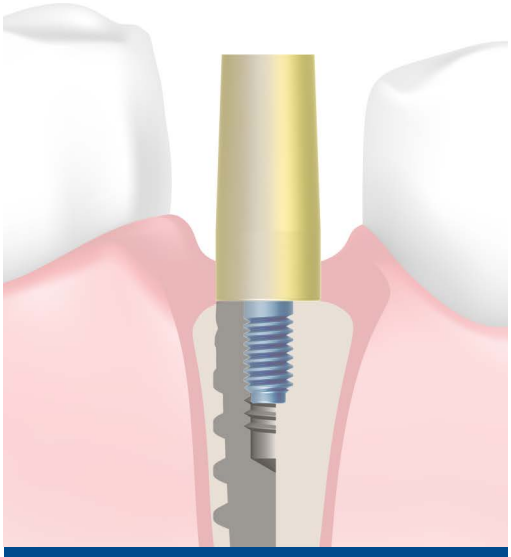

PILAR RECTO + TORNILLO PROTÉSICO

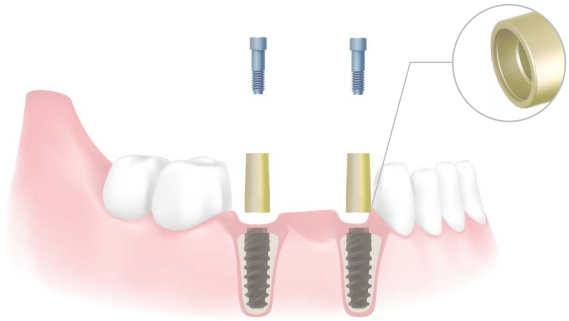

PILAR RECTO ROTACIONAL

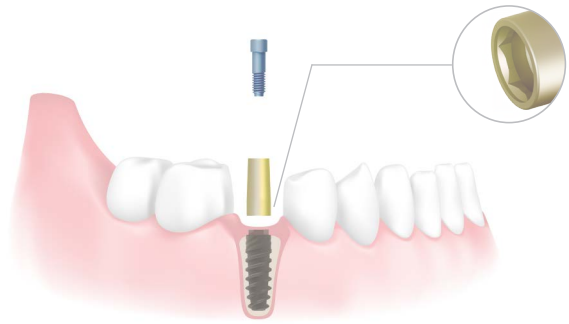

PILAR RECTO ANTI-ROTACIONAL

CE

Pilar recto
Para **conexión externa**



Pilar recto rotacional (Ti)

Ref. **PR 4000** Ø **4** mm Alt. Hombro **0** mm



Pilar recto anti-rotacional (Ti)

Ref. **PA 4000**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **0** mm
Ref. **PA 4010**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **PA 4030**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **PA 4050**	Ø **4** mm	Alt. Hombro **5** mm

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4** mm


Pilar angulado

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Disponible en distintas alturas de hombro.

Indicaciones


Está indicado para prótesis cementadas unitarias o múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15º hasta 30º.

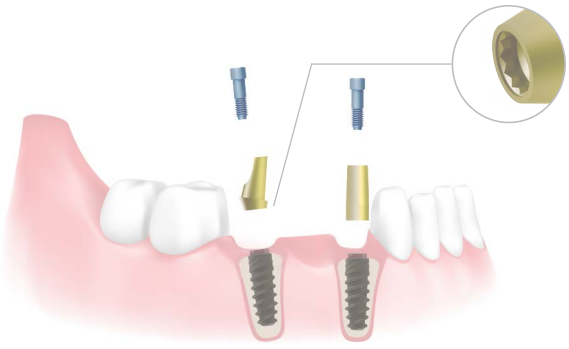

PILAR ANGULADO 15º

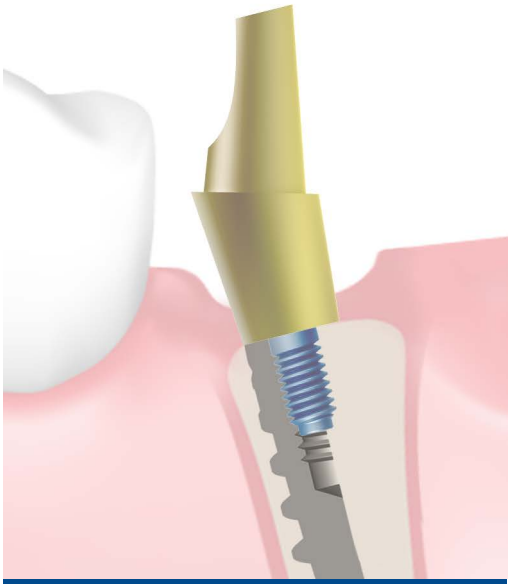

PILAR ANGULADO + TORNILLO PROTÉSICO

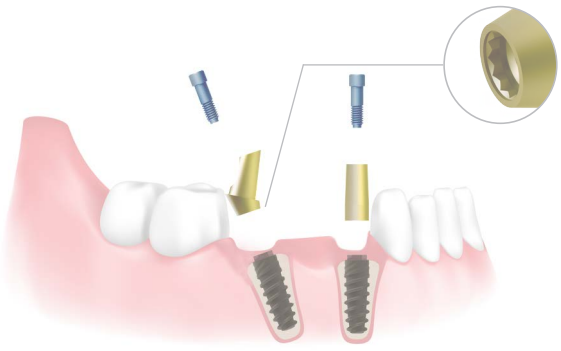

PILAR ANGULADO 30º

CE

Pilar angulado
Para **conexión externa**



Pilar angulado (Ti)

Ref. **PA 154010**	**15°**	Alt. Hombro **1** mm	6
Ref. **PA 154030**	**15°**	Alt. Hombro **3** mm	6
Ref. **PA 154050**	**15°**	Alt. Hombro **5** mm	6



Pilar angulado (Ti)

Ref. **PA 304010**	**30°**	Alt. Hombro **1** mm	6
Ref. **PA 304030**	**30°**	Alt. Hombro **3** mm	6
Ref. **PA 304050**	**30°**	Alt. Hombro **5** mm	6

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** ∅ **4** mm 6

Base para prótesis cemento-atornillada


Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas usándolo como base mecanizada sobre la que se cementa la corona en el laboratorio.



Ref. **PGZA 40** Ø **4** mm

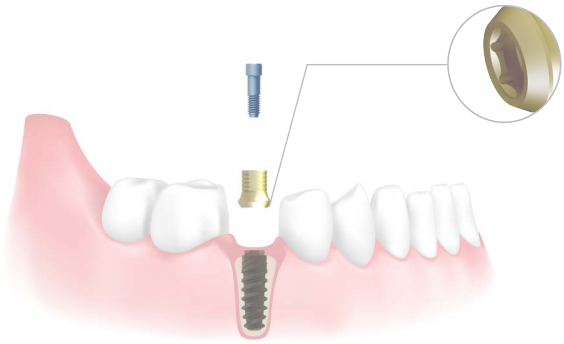

BASE PARA PRÓTESIS CEMENTO-ATORNILLADA

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4** mm

Interfase para pilar multi-posición

Interfase para pilar multi-posición recto y angulado.
Fabricado en titanio grado V.

Indicaciones


Están indicadas para prótesis cemento-atornilladas múltiples.
Rotacional para prótesis múltiples.

Interfase para pilar multi-posición recto y angulado

Torque recomendado: 25 Ncm.



Ref. **PITEMUTR 4040** Alt. **4** mm

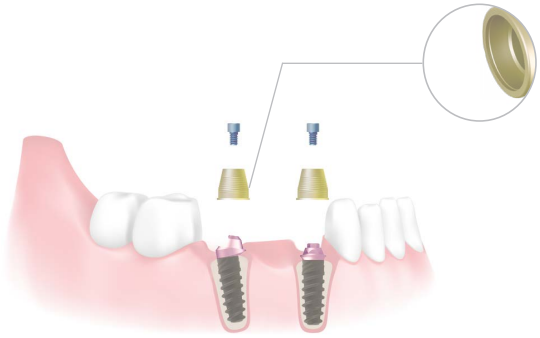

DIRECTO A PILAR MULTI-POSICIÓN RECTO Y ANGULADO

Suministrado con tornillo



Tornillo clínico (1,4 mm)
+ Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2

Opcional



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Pilar sobrecolado
Base mecanizada rotacional

Pilar fabricado en cromo cobalto con chimenea calcinable. Uso específico para laboratorio.


Indicaciones

Está indicado para fabricar prótesis atornilladas siendo necesario sobrecolar la parte más coronal.

Rotacional para prótesis múltiples.



Ref. **PSR 40** Ø **4** mm

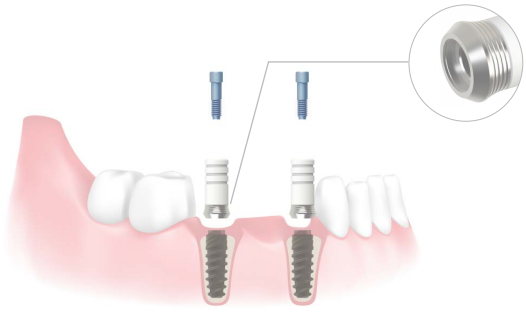

PILAR SOBRECOLADO ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4** mm

Pilar sobrecolado
Base mecanizada anti-rotacional

Pilar fabricado en cromo cobalto con chimenea calcinable. Uso específico para laboratorio.


Indicaciones

Está indicado para fabricar prótesis atornilladas siendo necesario sobrecolar la parte más coronal.

Anti-rotacional para prótesis unitarias.



Ref. **PSA 40** Ø **4** mm ⬢6

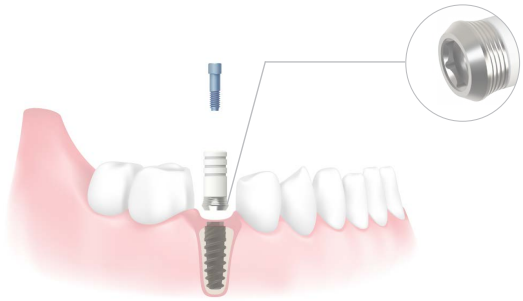

PILAR SOBRECOLADO ANTI-ROTACIONAL

Suministrado con dos tornillos



Tornillo clínico (2 mm)
+ Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TP 4048** x 2

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4** mm ⬢6


Pilar multi-posición recto estético anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas multiples. Tiene una emergencia anatómica que respeta el espacio biológico.
Puede ser utilizado tanto en el sector anterior como en el posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 25 Ncm.
Una sola pieza.

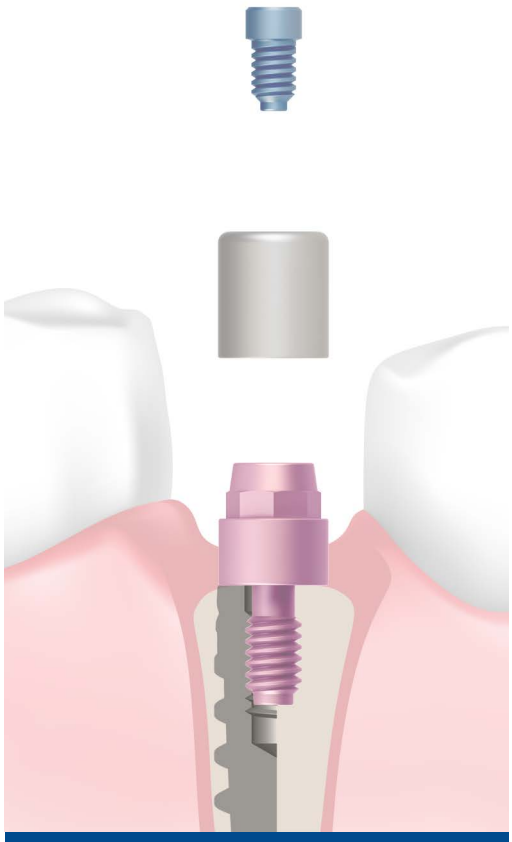

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE

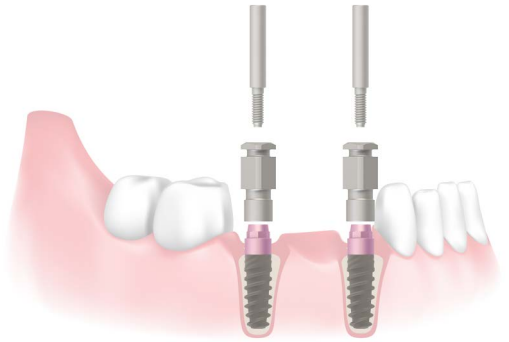

ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO



PRÓTESIS FINAL

CE

Kit multi-posición recto estético

Para **conexión externa**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUS 4020**	Alt. Hombro **2** mm 8
Ref. **MUS 4030**	Alt. Hombro **3** mm 8
Ref. **MUS 4050**	Alt. Hombro **5** mm 8

Incluido en el kit



Tornillo clínico (2 mm) + Tornillo lab. (2 mm)

Ref. **TMU 4048** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCT 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIP 200** Long. **20** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPT 40** 8

Pilar calcinable

Ref. **PCMUA 4048** Ø **4** mm 8

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUA 4048** Ø **4** mm 8



Réplica transepitelial

Ref. **RIT 40** Ø **4** mm 8

8 Octogonal

Pilar multi-posición recto rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas múltiples.
Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Una sola pieza.





ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO

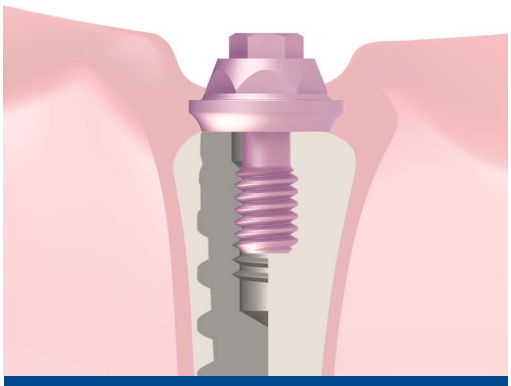

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE



PRÓTESIS FINAL

CE

Kit multi-posición recto rotacional
Para **conexión externa**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUST 4010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUST 4020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUST 4030**	Alt. Hombro **3** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4,8** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4,8** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Compatible con

Llave multi-posición larga

Ref. **LLCAMU 244**



Llave multi-posición corta

Ref. **LLCAMU 174**



Rotacional Hexagonal


Pilar multi-posición recto anti-rotacional

Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.


Indicaciones

Está indicado para prótesis atornilladas unitarias.
Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Dos piezas.

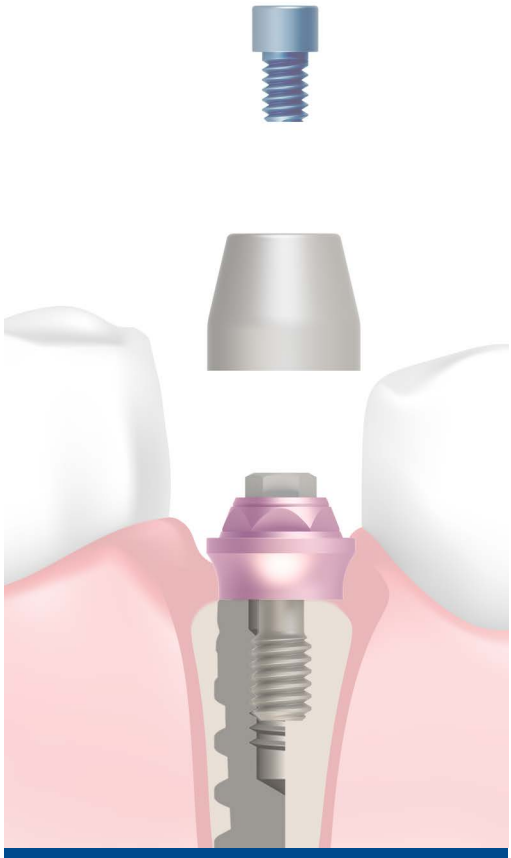

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE

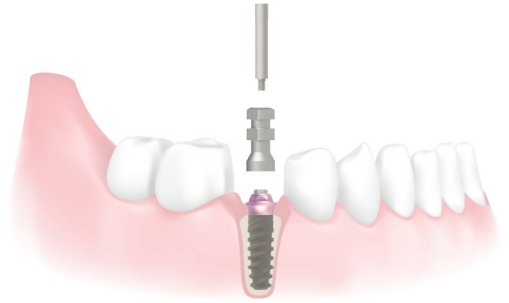

ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO



PRÓTESIS FINAL

CE

Kit multi-posición recto anti-rotacional

Para **conexión externa**





Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MUSTA-4010**	Alt. Hombro **1** mm
Ref. **MUSTA-4020**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MUSTA-4030**	Alt. Hombro **3** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5** mm



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMUA 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUTA 40** ∅ **4,8** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTiMUTA 40** ∅ **4,8** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** ∅ **4,8** mm

Compatible con

Llave multi-posición larga

Ref. **LLCAMU 244**



Llave multi-posición corta

Ref. **LLCAMU 174**



Hexagonal

Pilar multi-posición angulado


Pilar transepitelial fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis atornilladas múltiples. Corrige la angulación de los implantes desde 15º hasta 30º. Pilar transepitelial indicado para el sector posterior.

El torque recomendado del tornillo protésico es de 10 Ncm.
Corrige grandes disparalelismos de los implantes.



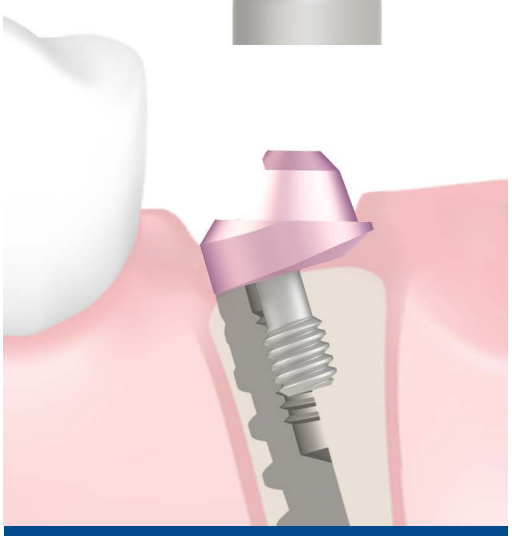

PILAR TRANSEPITELIAL + PILAR DE CIERRE

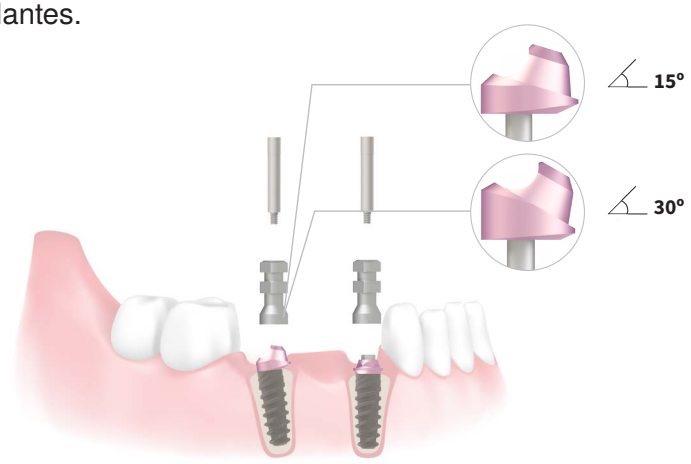

ADITAMENTO DE IMPRESIÓN + TORNILLO




PRÓTESIS FINAL

CE


Kit multi-posición angulado

Para **conexión externa**



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MU 154020**	**15°**	Alt. Hombro **2** mm
Ref. **MU 154030**	**15°**	Alt. Hombro **3** mm



Pilar transepitelial (Ti)

Ref. **MU 304030**	**30°**	Alt. Hombro **3** mm
Ref. **MU 304040**	**30°**	Alt. Hombro **4** mm

Incluido en el kit



Tornillo clínico (1,4 mm) + Tornillo lab. (1,4 mm)

Ref. **TMUT 40** x 2



Pilar de cierre transepitelial

Ref. **PCM 4030**



Tornillo aditamento de impresión

Ref. **TAIPMU 135** Long. **13,5** mm



El pilar incluye **transportador**



Aditamento de impresión transepitelial

Ref. **AIPMU 40**

Pilar calcinable

Ref. **PCMUTR 40** Ø **4,8** mm

Opcional



Pilar de carga inmediata (Ti)

Ref. **PTIMUTR 40** Ø **4,8** mm



Réplica transepitelial

Ref. **RIMA SB 40** Ø **4,8** mm

Pilar overdent

Pilar fabricado en titanio grado V. El torque recomendado para su colocación es de 30 Ncm.

Indicaciones


Está indicado para prótesis implanto-retenidas o implanto-soportadas.
Permite corregir la angulación de los implantes hasta 10º.

Existe un pilar calcinable que se usa como mecanismo de retención en la fabricación de barras para prótesis removibles.

El conjunto de procesado dispone de teflones de mayor y menor retención.



PREPARACIÓN TAPA + RETENEDOR

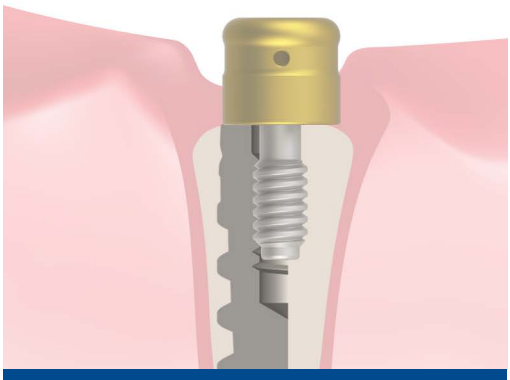

PILAR OVERDENT



PRÓTESIS FINAL

CE

Pilar overdent
Para **conexión externa**



Pilar overdent (Ti)

Ref. **PKO 4008**	Ø **4** mm	Alt. **0,8** mm	◉
Ref. **PKO 4016**	Ø **4** mm	Alt. **1,6** mm	◉
Ref. **PKO 4030**	Ø **4** mm	Alt. **3** mm	◉
Ref. **PKO 4040**	Ø **4** mm	Alt. **4** mm	◉
Ref. **PKO 4050**	Ø **4** mm	Alt. **5** mm	◉
Ref. **PKO 4070**	Ø **4** mm	Alt. **7** mm	◉

Pilar overdent calcinable

Ref. **PKOC 08** ◉

Suministrado con

Tapa




Ref. **TKO 4048**

Anillo separador



Ref. **AKO 4048**

Retenedor



Ref. **RKO 4048**

Compatible con



Llave overdent

Ref. **LLKOD 250**

Opcional



Réplica

Ref. **RI 40** Ø **4** mm ⬢


galimplant 3D® Exacto

Precisión y facilidad

Simulación de implantes dentales en 3D. Una operación segura, eficiente y práctica.


Planificación

Planifique sus implantes protesicamente guiados y seleccione los aditamentos protésicos más adecuados.

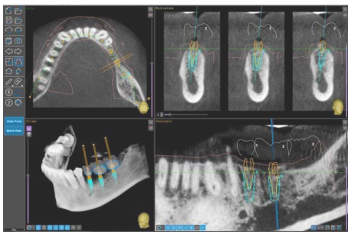


Simulación en 2D y 3D


Simulación de implantes en los modelos 2D y 3D. Completa identificación del canal mandibular. Creación de imágenes panorámicas.

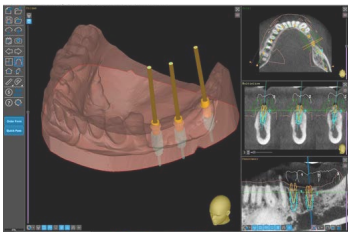


Software exclusivo

Un software que permite la simulación en 3D de la planificación de los implantes directamente en su ordenador para el diseño de guías quirúrgicas.

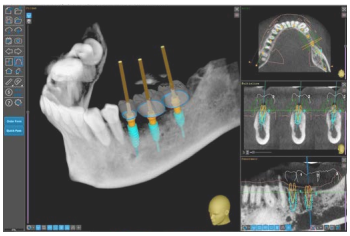


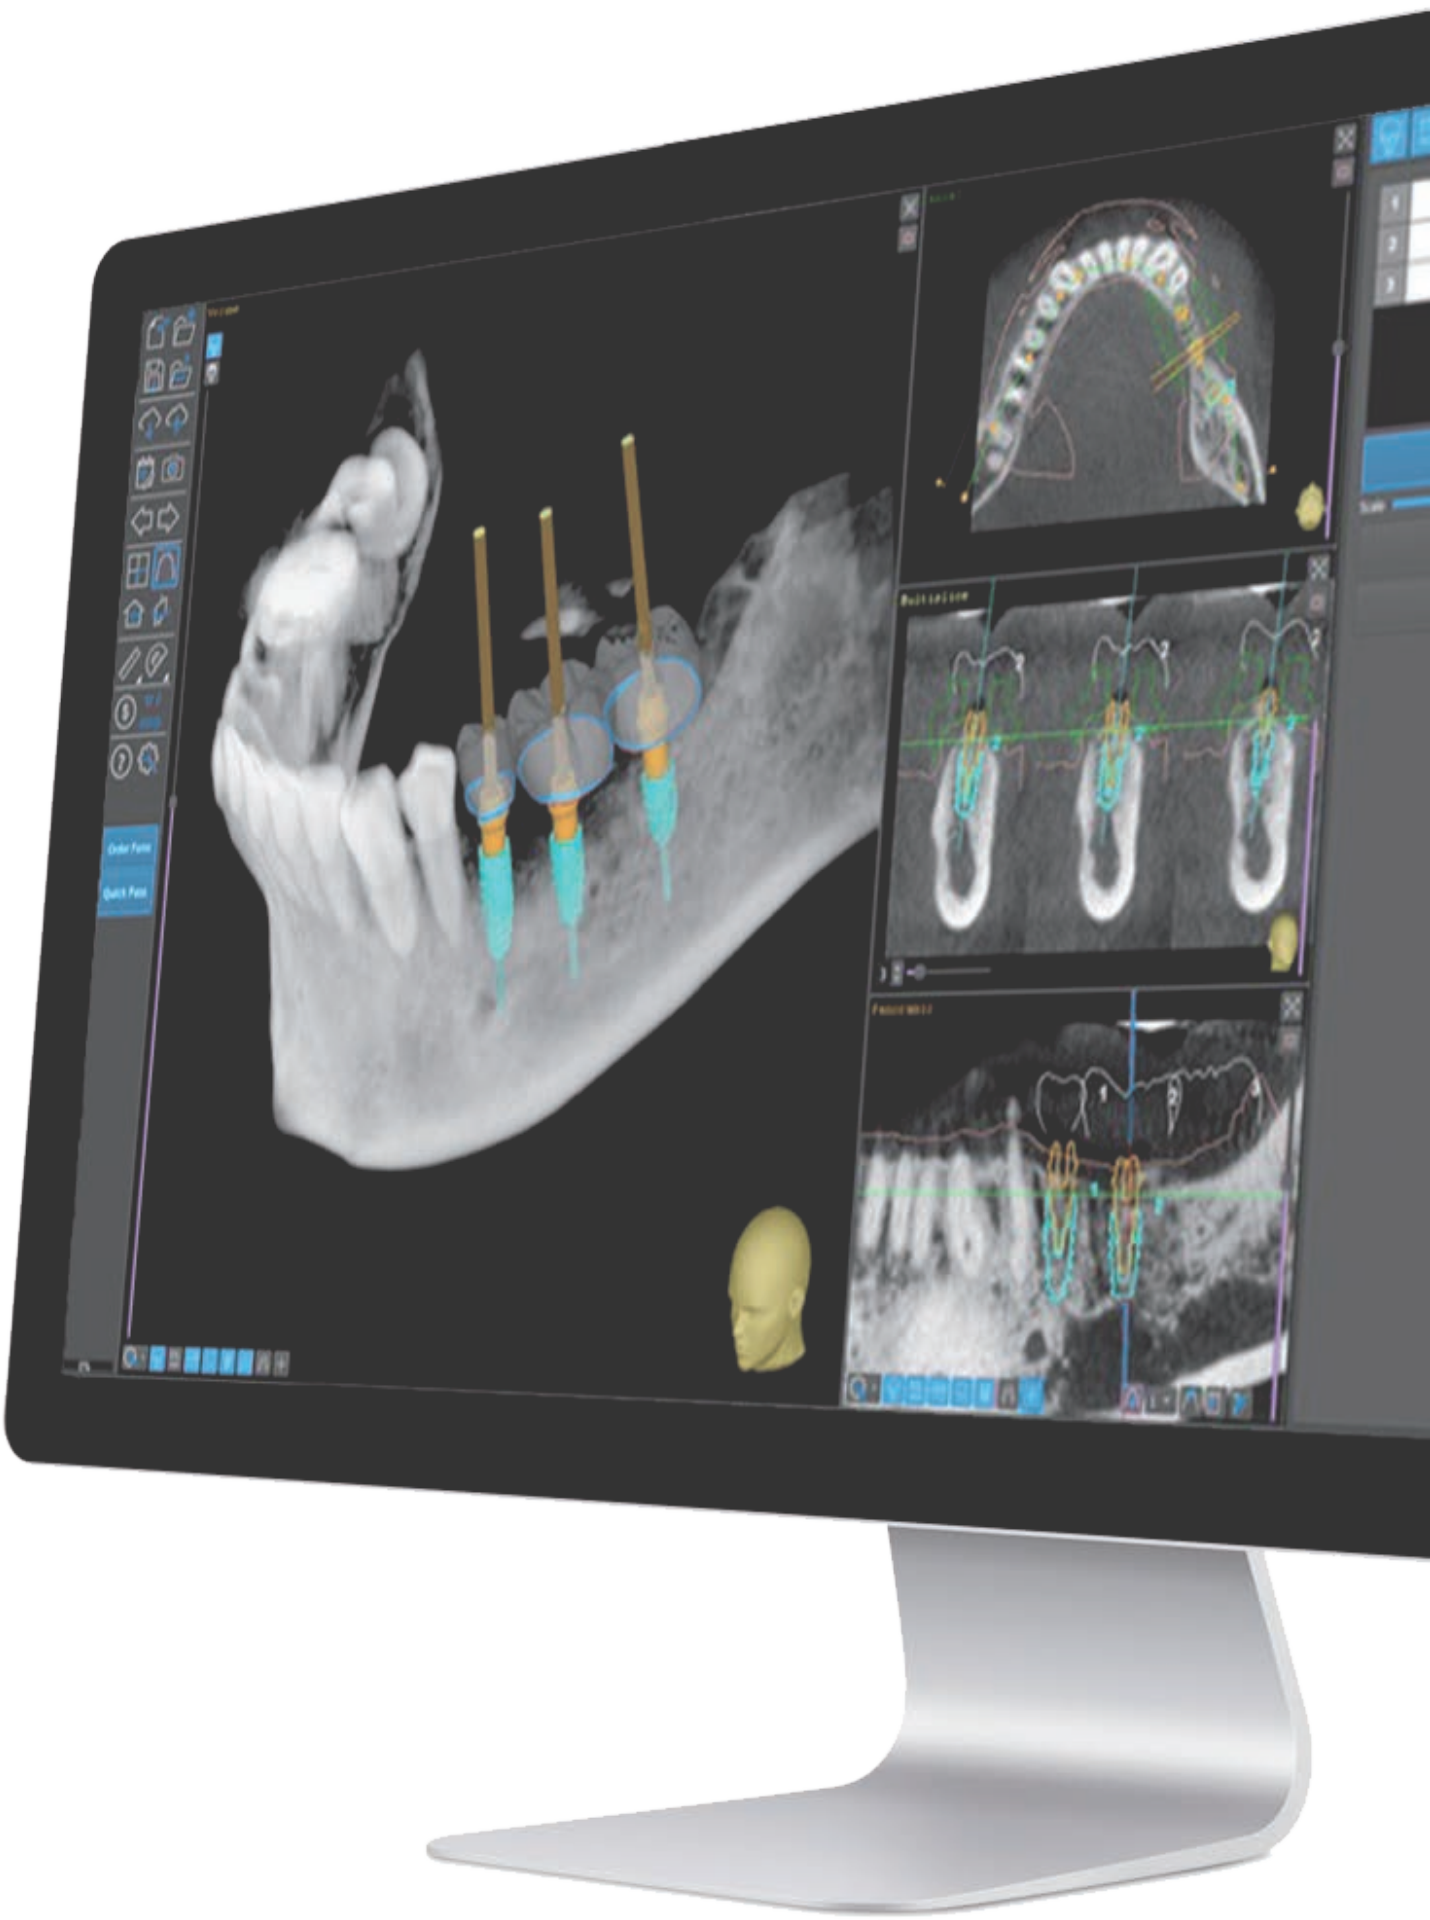


Planificación
Galimplant 3D
Flujo de requerimientos y tiempo de espera

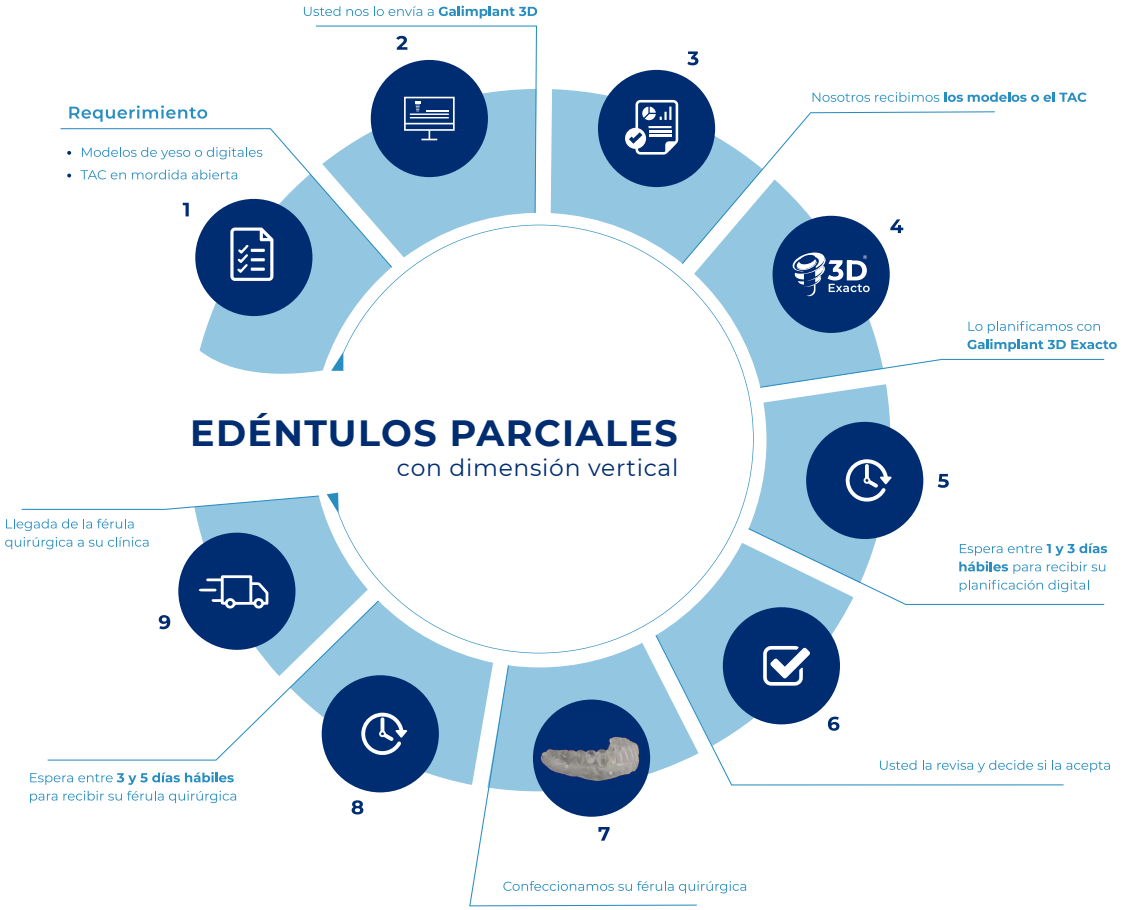

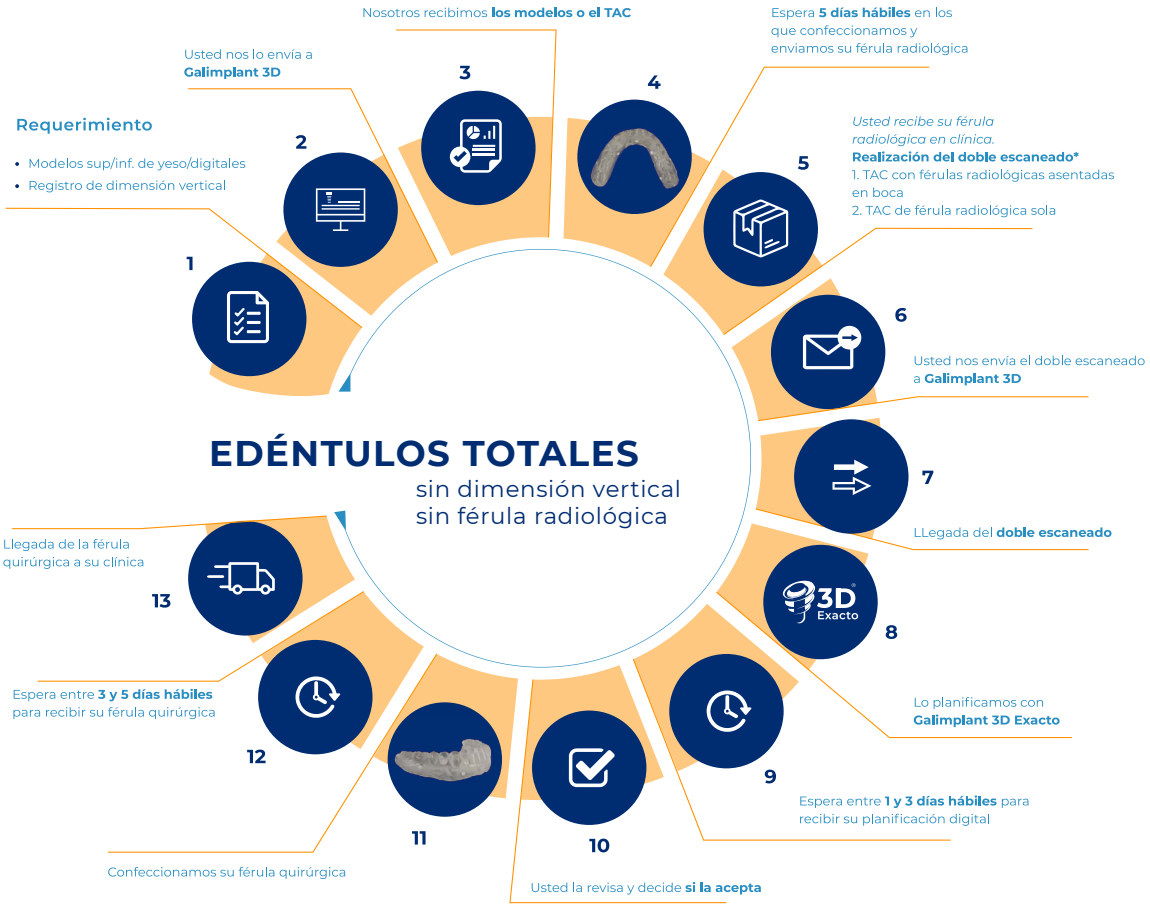


Requerimiento
• Modelos sup/inf. de yeso/digitales
• Registro de dimensión vertical
1
2
Usted nos lo envía a Galimplant 3D
3
Nosotros recibimos los modelos o el TAC
4
Espera 5 días hábiles en los que confeccionamos y enviamos su férula radiológica
5
Usted recibe su férula radiológica en clínica.
Realización del doble escaneado*
1. TAC con férulas radiológicas asentadas en boca
2. TAC de férula radiológica sola
6
Usted nos envía el doble escaneado a Galimplant 3D
7
LLegada del doble escaneado
8
3D Exacto
Lo planificamos con Galimplant 3D Exacto
9
Espera entre 1 y 3 días hábiles para recibir su planificación digital
10
Usted la revisa y decide si la acepta
11
Confeccionamos su férula quirúrgica
12
Espera entre 3 y 5 días hábiles para recibir su férula quirúrgica
13
Llegada de la férula quirúrgica a su clínica
EDÉNTULOS TOTALES
sin dimensión vertical
sin férula radiológica

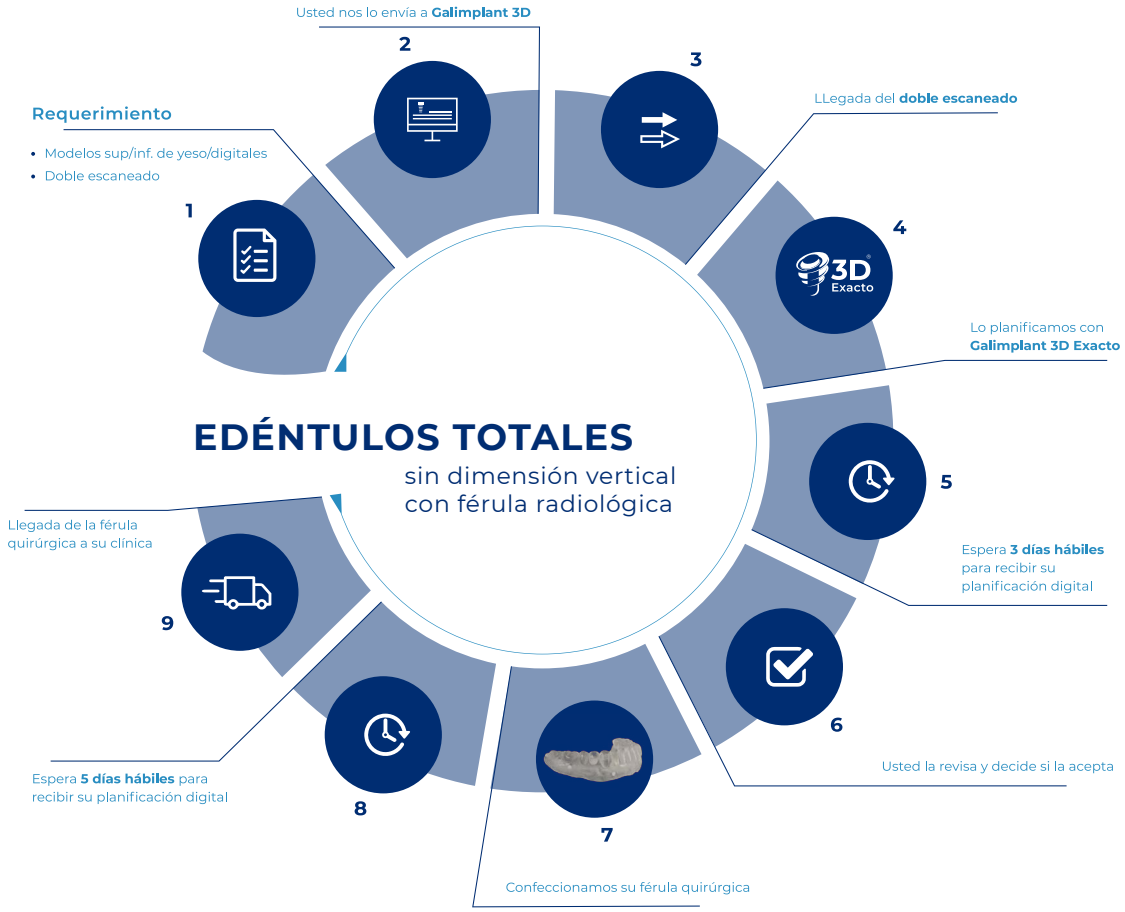
Requerimiento
• Modelos sup/inf. de yeso/digitales
• Doble escaneado
1
2
Usted nos lo envía a Galimplant 3D
3
LLegada del doble escaneado
4
3D Exacto
Lo planificamos con Galimplant 3D Exacto
5
Espera 3 días hábiles para recibir su planificación digital
6
Usted la revisa y decide si la acepta
7
Confeccionamos su férula quirúrgica
8
Espera 5 días hábiles para recibir su planificación digital
9
Llegada de la férula quirúrgica a su clínica
EDÉNTULOS TOTALES
sin dimensión vertical
con férula radiológica

Regenerador óseo

Adbone TCP



0,5 g Ref. **TCP050110G**
1 g Ref. **TCP050105G**

Estéril e indicado para utilizarse como material de relleno, sin responsabilidad de carga, en cavidades óseas maxilares y mandibulares producidas por un defecto óseo o como consecuencia de una intervención quirúrgica.

Su uso está indicado para aplicaciones del tipo:

- Relleno de cavidades óseas obtenidas tras extracción dentaria a fin de evitar la reabsorción del proceso alveolar.
- Relleno de cavidades quirúrgicas originadas por la exodoncia de dientes totalmente incluidos.
- Relleno de cavidades quirúrgicas generadas tras apicetomía y quistectomía periapical.
- Recubrimiento de las fenestraciones óseas que se producen en aquellos casos en los que la dimensión vestíbulo-lingual de la cresta alveolar es reducida.
- Relleno de defectos de ajuste en los márgenes que quedan entre los onlays de hueso autólogo y lecho quirúrgico.
- Relleno de cavidades óseas generadas por la pérdida de un diente definitivo en edades en las que no es factible su sustitución por un implante.
- Como material adyuvante para que los resultados estéticos sean óptimos, como suele ocurrir en el caso de las exodoncias del frente anterior, previniendo así el colapso del hueso y la encía.
- Elevaciones del seno maxilar.

Membranas

Reabsorbibles de origen equino, hemostáticas y estériles.

Su uso está indicado en cirugía maxilar y en implantología para aplicaciones de tipo:

- Recubrimiento de defectos y fijación de materiales de aumento en el campo de la regeneración ósea guiada.
- Recubrimiento de la pared externa del seno y de pequeñas perforaciones de la mucosa sinusal en las cirugías de elevación del seno maxilar.
- Cirugías de relleno óseo como membrana de barrera.
- Recubrimiento de alvéolos post extracción.
- Recubrimiento de implantes y rellenos maxilares laterales.
- Protección de la membrana sinusal de Schneider.

Membrana cover®

Membrana de colágeno

Tamaño: 30 x 25 x 0,2 mm

Biocompatibilidad (1-5): 5

Tiempo de degradación: 4-6 semanas

Hidratación (minutos): 1-2 minutos en suero fisiológico

Aguanta tensión (1-5): 4

Fijación: Sí, mediante sutura o chinchetas. No necesario en pequeños defectos y/o contenidos.

Engrosa biotipo: 0,3 a 0,5 mm

Indicaciones:
- Reparación de pequeñas perforaciones de la membrana sinusal.
- Fenestraciones en implantes.
-Contención de biomaterial para aumento de volumen.

Ref. **CVR-01**

Membrana heart®

Membrana de pericardio

Tamaño: 50 x 30 x 0,2 mm

Biocompatibilidad (1-5): 5

Tiempo de degradación: 12-16 semanas

Hidratación (minutos): 1-2 minutos en suero fisiológico

Aguanta tensión (1-5): 5


Fijación: Sí, mediante sutura o chinchetas. No necesario en pequeños defectos y/o contenidos.

Engrosa biotipo: 0,1 a 0,3 mm

Indicaciones:
-Grandes perforaciones membrana sinusal.
-Defecto horizontal dentro del marco óseo. Hasta grandes defectos.
-Protección de injertos corticales o RTG.

Ref. **HRT-002**


Cajas quirúrgicas

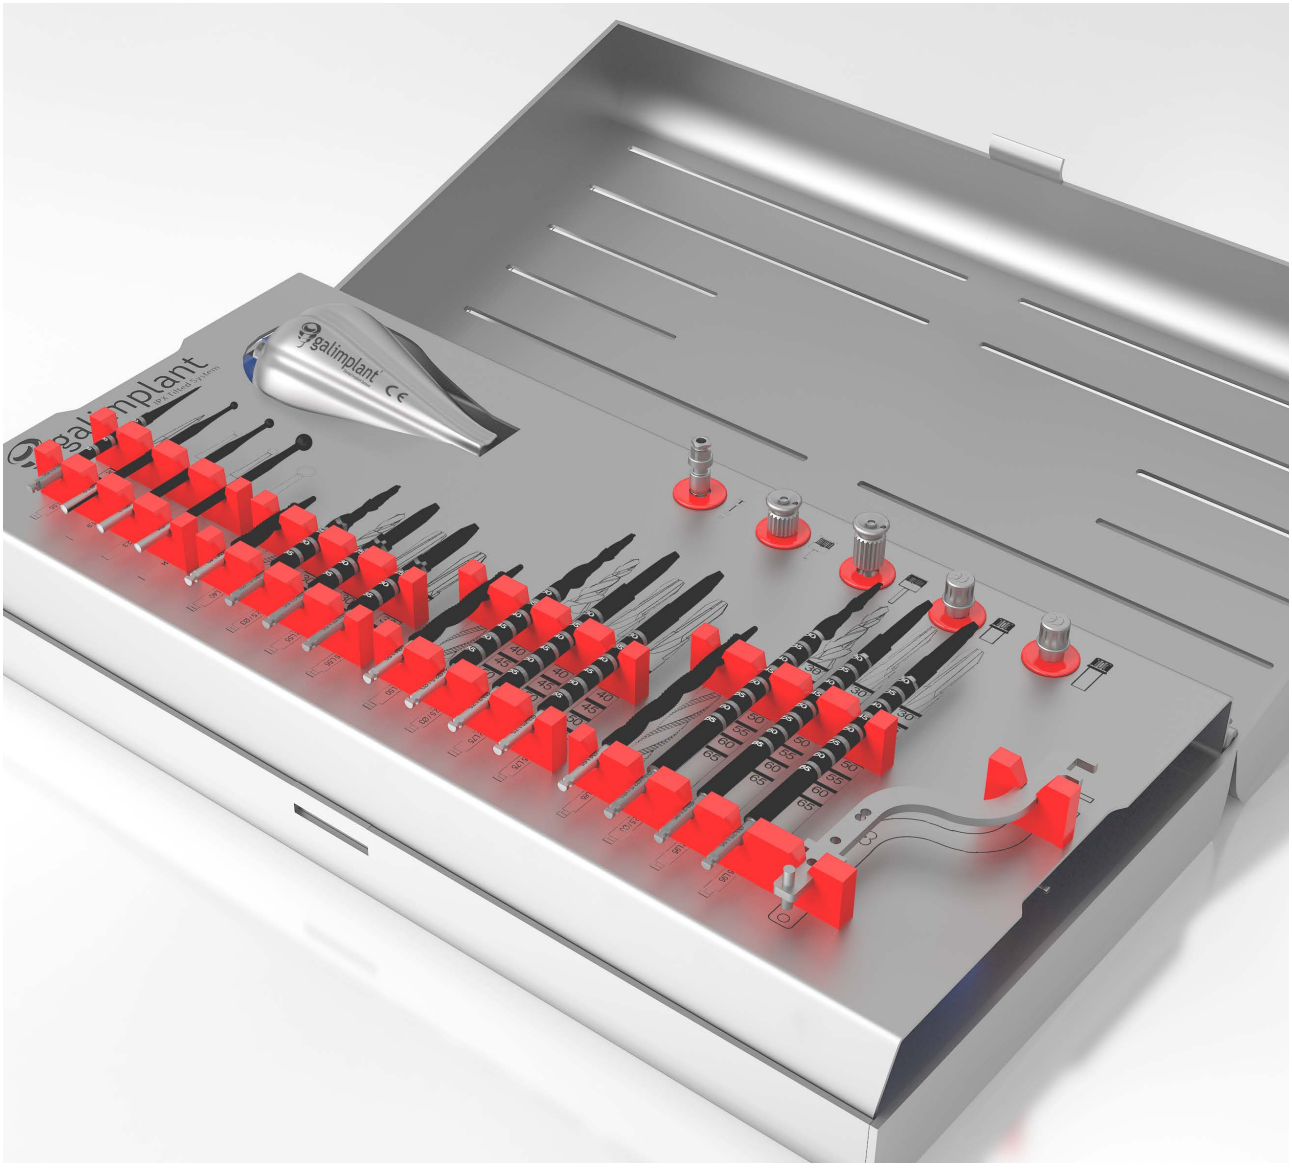

Caja para implantes cigomáticos

Ref. **CQ CM**


Contiene las herramientas necesarias para la colocación de implantes cigomáticos **Galimplant®**.

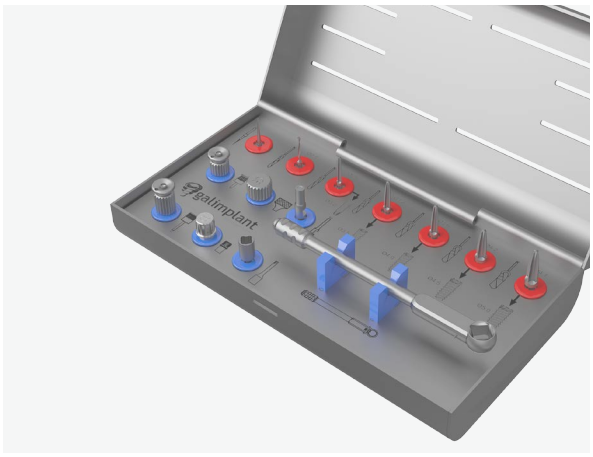

Caja quirúrgica mini

Ref. **CQM IMPL**


Esta caja quirúrgica contiene lo mínimo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®**.

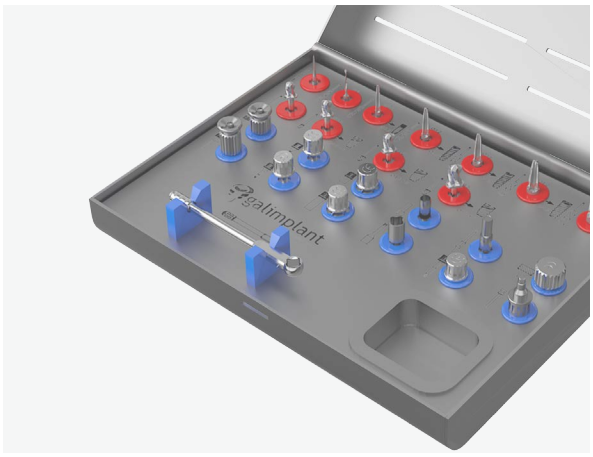

Caja quirúrgica

Ref. **CQ IMPL**


Esta caja quirúrgica contiene todo lo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®** y su prótesis.

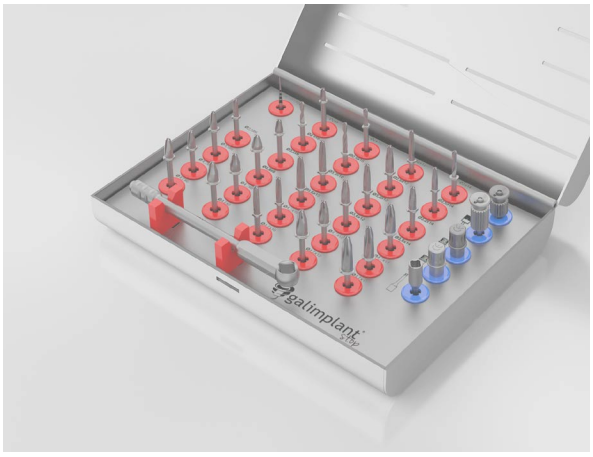

Caja fresas con tope

Ref. **CQ STOP**


Esta caja quirúrgica contiene fresas con tope para la colocación de los implantes **Galimplant®**.

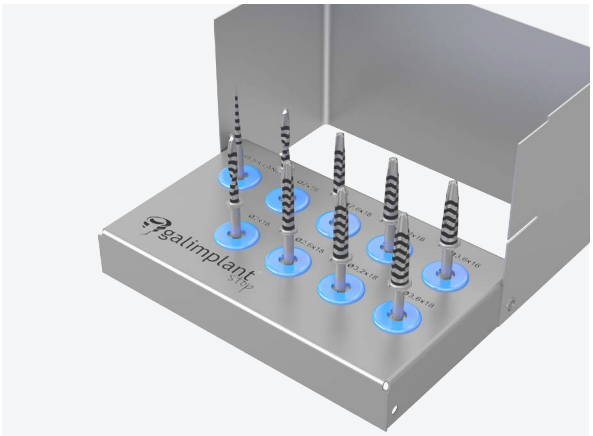

Caja fresas especiales

Ref. **C FESP L**


Contiene 2 grupos de fresas para longitudes especiales.

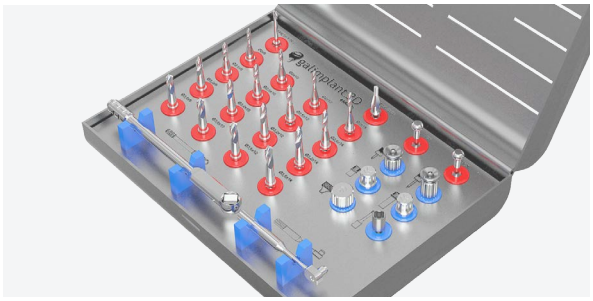

Caja cirugía guiada

Ref. **CQ 3D**


Diseñada para realizar cualquier cirugía guiada con el sistema **Galimplant 3D exacto**.

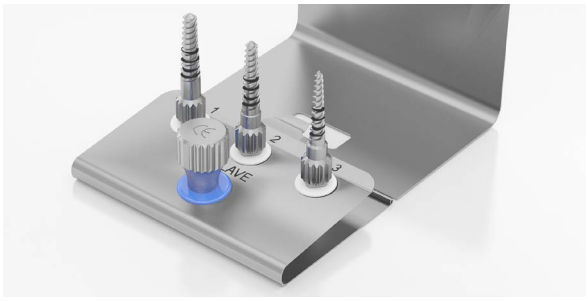

Osteótomos

Ref. **C OST**

Contiene 3 dilatadores óseos de diferentes diámetros.

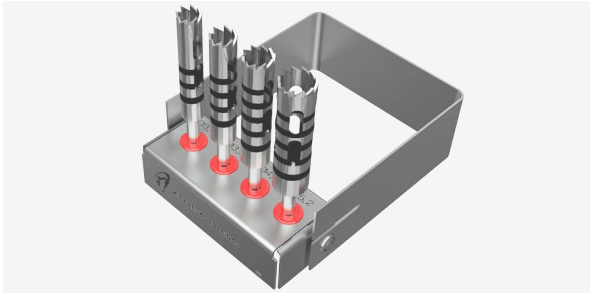

Trefinas

Ref. **C TREF**


Contiene 4 trefinas de diferentes diámetros.



Extractores

Ref. **KIT EXT/LE**

Contiene 4 extractores de diferentes diámetros.

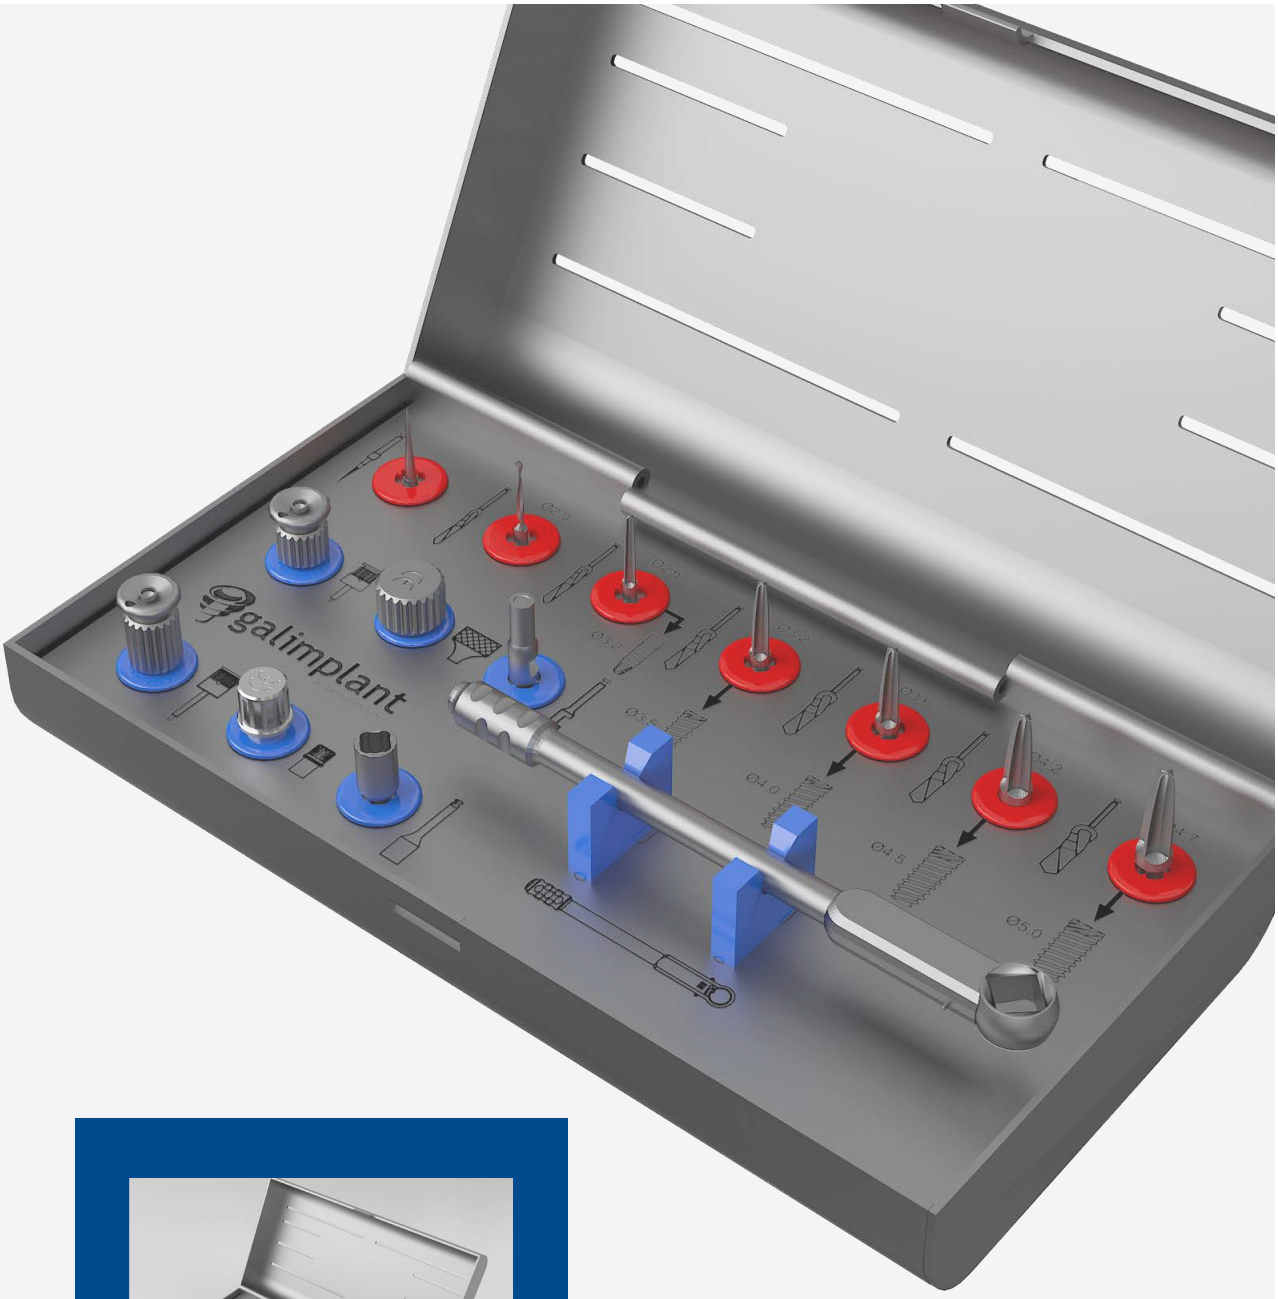



Caja quirúrgica mini

Esta caja quirúrgica contiene lo mínimo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®**.

Mini

Caja quirúrgica mini

Ref. **CQM IMPL**

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza

Fresas de diferentes diámetros

Llaves

Dado manual

Dado directo corto


Prolongador de fresas

Llave motor

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

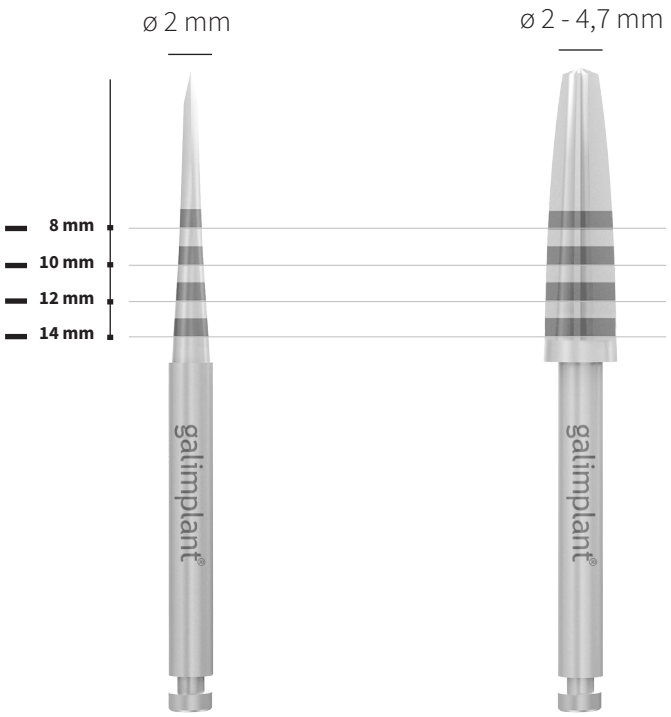


Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.

Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **8 mm**, **10 mm**, **12 mm** y **14 mm**.

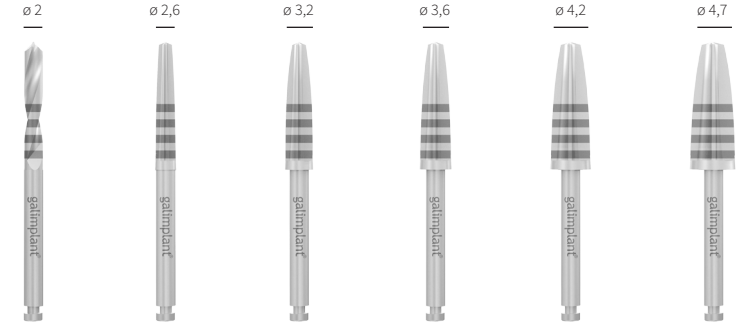

Ref. **K FRES**

Mini



Llave manual corta

Ref. **LLMC 220**

Destornillador corto válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Dado manual

Ref. **DMA 150**

Conectado al porta-implante, se utiliza para insertar el implante de forma manual.



Llave manual larga

Ref. **LLML 290**

Destornillador largo válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Prolongador de fresas

Ref. **P FRES**

Incrementa la longitud de cualquier fresa del sistema **Galimplant®**.



Llave motor

Ref. **LLM 215**


Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.

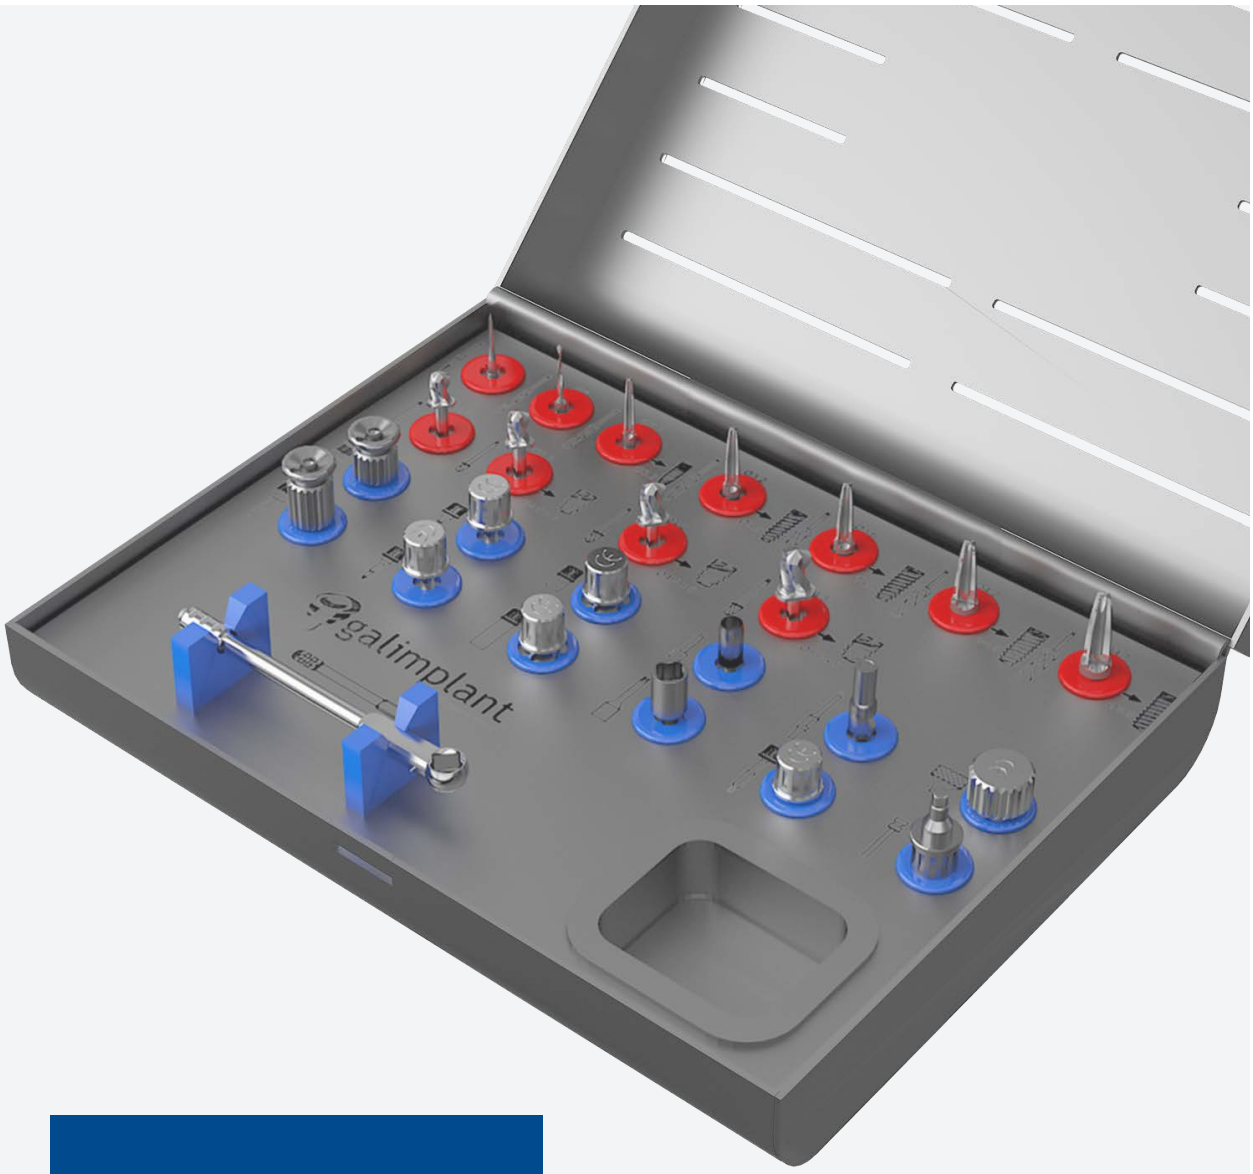



Caja quirúrgica

Esta caja quirúrgica contiene todo lo necesario para la colocación de un implante **Galimplant®** y su prótesis.

Quirúrgica

Caja quirúrgica

Ref. **CQ IMPL**

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza

Fresas de diferentes diámetros

Fresas con tope para implantes de 6 mm

Llaves

Dados

Bisturí circular

Llave motor

Prolongador de fresas

Llave para carraca directa a implante


Dado manual

Llave overdent

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

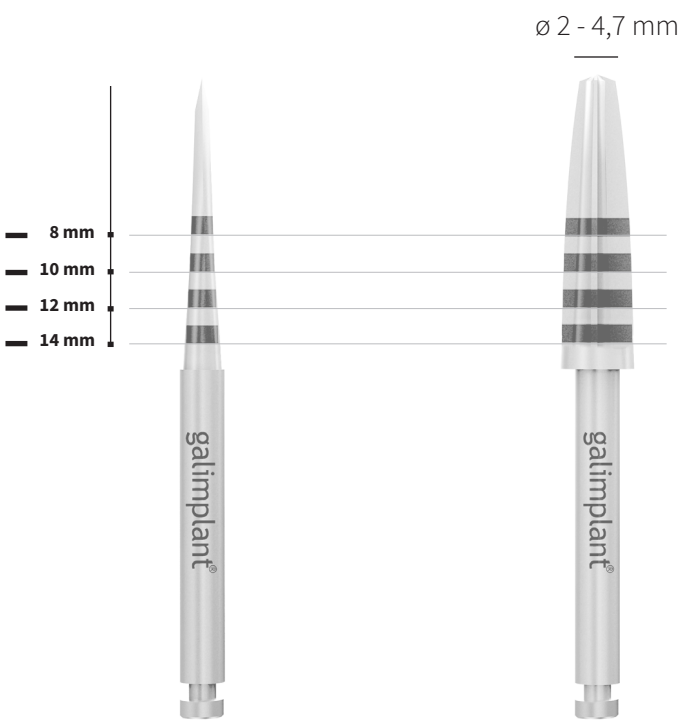



Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.


Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.


Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **8 mm**, **10 mm**, **12 mm** y **14 mm**.

Fresas con tope

Para crear el lecho en dirección y profundidad del implante de **6 mm** de longitud.

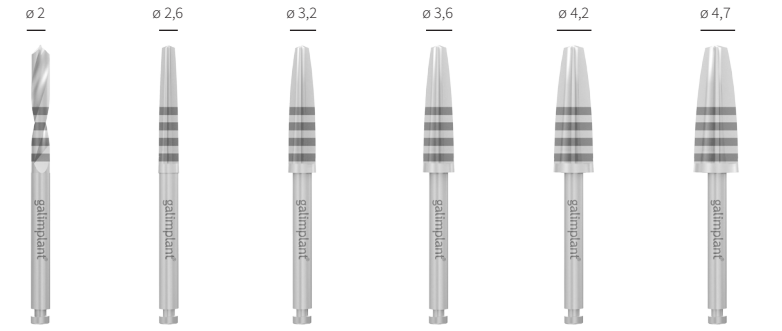

Ref. **K FRES**

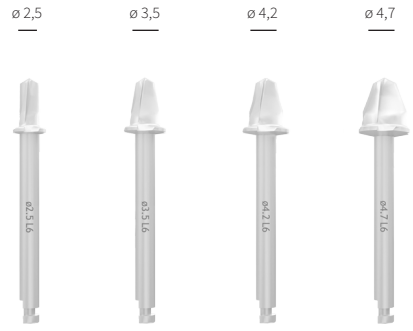

Ref. **K FRES L6**



Llave manual corta

Ref. **LLMC 220**

Destornillador corto válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Llave manual larga

Ref. **LLML 290**

Destornillador largo válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Bisturí circular

Ref. **BC 102340**

Diseñado para conectar al contra-ángulo del motor y realizar cortes de ø4 mm en la mucosa.



Llave motor

Ref. **LLM 215**

Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Prolongador de fresas

Ref. **P FRES**

Incrementa la longitud de cualquier fresa del sistema **Galimplant®**.



Dado manual

Ref. **DMA 150**

Conectado al porta-implante, se utiliza para insertar el implante de forma manual.



Llave protésica corta

Ref. **LLCA 220**

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Llave protésica larga

Ref. **LLCA 290**

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave para carraca directa a implante

Ref. **LLCAI 220**

Con la ayuda de la carraca y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Llave overdent

Ref. **LLKOD 250**

Por el extremo cuadrado permite atornillar el pilar overdent y por el extremo opuesto posibilita la colocación del retenedor sobre la tapa overdent.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.





Caja quirúrgica stop

Esta caja quirúrgica contiene fresas con tope para la colocación de los implantes **Galimplant®**

Stop

Caja fresas con tope

Ref. **CQ STOP**

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza

5 grupos de fresas con tope de diferentes diámetros y longitudes

Llaves

Dados

Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.



Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.



Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **6 mm**, **8 mm, 10 mm**, **12 mm** y **14 mm**.



Ref. **K FRES STOP**



Llave manual corta

Ref. **LLMC 220**

Destornillador corto válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Llave manual larga

Ref. **LLML 290**

Destornillador largo válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave motor

Ref. **LLM 215**


Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.

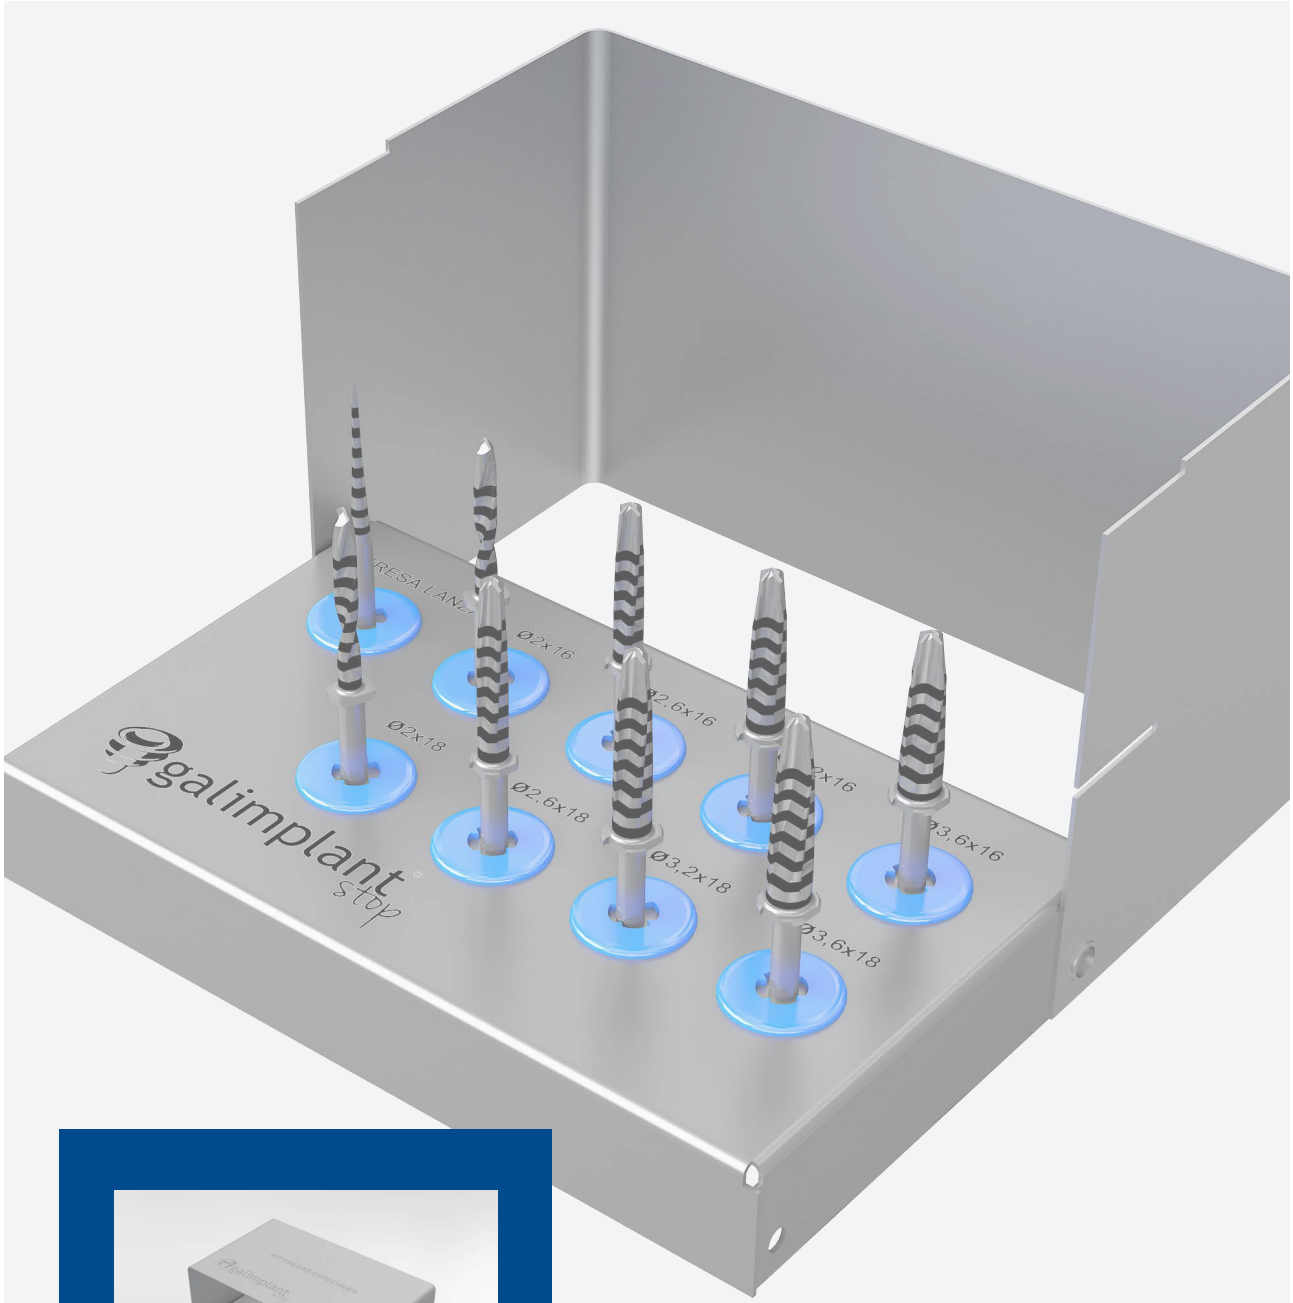



Fresas especiales

Contiene 2 grupos de fresas para longitudes especiales.


Fresas especiales

Ref. **C FESP L**

Caja de fresas con tope diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitud 16 y 18 mm.

Fabricadas en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.
Se pueden utilizar como fresas largas, marcadas para colocar implantes desde 6 mm de longitud.


ø 2 mm

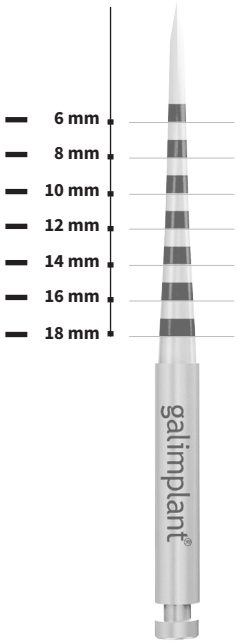

Fresa lanza

Se usa para perforar la cortical y marcar la posición del implante.


ø 2 - 3,6 mm

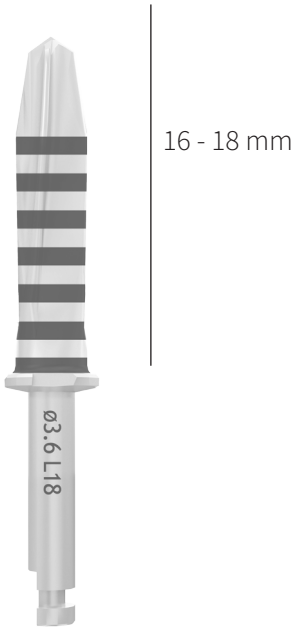


Fresas

Fresa final para colocar el implante en hueso tipo II y III.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **16 mm** y **18 mm**.

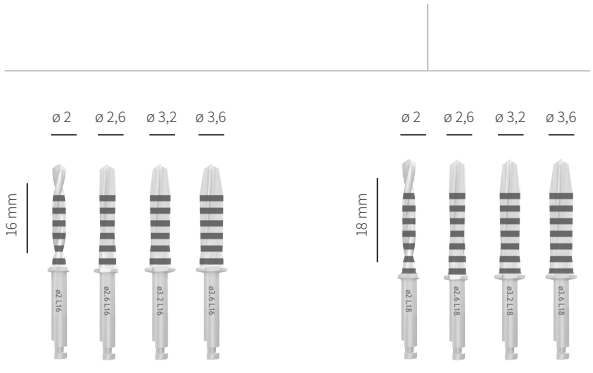

Ref. **K FESP L**

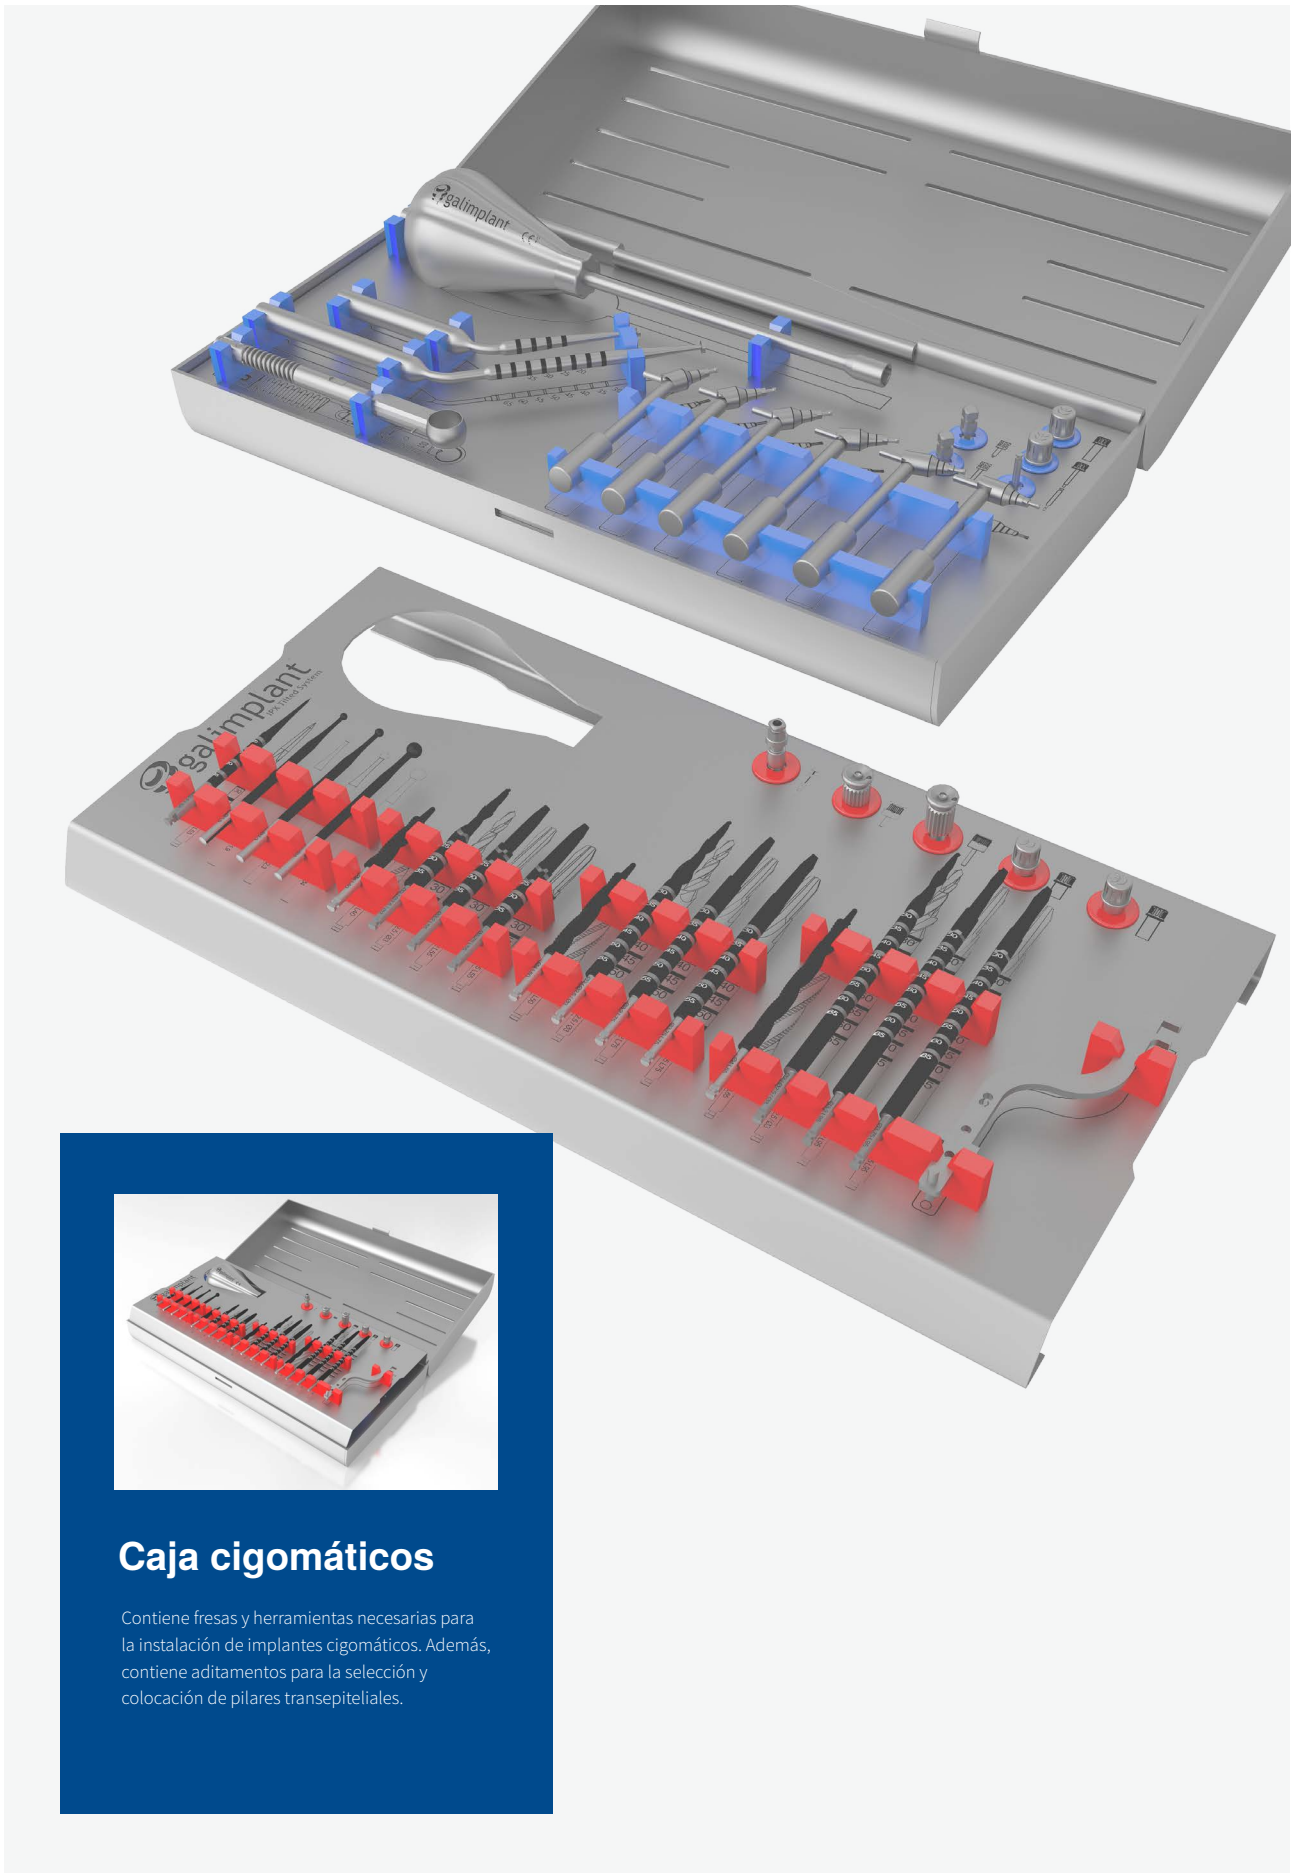

Caja cigomáticos

Contiene fresas y herramientas necesarias para la instalación de implantes cigomáticos. Además, contiene aditamentos para la selección y colocación de pilares transepiteliales.

Cigomáticos

Caja para implantes cigomáticos

Ref. **CQ CM**

Fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresa lanza extra larga

Fresas de bola

Fresas de avellanado lateral

3 grupos de fresas de diferentes longitudes

Llaves quirúrgicas y protésicas

Dados

Llave fiador

Portaimplante largo

Destornillador manual

Indicadores de profundidad de implantes cigomáticos


Indicadores de angulación de pilares multi-posición

Carraca dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.

ø 2,2 mm

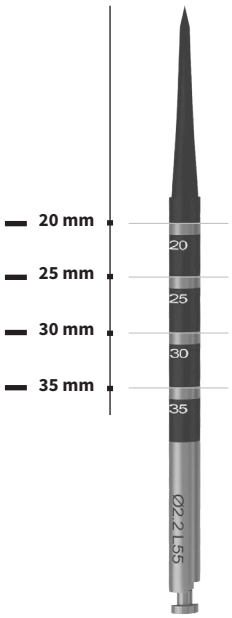

ø 1,9 - 4 mm




ø 4 mm

25 - 50 mm



ø 2 - 3,75 mm

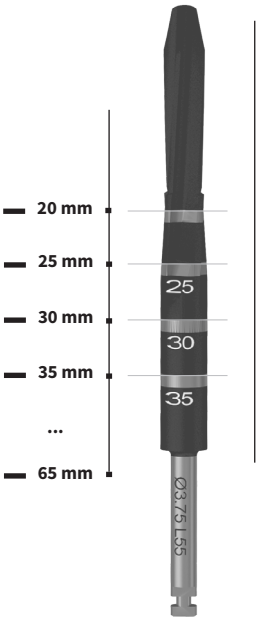

20 - 65 mm

Fresa lanza extra larga

Se usa para perforar la cortical y marcar la dirección del implante. Sirve también para rectificar trayectorias de fresados previos.

Fresas de bola


Fresas de osteotomía para: preparación de ventana de antrostomía, ostectomía de pared lateral del maxilar superior, osteoplastia proceso alveolar.

Fresas de avellanado lateral

Se usan para la preparación del cuerpo del implante para Implantes IPX Tilted en posición cigomática para ZAGA 1, 2 y 3.

Fresas

Fresas para preparación inicial y ensanchamiento del lecho implantario en huesos D1, D2 y D3.

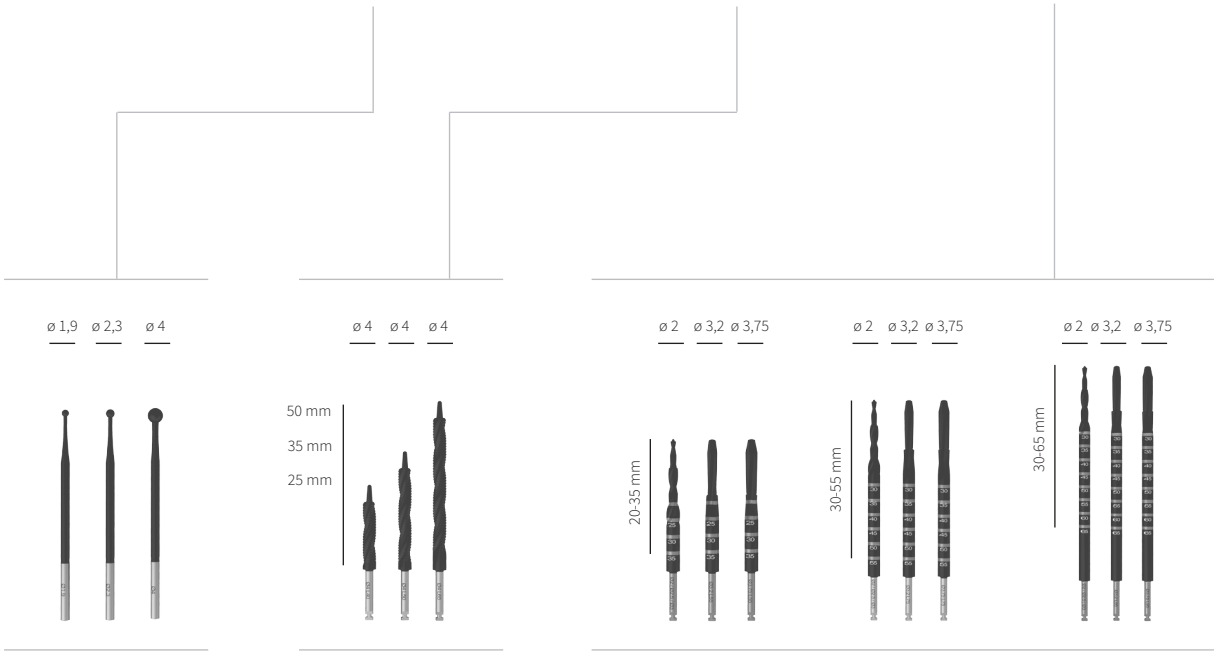

Cigomáticos



Llave manual corta

Ref. **LLMC 220**

Destornillador corto válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Llave manual larga

Ref. **LLML 290**

Destornillador largo válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Llave protésica de motor

Ref. **LLMTP 200**

Con la ayuda del motor permite atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos **Galimplant®**.



Llave protésica

Ref. **LLCAC 160**

Se conecta al destornillador manual y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Llave protésica

Ref. **LLCAC 250**

Se conecta al destornillador manual y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Carraca dinamométrica

Ref. **CA DIN**

Permite aplicar torque. Rango de 10 a 40 Ncm.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave multi-posición

Ref. **LLCAMU 244**

Se utiliza para colocar pilares multi-posición recto o angulado con ayuda de la carraca.



Llave protésica corta

Ref. **LLCA 220**

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Porta-implante largo

Ref. **PICGC 04040**

Porta-implante largo sin tornillo.

Componentes caja quirúrgica


Fabricados en acero quirúrgico.



Destornillador manual

Ref. **DMI 1660**


Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante manualmente o con ayuda de la carraca.



Indicador de profundidad corto

Ref. **MCG 100**


Se utiliza para indicar la profundidad de implantes cigomáticos de longitud 20 a 35 mm.

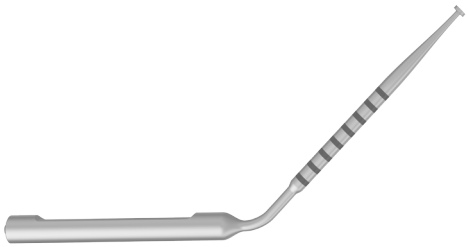

Indicador de profundidad largo

Ref. **MCG 156**

Se utiliza para indicar la profundidad de implantes cigomáticos de longitud 30 a 65 mm.



Llave fiador

Ref. **LLFI 70**

Permite fijar el portaimplantes para facilitar su desinserción en caso de emplear transpotadores atornillados. El cuerpo de la llave fiadora sirve como plantilla para la planificación estándar de implantes en posiciones 11i, 21i, 13i, 15i y 25i.

Cigomáticos


Indicadores de angulación y profundidad de pilares multi-posición.

Se utiliza para indicar la angulación y profundidad de los pilares multi-posición.



Indicador 60º

Ref. **MPMU 60**

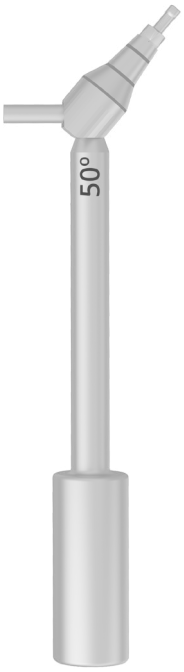


Indicador 50º

Ref. **MPMU 50**



Indicador 45º

Ref. **MPMU 45**

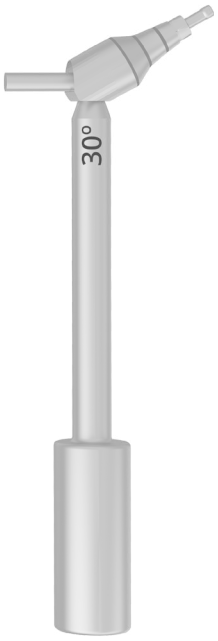


Indicador 30º

Ref. **MPMU 30**



Indicador 15º

Ref. **MPMU 15**

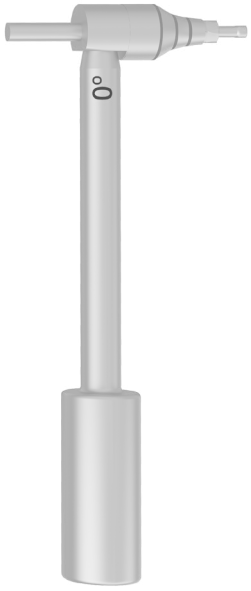

Indicador 0º

Ref. **MPMU 0**

Instrumental adicional

Fabricados en acero quirúrgico. Esterilizable en autoclave.



Llave protésica

Ref. **LLCA 097** - 9,7 mm
LLCA 174 - 17,4 mm
LLCA 220 - 22 mm
LLCA 290 - 29 mm

Se conecta a la carraca y se utiliza para dar torque a los tornillos protésicos del sistema **Galimplant®**.



Llave para carraca directa a implante

Ref. **LLCAI 220** - 22 mm
LLCAI 290 - 29 mm

Con la ayuda de la carraca y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Llave motor directa a implante

Ref. **LLMI 295**

Con la ayuda del motor y conectada directamente a la conexión interna de los implantes **Galimplant®**, permite su inserción.



Llave protésica de motor corta

Ref. **LLMTP 200** - 20 mm
LLMTP 220 - 22 mm

Con la ayuda del motor permite atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos **Galimplant®**.



Llave protésica de motor larga

Ref. **LLMTP 290**

Con la ayuda del motor permite atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos **Galimplant®**.



Llave protésica multi-posición corta y larga

Ref corta. **LLCAMU 174**
Ref larga. **LLCAMU 244**

Con la ayuda de la carraca permite atornillar y desatornillar toda la gama de pilares multi-posición rectos **Galimplant®**.



Fresa convencional ø 2.8 mm

Ref. **F-102928**

Fresa final para colocar implantes **Galimplant®** de ø 3,2 mm en hueso denso y de ø 3,5 mm en hueso blando.



Fresa convencional ø 3.8 mm

Ref. **F-102938**

Fresa final para colocar implantes **Galimplant®** de ø 4 mm en hueso denso y medio.



Fresa convencional ø 4.8 mm

Ref. **F-102948**

Fresa final para colocar implantes **Galimplant®** de ø 5 mm en hueso denso.



Cánula guía férula/pin

Ref. **CGF 4040**
Adherida a la férula quirúrgica, sirve de guía a los implantes para cirugía guiada.

Ref. **CP 120**
Adherida a la férula quirúrgica, sirve de guía a los pins de fijación para cirugía guiada.



Cubeta de impresión plástica

Ref. **CUB**

Cubetas superiores e inferiores, ambas disponibles en 3 medidas.

Carraca dinamométrica

Ref. **CA DIN**


Permite aplicar torque. Rango de 10 a 40 Ncm.





Secuencia de fresado

Se recomienda seguir las indicaciones de la siguiente tabla para lograr una óptima estabilidad primaria del implante.

Ø Diámetro del implante	Hueso denso TIPO I	Hueso medio TIPO II-III	Hueso blando TIPO IV
2,5 mm	2 mm	2 mm	fresa lanza
3,2 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,0 mm
3,5 mm	3,2 mm y los 3 mm iniciales de la fresa 3,6 mm	3,2 mm	2,8 mm
4,0 mm	3,8 mm y los 3 mm iniciales de la fresa 4,2 mm	3,6 - 3,8 mm	3,2 mm
4,5 mm	4,2 mm y los 3 mm iniciales de la fresa 4,5 mm	4,2 mm	3,6 mm
5,0 mm	4,8 mm	4,7 mm	4,2 mm

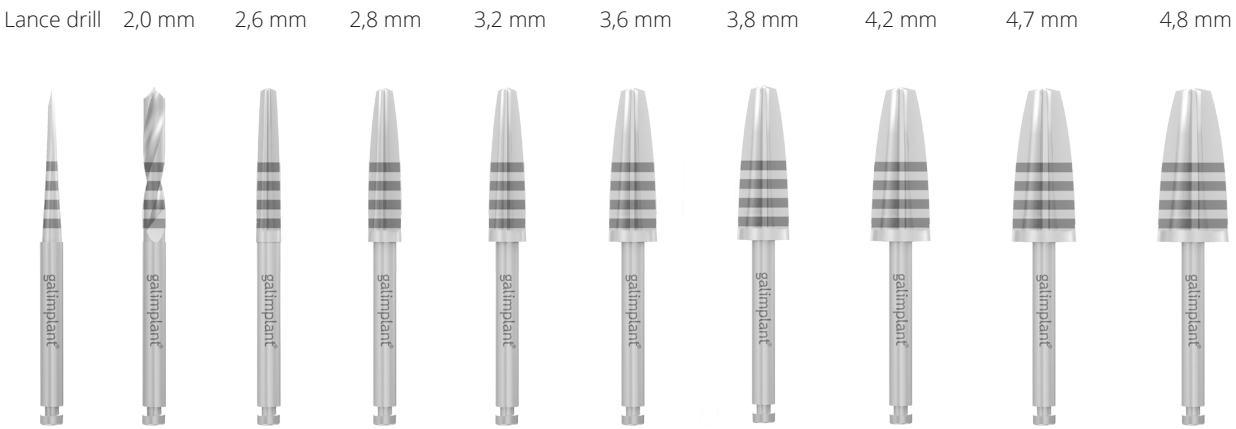

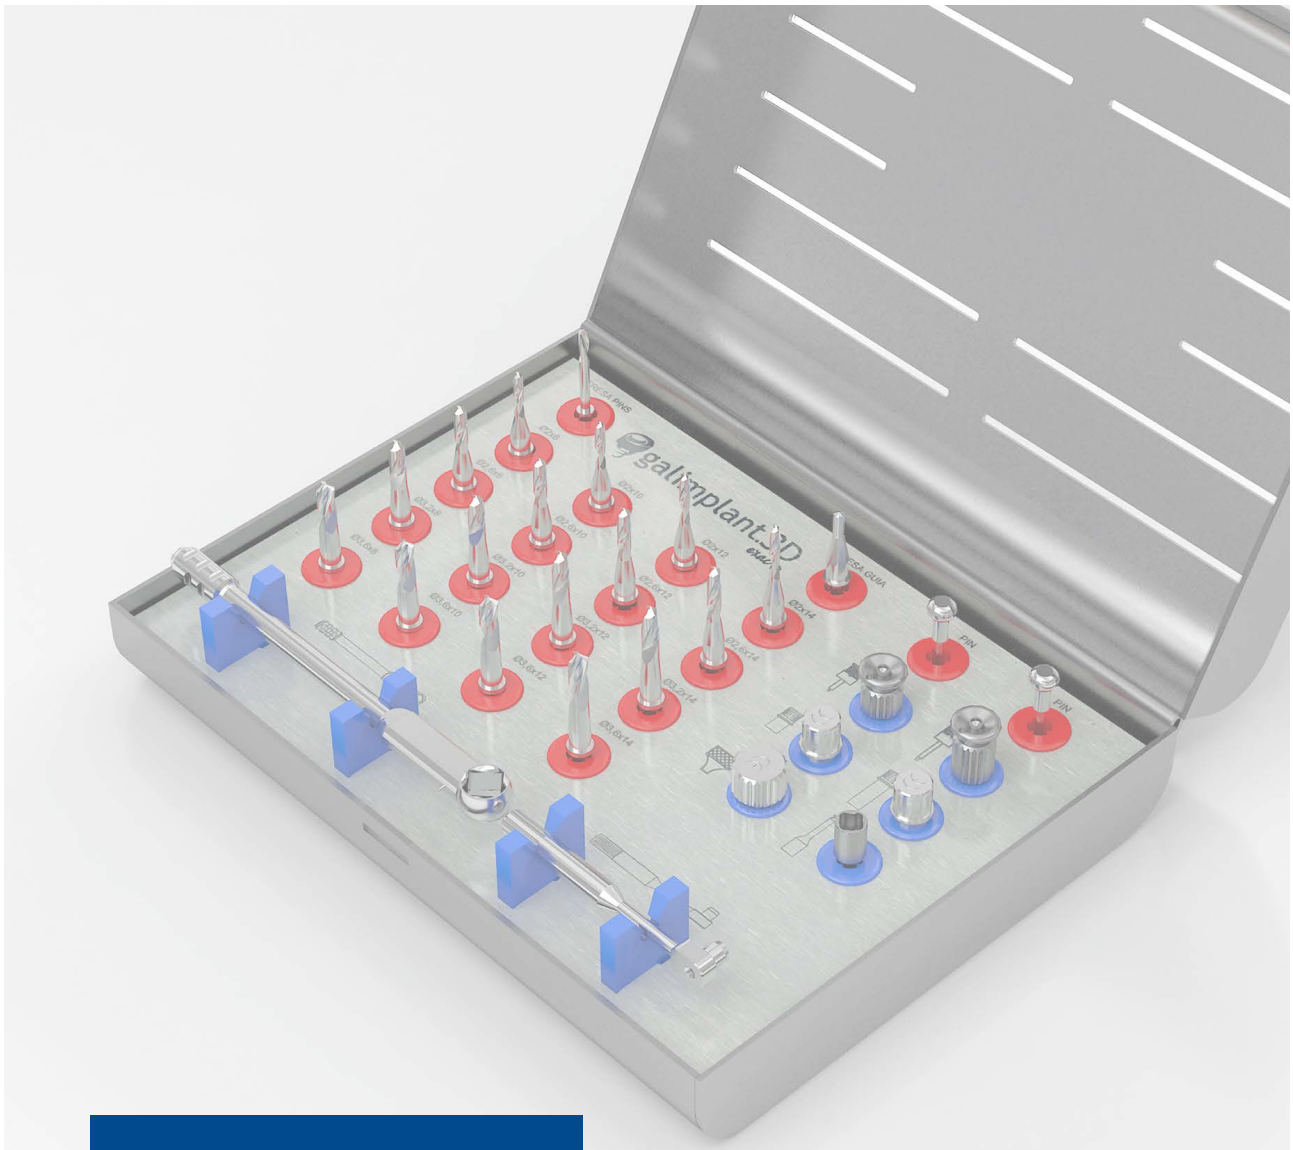

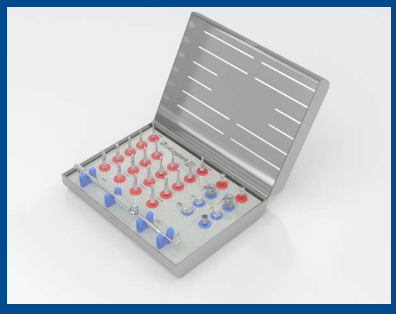

Caja quirúrgica 3D exacto

Diseñada para realizar cualquier cirugía guiada con el sistema **Galimplant 3D exacto**.

Cirugía guiada

Caja quirúrgica 3D exacto

Ref. **CQ 3D**

Caja específica para cirugía guiada,
fabricada en acero y esterilizable en autoclave.

Incluye:

Fresas especiales para cirugía guiada de diferentes diámetros y longitudes
Pins de fijación
Llaves
Dados
Dado manual
Llave motor
Reductor de cirugía guiada
Carraca no dinamométrica

Componentes caja quirúrgica

Fabricados en acero quirúrgico. En las fresas, recomendable máximo 20 usos.



Fresa pin

Tiene dos usos:

Permite la colocación de los pins de fijación que proporcionan una mayor estabilidad a la férula.

Utilizada junto con el reductor, crea un lecho de 8 mm de profundidad en el hueso.



Fresa guía


Diseñada con forma cónica para retirar el tapón mucoso. Consta de una punta no activa y 5 bisturíes en su perímetro.



Fresas

Gracias a su forma cilíndrica en la parte superior, las fresas se adaptan perfectamente a la cánula de la guía quirúrgica.

Diseñadas para colocar implantes **Galimplant®** de longitudes **8 mm**, **10 mm**, **12 mm** y **14 mm**.

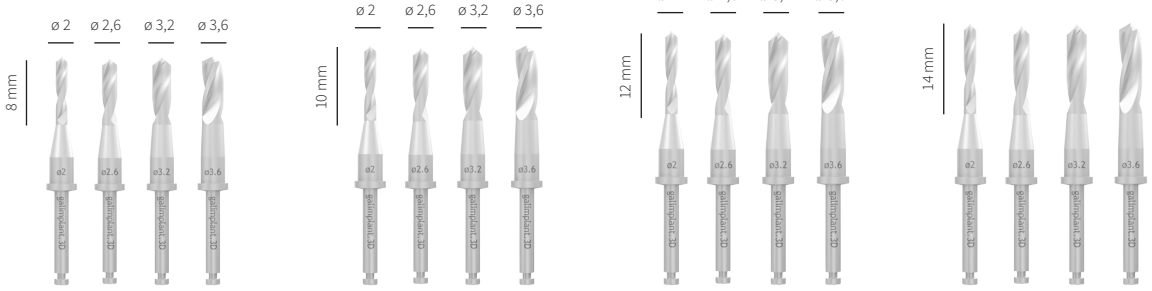

Ref. **K FRES CG**

3D exacto



Pin de fijación

Ref. **PIN 290** x2

Se usa para fijar la férula quirúrgica al maxilar del paciente.



Llave manual corta

Ref. **LLMC 220**

Destornillador corto válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Dado corto

Ref. **DC 144**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Llave manual larga

Ref. **LLML 290**

Destornillador largo válido sólo para tornillos del sistema **Galimplant®**.

Con corona giratoria y perforada para pasahilos.



Dado largo

Ref. **DL 244**

Se utiliza para conectar al porta-implante e introducir el implante con ayuda de la carraca.



Dado manual

Ref. **DMA 150**

Conectado al porta-implante, se utiliza para insertar el implante de forma manual.



Llave motor

Ref. **LLM 215**

Conectada al motor y al porta-implante, permite insertar el implante.



Reductor

Ref. **RCG 4020**


Se usa para reducir el diámetro de la cánula de la férula quirúrgica de ø 4 mm. a ø 2 mm. Marca la posición del implante en el hueso.



Carraca no dinamométrica

Ref. **CA N/DIN**

Permite insertar el implante de forma manual.

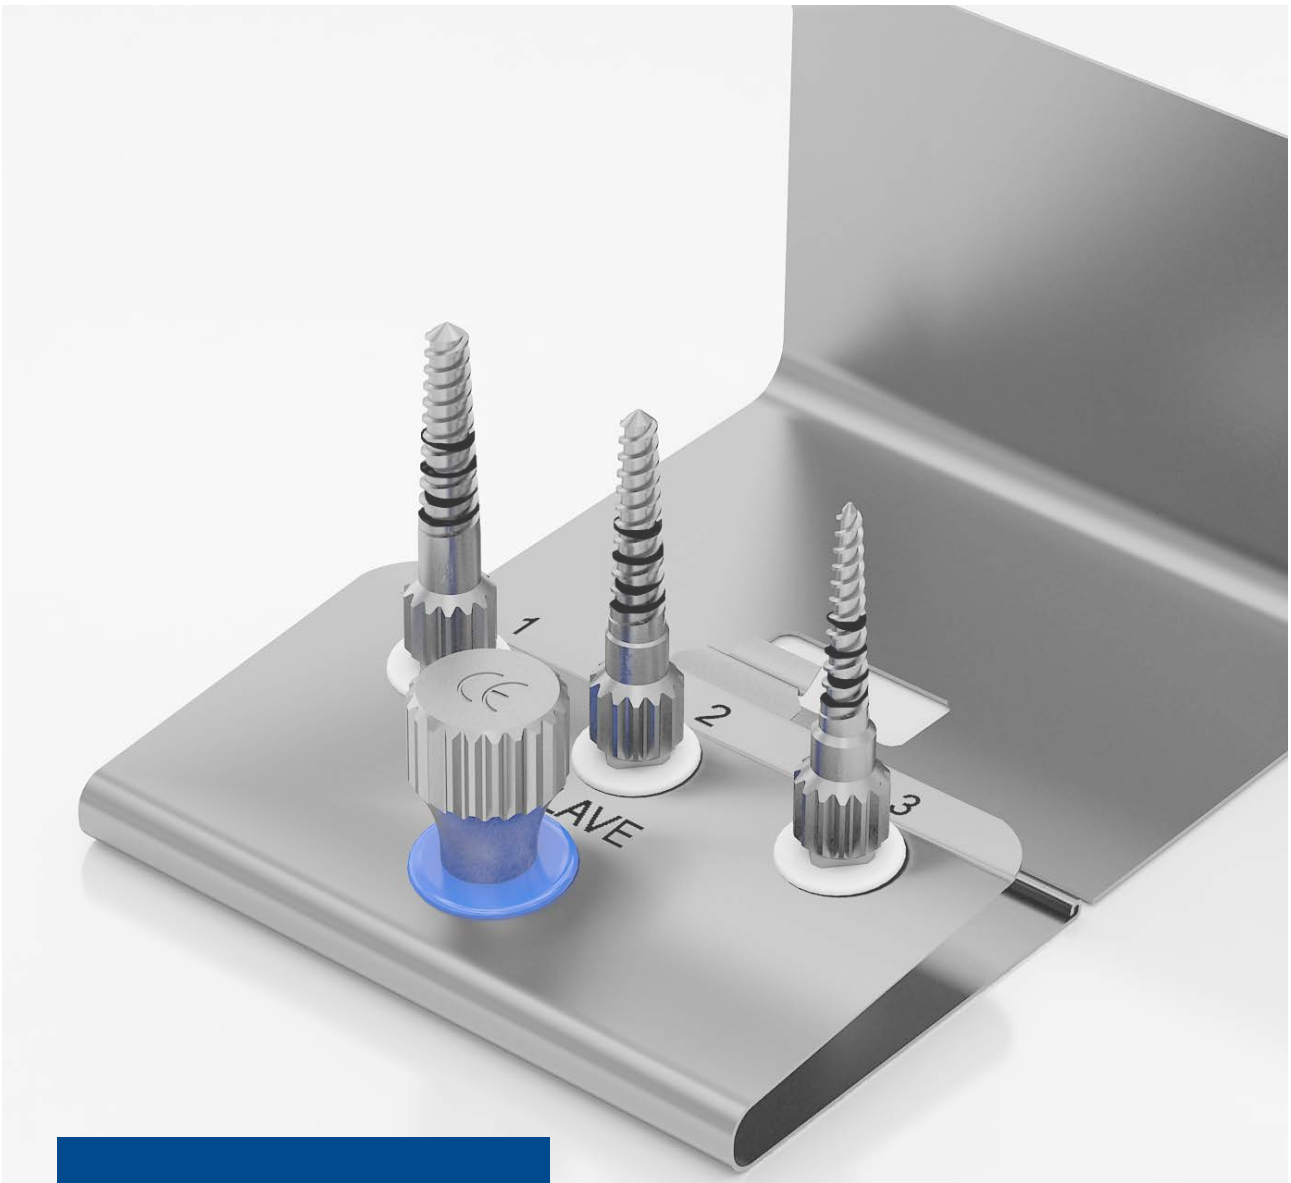



Osteótomos


Contiene 3 dilatadores óseos de diferentes diámetros.

Osteótomos

Ref. **C OST**

Su uso está indicado para dilatación ósea.

Fabricados en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.

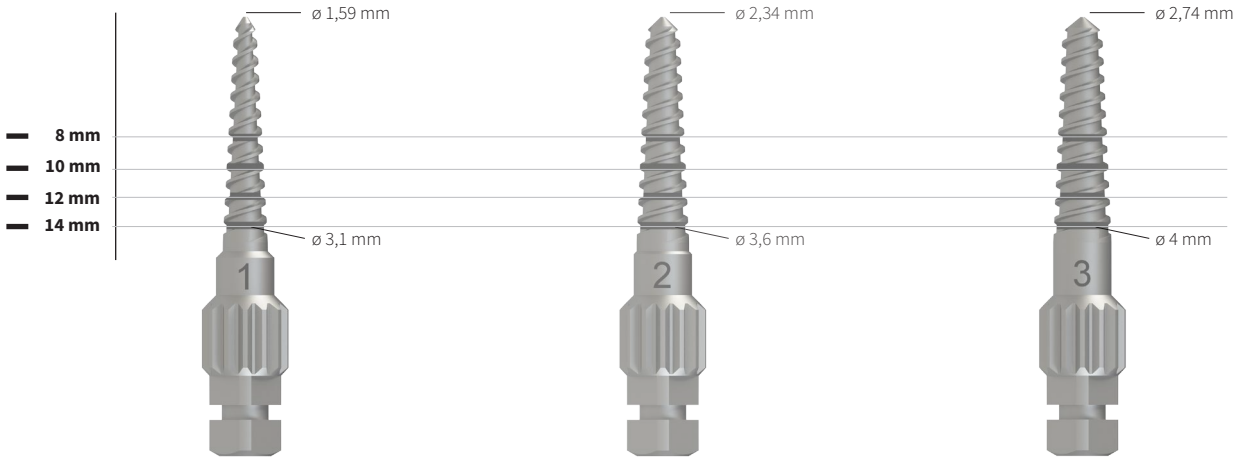

Osteótomo Nº 1

Ref. **EXP 1**

Osteótomo Nº 2

Ref. **EXP 2**

Osteótomo Nº 3

Ref. **EXP 3**



Dado Manual

Fabricado en acero quirúrgico.

Ref. **DMA 150**





Trefinas


Contiene 4 trefinas de diferentes diámetros.

Trefinas

Ref. **C TREF**

Su uso está indicado para recolección de hueso y explantación de implantes.

Fabricadas en acero quirúrgico y esterilizables en autoclave.

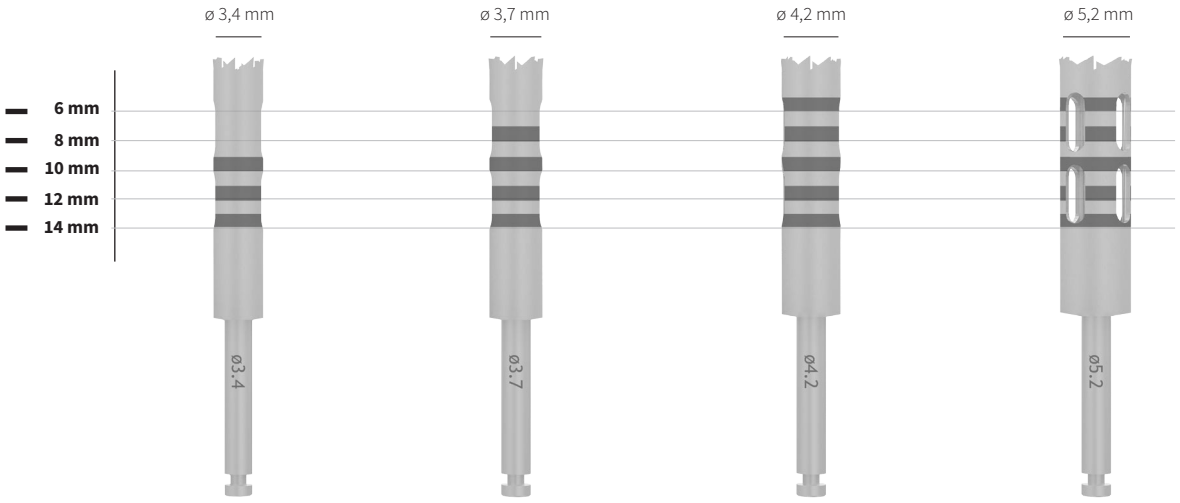

Trefina ø 3,4 mm

Ref. **FT-103734**

Trefina ø 3,7 mm

Ref. **FT-103737**

Trefina ø 4,2 mm


Ref. **FT-103742**

Trefina ø 5,2 mm

Ref. **FT-103752**





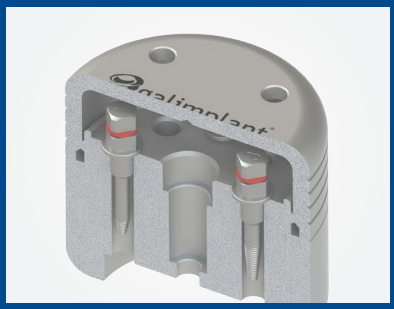

Extractores

Contiene 4 extractores de diferentes diámetros.

Extractores

Ref. **KIT EXT-LE**

Su uso está indicado para extracción de tornillos coronados y explantación de implantes fracasados.

Fabricados en acero endurecido y esterilizables en autoclave.



Extractor Tipo 1

Ref. **EXT-1**

Diseñado para extraer tornillos protésicos con la conexión coronada o deformada.



Extractor Tipo 2

Ref. **EXT-2**

Diseñado para extraer tornillos protésicos con la conexión totalmente deteriorada.

Se utiliza cuando el extractor tipo 1 no sujeta o arrastra la zona afectada.



Extractor Tipo 3

Ref. **EXT-3**

Diseñado para extraer implantes de conexión interna con métrica ø 1.6 mm.

No debe exceder un torque superior a 100 Ncm. Para torques mayores debe utilizarse el extractor tipo 4.



Extractor Tipo 4

Ref. **EXT-4**


Diseñado para extraer implantes de conexión externa con métrica ø 2 mm.

Aconsejable no exceder un torque superior a 200 Ncm.

Estos extractores pueden ser utilizados con el dado corto/largo y la carraca **Galimplant.**

Recomendable un sólo uso.


Instrumental quirúrgico

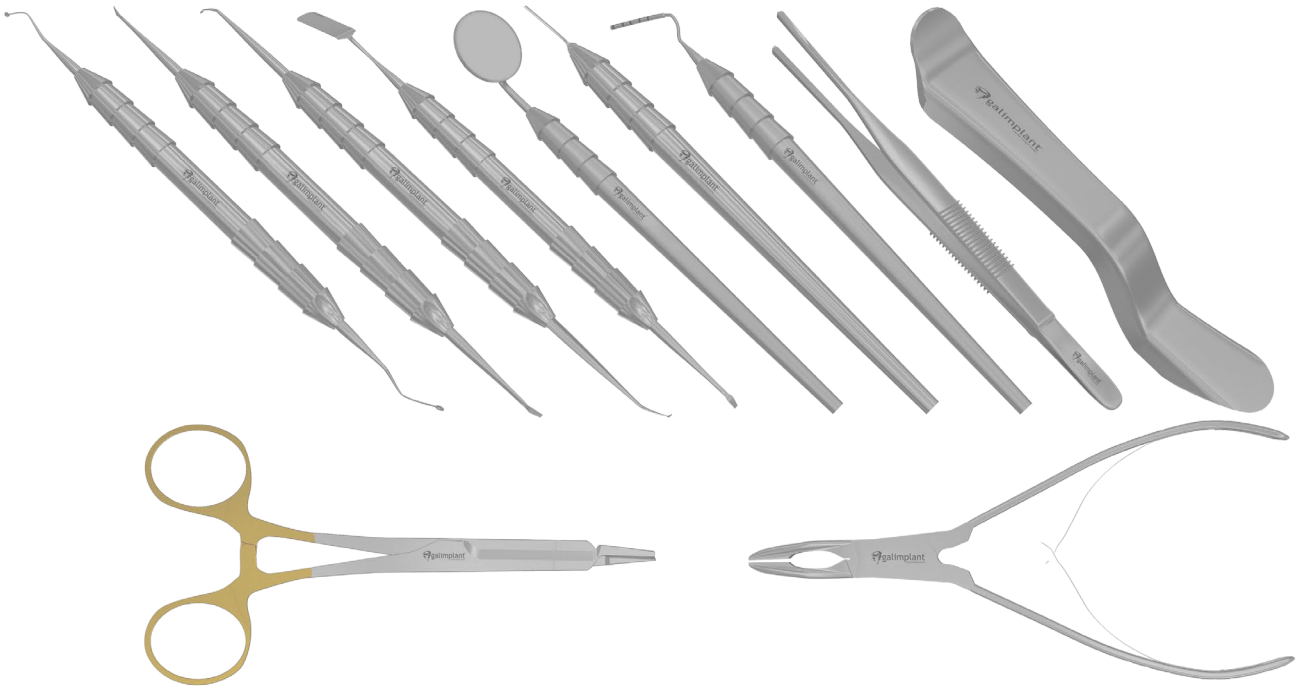


Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.

Esterilizable en autoclave.


Ref. **KIT GAL**

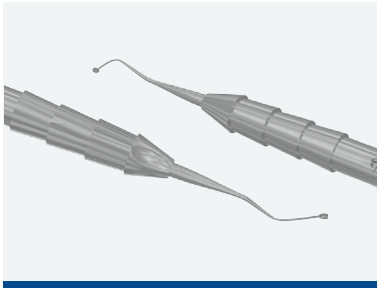


CURETA DE HEMINGWAY

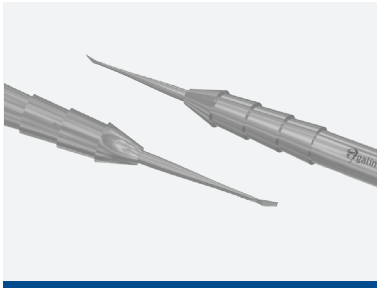


CURETA QUIRÚRGICA MOLT N°4

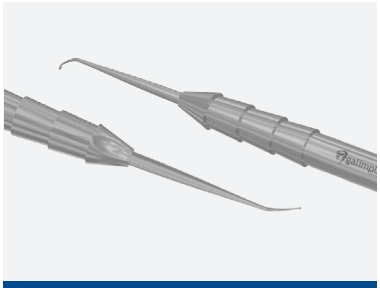


ELEVADOR DEL SENO MAXILAR

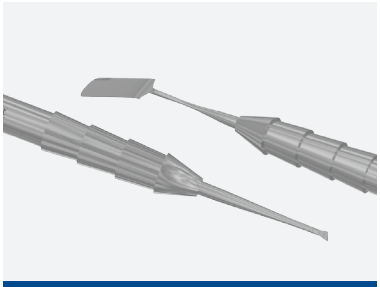


ELEVADOR PERIÓSTICO DE PRICHARD

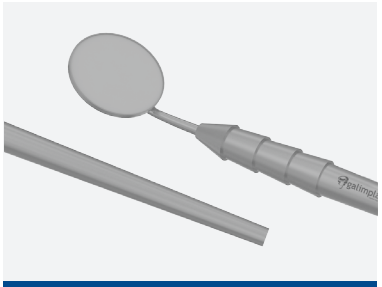


ESPEJO BUCAL + MANGO SATINADO

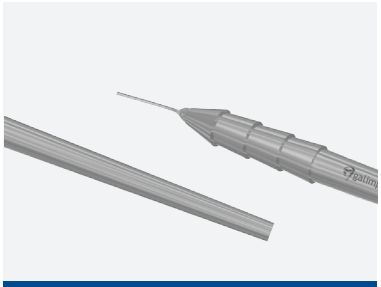

MANGO DE BISTURÍ ANGULADO

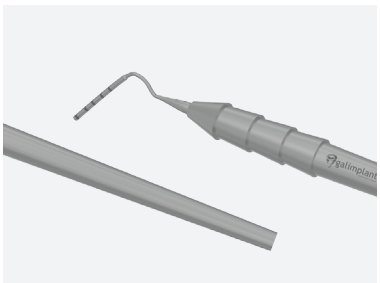

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

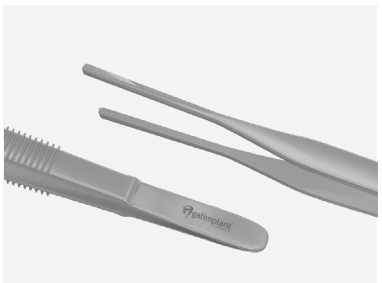


PINZA DE TEJIDOS



SEPARADOR BUCAL




PORTAAGUJAS CON TIJERAS

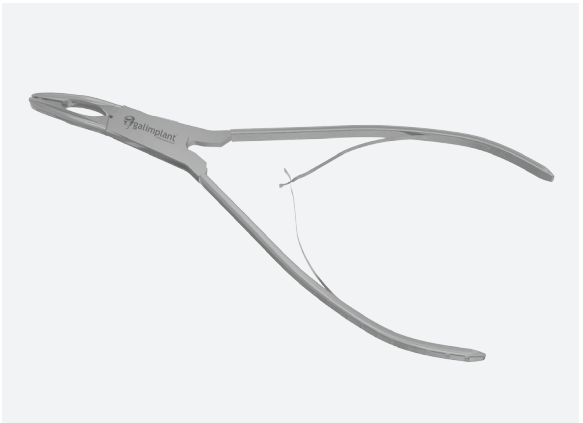

PINZA GUBIA FRIEDMAN

Instrumental cigomáticos

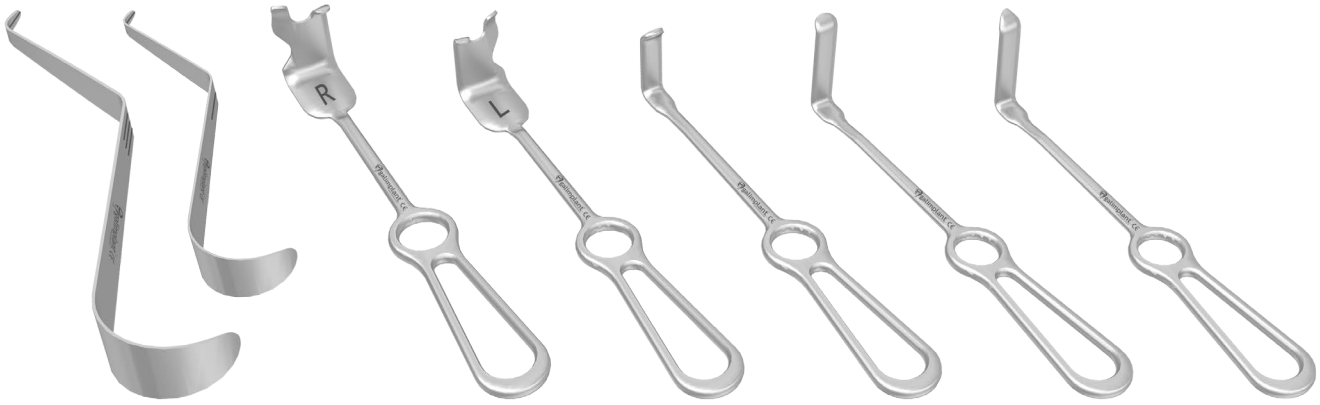

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.

Esterilizable en autoclave.



RETRACTOR CIGOMÁTICO ESTRECHO Ref. **RET BUC A**

Separador diseñado para alcanzar la conjunción entre el proceso frontal y temporal del hueso cigomático, estrecho para la colocación de un implante cigomático.




RETRACTOR CIGOMÁTICO ANCHO Ref. **RET BUC B**

Separador diseñado para alcanzar la conjunción entre el proceso frontal y temporal del hueso cigomático, ancho para la colocación de dos o tres implantes cigomáticos.



SEPARADOR DE SENO DERECHO Ref. **SEP SEN R**

Separador quirúrgico adaptado anatómicamente a la pared lateral sinusal derecha.

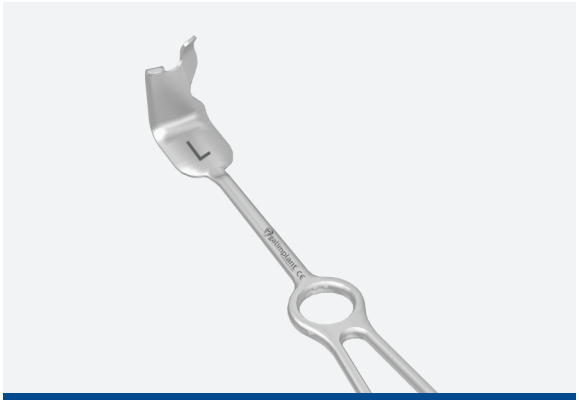

SEPARADOR DE SENO IZQUIERDO Ref. **SEP SEN L**

Separador quirúrgico adaptado anatómicamente a la pared lateral sinusal izquierda.



SEPARADOR LANGENBECK Ref. **SEP LAN**

Separador para cirugía oral y maxilofacial.



SEPARADOR LANGENBECK INVERTIDO ROMO Ref. **SEP LAN IR**


Separador para cirugía oral y maxilofacial.



SEPARADOR LANGENBECK INVERTIDO AGUDO Ref. **SEP LAN IA**

Separador para cirugía oral y maxilofacial.

Guías de posicionamiento

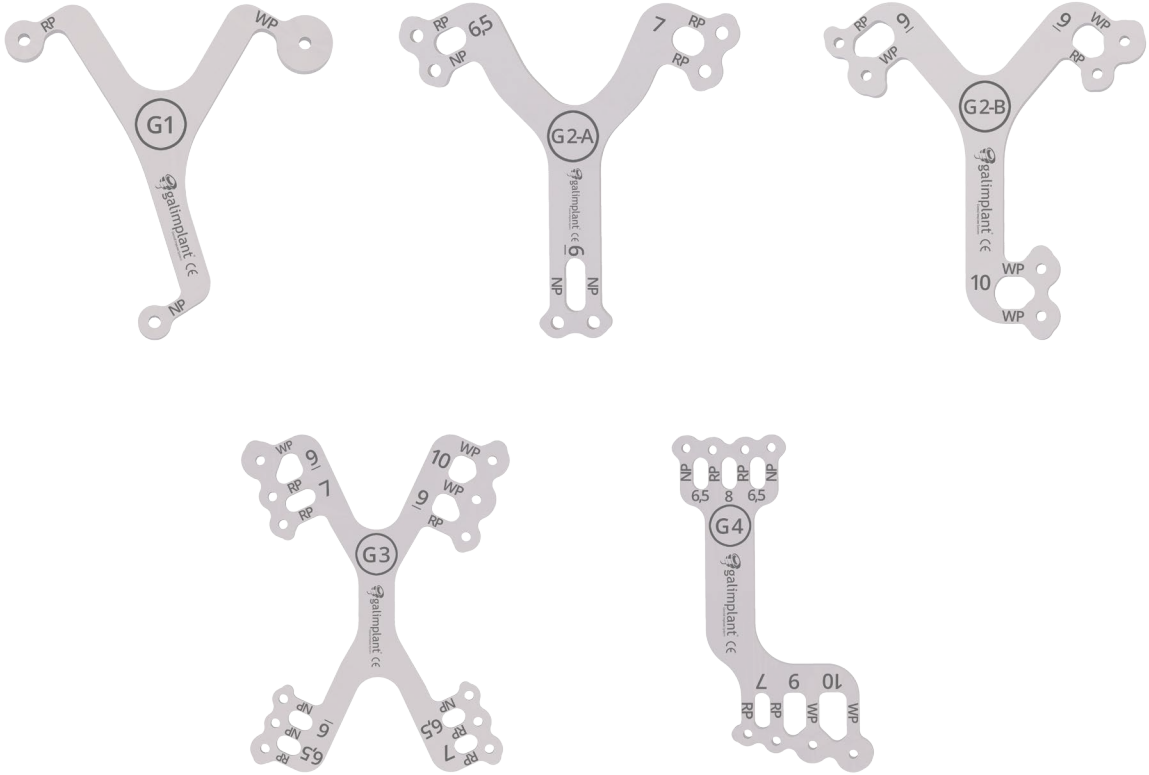

Instrumentos fabricados en acero quirúrgico.


Esterilizable en autoclave.

Los orificios permiten el paso de la fresa lanza y la fresa espiral de ø 2 mm. del Sistema.



GUÍA DE POSICIONAMIENTO 1 Ref. POS **G1**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de implantes unitarios.

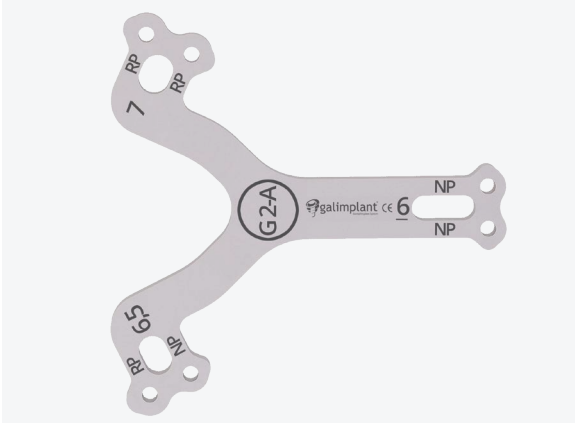


GUÍA DE POSICIONAMIENTO 2-A Ref. POS **G2-A**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros reducidos y/o estándar.




GUÍA DE POSICIONAMIENTO 2-B Ref. POS **G2-B**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de dos implantes consecutivos de diámetros estándar y anchos.

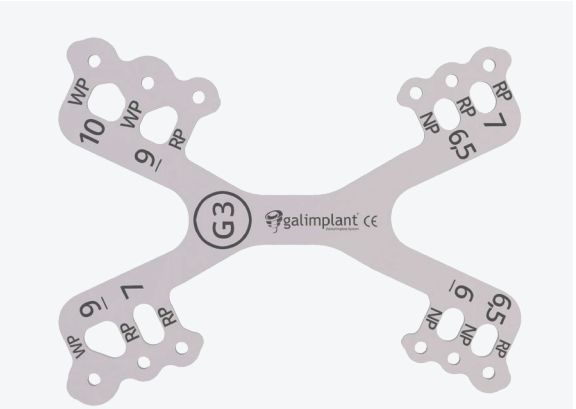

GUÍA DE POSICIONAMIENTO 3 Ref. POS **G3**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de tres implantes consecutivos de diámetros reducidos, estándar y anchos.

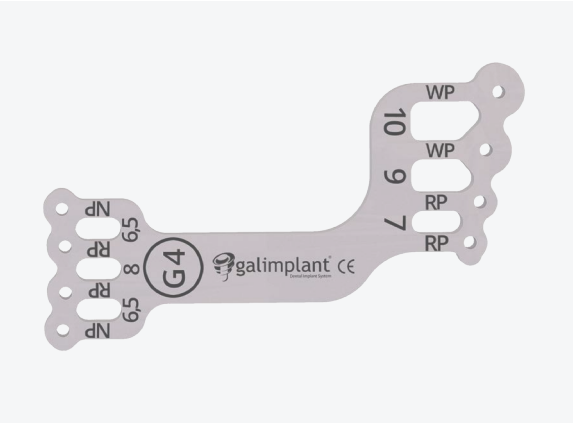

GUÍA DE POSICIONAMIENTO 4 Ref. POS **G4**

Permite determinar el espacio adecuado para la colocación de cuatro implantes consecutivos tanto en sector anterior como en sector posterior.





Pistola de irrigación


Suministrada en caja de aluminio.

Pistola de irrigación

Ref. **C PIST**

Pistola para irrigación y lavado quirúrgico.

También disponemos de líneas de irrigación estériles.

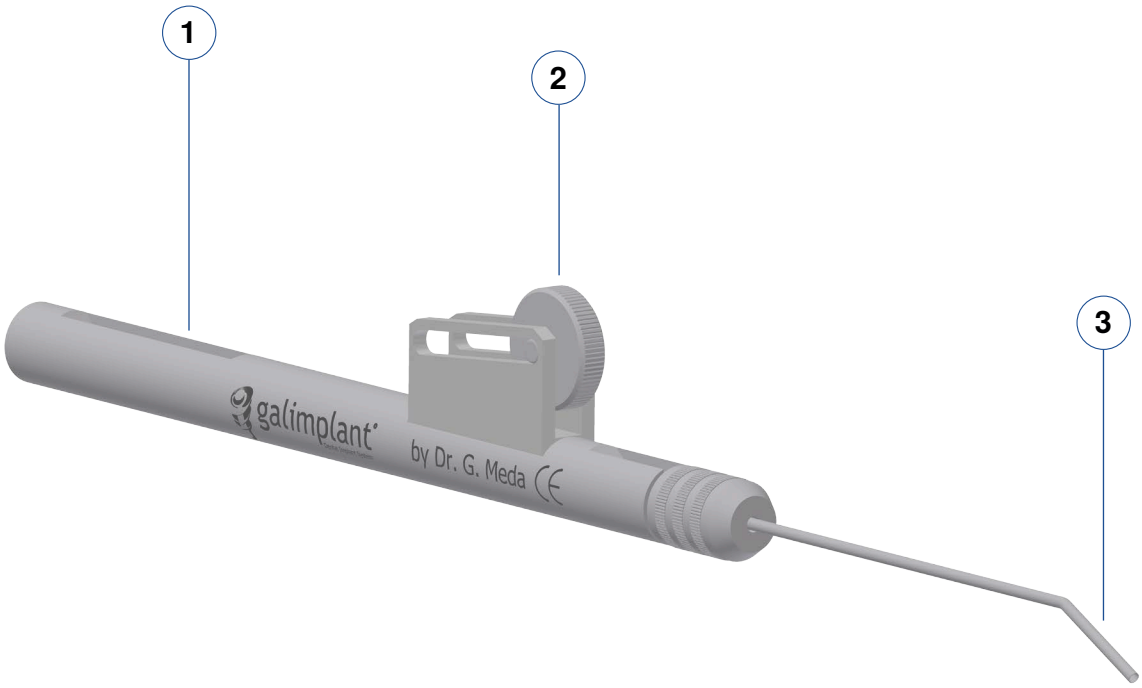

1. Cuerpo de sujeción **2. Regulador de caudal** **3. Punta metálica**

Siliconas y registros



SILICONA FLUIDA Ref. **SIL FLU 50**

- Color **naranja**
- Mezcla **1:1**
- Tiempo de trabajo **1' 30"**
- Tiempo total **2' 00"**



SILICONA PESADA Ref. **SIL PES 450**

- Color **azul**
- Mezcla **1:1**
- Tiempo de trabajo **1' 15"**
- Tiempo total **2' 00"**



SILICONA PARA REGISTRO OCLUSAL Ref. **REG MORD 50**

- Color **azul**
- Mezcla **1:1**
- Tiempo de trabajo **0' 20"**
- Tiempo total **1' 00"**

Galiform

Galiform es un composite fotopolimerizable para modelar y de uso protésico. Ideal para trabajos fresados, diseño de puentes, barras, estructuturas implantosoportadas, así como para la ferulización y transferencia de estructuras al modelo.
Endurece en pocos segundos con el fotopolimerizador.

>> Gel de modelación universal fotopolimerizable

>> Modelador en frío

>> Sin contracción

- **Galiform tiene una viscosidad idonea para modelar.**
- Las modelaciones realizadas con Galiform son muy estables y precisas sin deformación.
- Galiform tiene una excelente adhesión y se puede combinar con materiales fotopolimerizables y ceras.
- Galiform se quema sin dejar residuos y no deja restos de color.
- Debido a su color azul se distingue óptimamente y se obtiene una polimerización en profundidad.



El kit contiene:

- 3 jeringas de 3g
- 9 cánulas de aplicación

Indicaciones:

- Modelación de puentes, Inlays y Onlays.
- Modelación de ataches, coronas telescópicas y cónicas.
- Unión intra- o extraoral de estructuras para soldar.
- Correción de modelaciones.
- Confección de espacios definidos para el gel en la fabricación de férulas de blanqueamiento.
- Alivio de zonas retentivas.
- Protección de dientes en trabajos de arenado.
- Relleno de poros o cortes de sierra en el modelo.

Sistema de registro oclusal



Sistema de registro oclusal galimplant

Ref. **SRO GAL**



PLACA MANDIBULAR GRANDE




PLACA MANDIBULAR PEQUEÑA



PUNTERO CENTRAL



FIJADOR INTERMAXILAR

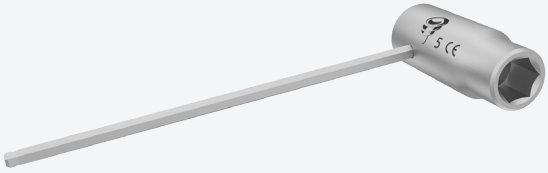

DESTORNILLADOR



REGLA

Aparatología



Surgic Pro

Micromotor para implantología

- Torque: 5-80 Ncm
- Velocidad del motor: 200~40000 min $^{-1}$
- Alimentación de la luz: más de 32000 LUX
- Iluminación Led para un tratamiento más preciso y seguro
- Larga duración y resistencia a las altas temperaturas
- Bomba de irrigación avanzada



Variosurg 3

Sistema de cirugía ultrasónica

- Frecuencia: 28-32 kHz
- Fuente de alimentación: 230V 50/60 Hz
- Flujo de irrigación: 10~75 ml/min
- Programas: CIRUGÍA x5, ENDODONCIA x2, PERIODONCIA x2
- Kit básico con 6 puntas



Dos sistemas quirúrgicos conectados que se manejan con un único pedal de control. Un innovador enfoque para implantes y tratamientos de cirugía oral.

También disponemos de líneas de irrigación estériles.


I+D+i

Nuestro valor tiene como base un enfoque científico, evidencias clínicas y un fuerte desarrollo en I+D+i.

¿Qué nos hace diferentes?

Con la colaboración de profesionales del sector, cirujanos, institutos de investigación y universidades, **Galimplant desarrolla una extensa gama de productos de alta calidad que aseguran su fiabilidad a largo plazo.**



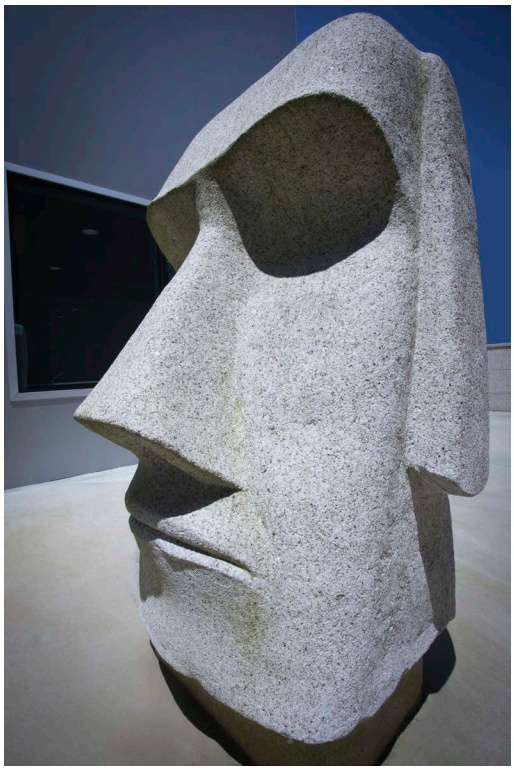





Más información: **www.galimplant.com/investigacion**